BRASIL Serviços Barra GovBr
(HTTP://BRASIL.GOV.BR)

001198

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE) ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE (MAPA DO SITE)

ANVISA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
(/)

Buscar no portal

(https://ramais.anvisa.gov.br/owa) Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (a...ia-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 27/11/2018

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação de friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em coelhos
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.

001199

21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)

    23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

    24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos

    56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica

001200

80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
   1. 1 Condicionadores de ar
   1. 2 Purificador de ar
   1. 3 Esterilizador de ar
   1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
   4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. Compressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
    14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20. Fogão para preparação de alimentos
21. Gel para absorção de resíduos orgânicos
22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
23. Gerador de vapor
24. Incinerador de resíduos hospitalares
25. Indicador físico, químico ou biológico
26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
    26. 1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
    26. 2 Cadeiras de espera
    26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes)
    26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
    26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
    26. 6 Necrópsia
27. Negatoscópio
28. Papel higiênico
29. Pia hospitalar
30. Protetor auricular de ruídos
31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portá...
32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36. Secador de ar medicinal
37. Seladora de embalagens de produtos médicos
38. Sistema de comunicação hospitalar
39. Sistema de sinalização hospitalar
40. Dispensório Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

001201

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro

   4.1 Relógio para treinamento

5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico

   8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

   8.2 Halteres

   8.3 Estações de Musculação

   8.4 Remadores

   8.5 Aparelho para abdominais

   8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental

   3.1 Condicionadores de ar

   3.2 Purificador de ar

   3.3 Esterilizador de ar

   3.4 Umidificador de ar

4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas

001202

14. Limpador de lingua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou comporiam um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnostico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação ou qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

001203

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

www.anvisa.gov.br

Legislação

Para verificar a atualização desta norma, como revogações ou alterações, acesse o Visalegis.

Legislação
Resoluções

Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001
Republicada no D.O de 06/11/2001

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 10 de outubro de 2001,

considerando a necessidade de atualizar os procedimentos para registro de produtos "correlatos" de que trata a Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, o Decreto n.º 79.094, de 5 de janeiro de 1977 e a Portaria Conjunta SVS/SAS n.º 1, de 23 de janeiro de 1996;

considerando a necessidade de internalizar a Resolução GMC nº 40/00 do Mercosul, que trata do registro de produtos médicos,

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico que consta no anexo desta Resolução, que trata do registro, alteração, revalidação e cancelamento do registro de produtos médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA .

Parágrafo único Outros produtos para saúde, definidos como "correlatos" pela Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, equiparam-se aos produtos médicos para fins de aplicação desta Resolução, excetuando-se os reagentes para diagnóstico de uso in-vitro.

Art. 2º O fabricante ou importador de produto médico deve apresentar à ANVISA os documentos para registro, alteração, revalidação ou cancelamento do registro, relacionados nos itens 5,6,9,10 e 11 da Parte 3 do Regulamento anexo a esta Resolução.

§ 1º As seguintes informações, previstas nos documentos referidos neste artigo, além de apresentadas em texto, devem ser entregues em meio eletrônico para disponibilização pela ANVISA em seu "site" na rede mundial de comunicação:
a) Dados do fabricante ou importador e dados do produto, indicados no Formulário contido no Anexo III.A do Regulamento Técnico;
b) Rótulos e instruções de uso, descritos no Anexo III.B do Regulamento Técnico.

§ 2º O distribuidor de produto médico que solicitar registro de produto fabricado no Brasil, equipara-se a importador para fins de apresentação da documentação referida neste artigo.

Art. 3º O fabricante ou importador de produtos dispensados de registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, deve cadastrar seus produtos na Agência, apresentando, além da taxa de vigilância sanitária correspondente, as informações requeridas no § 1º do Art. 2º desta Resolução.

Parágrafo único A alteração, revalidação ou cancelamento do cadastro de produto referido neste artigo, deve adotar os mesmos procedimentos previstos nos itens 9, 10, 11 e 13 da Parte 3 do Regulamento anexo a esta Resolução, estando sujeito às disposições das Partes 4 e 5 deste Regulamento.

Art. 4º No caso de equipamento médico, o fabricante ou importador deve fixar de forma indelével em local visível na parte externa do equipamento, no mínimo as seguintes informações de rotulagem:
a) identificação do fabricante (nome ou marca);
b) identificação do equipamento (nome e modelo comercial);
c) número de série do equipamento;
d) número de registro do equipamento na ANVISA.

Art. 5º As petições de registro, isenção, alteração, revalidação ou cancelamento de registro protocoladas na ANVISA até 30 (trinta) dias da data de publicação desta Resolução, estão sujeitas às disposições da Portaria Conjunta SVS/SAS nº 1/96 e Portaria SVS nº 543/97.

Parágrafo único A petição de revalidação de registro de produto médico protocolada após os 30 (trinta) dias referidos neste artigo, deve adequar as informações do processo original ás disposições desta Resolução e às prescrições de regulamento técnico específico para o produto, publicado durante a vigência de seu registro.

Art. 6º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Conjunta SVS/SAS nº 1, de 23 de janeiro de 1996 e a Portaria SVS nº 543, de 29 de outubro de 1997, após 30 (trinta) dias da publicação desta Resolução.

GONZALO VECINA NETO

ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO

REGISTRO, ALTERAÇÃO, REVALIDAÇÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRODUTOS MÉDICOS

PARTE 1 - Abrangência e Definições

1. As disposições deste documento são aplicáveis aos fabricantes e importadores de produtos médicos.

2. A classificação, os procedimentos e as especificações descritas neste documento, para fins de registro, se aplicam aos produtos médicos e seus acessórios, segundo definido no Anexo I.

3. Para os propósitos deste documento, são adotadas as definições estabelecidas em seu Anexo I.

4. Este documento não é aplicável a produtos médicos usados ou recondicionados.

PARTE 2 - Classificação

1. Os produtos médicos, objeto deste documento, estão enquadrados segundo o risco intrínsico que representam à saúde do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos, nas Classes I, II, III ou IV. Para enquadramento do produto médico em uma destas classes, devem ser aplicadas as regras de classificação descritas no Anexo II deste documento.

2. Em caso de dúvida na classificação resultante da aplicação das regras descritas no Anexo II, será atribuição da ANVISA o enquadramento do produto médico.

3. As regras de classificação descritas no Anexo II deste documento, poderão ser atualizadas de acordo com os procedimentos administrativos adotados pela ANVISA, tendo em conta o progresso tecnológico e as informações

de eventos adversos ocorridos com o uso ou aplicação do produto médico.

PARTE 3 - Procedimentos para Registro

001205

1. É obrigatório o registro de todos produtos médicos indicados neste documento, exceto aqueles produtos referidos nos itens 2, 3 e 12 seguintes.

2. Estão isentos de registro os produtos médicos submetidos a pesquisa clínica, cumpridas as disposições legais da autoridade sanitária competente para realização desta atividade, estando proibida sua comercialização e/ou uso para outros fins.

3. Estão isentas de registro as novas apresentações constituídas de um conjunto de produtos médicos registrados e em suas embalagens individuais de apresentação íntegras, devendo conter no rótulo e/ou instruções de uso as informações de registro dos produtos médicos correspondentes.

4. A ANVISA concederá o registro para família de produtos médicos.

5. Os fabricantes ou importadores para solicitarem o registro de produtos médicos enquadrados nas classes II, III e IV, devem apresentar à ANVISA, os seguintes documentos:

a) Comprovante de pagamento da taxa de vigilância sanitária correspondente.

b) Informações para identificação do fabricante ou importador e seu produto médico, descritas nos Anexos III.A, III.B e III.C deste documento, declaradas e assinadas pelo responsável legal e pelo responsável técnico.

c) Cópia de autorização do fabricante ou exportador no exterior, para o importador comercializar seu produto médico no País. Quando autorizado pelo exportador, o importador deverá demonstrar a relação comercial entre o exportador e o fabricante.

d) Para produtos médicos importados, comprovante de registro ou do certificado de livre comércio ou documento equivalente, outorgado pela autoridade competente de países onde o produto médico é fabricado e/ou comercializado.

e) Comprovante de cumprimento das disposições legais determinadas nos regulamentos técnicos, na forma da legislação da ANVISA que regulamenta os produtos médicos.

6. Os fabricantes ou importadores que solicitarem o registro de produtos médicos enquadrados na classe I, devem apresentar à ANVISA os documentos indicados nos itens 5(a), 5(b) e 5(e).

7. A ANVISA avaliará a documentação apresentada para registro, alteração ou revalidação do registro e se manifestará através de publicação no Diário Oficial da União - DOU.

8. A avaliação da documentação será realizada nos prazos e condições legais previstas na legislação sanitária.

9. Para solicitar a alteração do registro de produto médico, o fabricante ou importador deve apresentar no mínimo o documento requerido no item 5(a), Anexo III.A preenchido e demais documentos exigidos para o registro original do produto, cuja informação foi modificada.

10. Para solicitar a revalidação do registro de produto médico, o fabricante ou importador deve apresentar o documento requerido no item 5(a), assim como o Anexo III.A preenchido. Esta informação deverá ser apresentada no prazo previsto pela legislação sanitária, o que não interromperá a comercialização do produto até o vencimento de seu registro.

11. O fabricante ou importador detentor do registro de produto médico, pode solicitar o cancelamento do registro mediante a apresentação do Anexo III.A preenchido.

12. Está isento de registro o acessório produzido por um fabricante exclusivamente para integrar produto médico de sua fabricação já registrado e cujo relatório técnico (Anexo III.C) do registro deste produto, contenha informações sobre este acessório. Os novos acessórios poderão ser anexados ao registro original, detalhando os fundamentos de seu funcionamento, ação e conteúdo, na forma do item 9 da Parte 3 deste documento.

001206

13. O registro de produtos de saúde terá validade por 5 (cinco) anos, podendo ser revalidado sucessivamente por igual período.

PARTE 4 - Conformidade às Informações

1. Qualquer alteração realizada pelo fabricante ou importador nas informações previstas neste regulamento, referidas no item 5 da Parte 3 deste documento, deve ser comunicada à ANVISA dentro de 30 (trinta) dias úteis, na forma do item 9 da Parte 3 deste documento.

2. Toda comunicação ou publicidade do produto médico veiculada no mercado de consumo, deve guardar estrita concordância com as informações apresentadas pelo fabricante ou importador à ANVISA.

PARTE 5 - Sanções Administrativas

1. Como medida de ação sanitária e a vista de razões fundamentadas, a ANVISA suspenderá o registro de produto médico nos casos em que:

a) for suspensa, por razão de segurança devidamente justificada, a validade de qualquer um dos documentos referidos no item 5 da Parte 3 deste documento;

b) for comprovado o não cumprimento de qualquer exigência da Parte 4 deste regulamento;

c) o produto estiver sob investigação pela autoridade sanitária competente, quanto a irregularidade ou defeito do produto ou processo de fabricação, que represente risco à saúde do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos, devidamente justificada.

2. A ANVISA cancelará o registro do produto médico nos casos em que:

a) for comprovada a falsidade de informação prestada em qualquer um dos documentos a que se refere o item 5 da Parte 3 deste regulamento, ou for cancelado algum daqueles documentos pela ANVISA;

b) for comprovada pela ANVISA de que o produto ou processo de fabricação pode apresentar risco à saúde do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos.

3. A suspensão do registro de produto médico será publicada no Diário Oficial da União - DOU pela ANVISA e será mantida até a solução do problema que ocasionou a sanção e sua anulação será comunicada através do DOU.

4. O cancelamento do registro de produto de saúde será publicado no DOU pela ANVISA.

ANEXO I

DEFINIÇÕES

As definições seguintes aplicam-se exclusivamente a este documento, podendo ter significado distinto em outro contexto.

01 - Acessório: Produto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto médico, outorgando a esse produto uma função ou característica técnica complementar.

02 - Consumidor: Pessoa física que utiliza um produto médico como destinatário final.

03 - Fabricante: Qualquer pessoa que projeta, fabrica, monta ou processa no País um produto médico acabado, incluindo terceiros autorizados para esterilizar, rotular e/ou embalar este produto.

04 - Família de produtos médicos: Conjunto de produtos médicos, onde cada produto possui as características técnicas descritas nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do Relatório Técnico (Anexo III.C) semelhantes.

05 - Instruções de uso: Manuais, prospectos e outros documentos que acompanham o produto médico, contendo informações técnicas sobre o produto.

06 - Importador: Pessoa jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividade de ingressar no Pais produto médico fabricado fora do mesmo.

07 - Instrumento cirúrgico reutilizável: Instrumento destinado a uso cirúrgico para cortar, furar, serrar, fresar, raspar, grampear, retirar, pinçar ou realizar qualquer outro procedimento similar, sem conexão com qualquer produto médico ativo e que pode ser reutilizado após ser submetido a procedimentos apropriados.

08 - Lote: Quantidade de um produto médico elaborada em um ciclo de fabricação ou esterilização, cuja característica essencial é a homogeneidade.

09 - Operador: Pessoa que desenvolve atividade profissional utilizando um produto médico.

10 - Orificio do corpo: Qualquer abertura natural do corpo humano, incluindo a cavidade ocular ou qualquer abertura artificialmente criada tal como um estoma.

11 - Pesquisa clínica: Investigação utilizando seres humanos, destinada a verificar o desempenho, segurança e eficácia de um produto par saúde, na forma da legislação sanitária que dispõe sobre esta matéria.

12 - Prazos: Transitório: Até 60 minutos de uso contínuo.
Curto prazo: Até 30 dias de uso contínuo.
Longo prazo: Maior que 30 dias de uso contínuo.

13 - Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.

13.1 - Produto médico ativo: Qualquer produto médico cujo funcionamento depende fonte de energia elétrica ou qualquer outra fonte de potência distinta da gerada pelo corpo humano ou gravidade e que funciona pela conversão desta energia. Não são considerados produtos médicos ativos, os produtos médicos destinados a transmitir energia, substâncias ou outros elementos entre um produto médico ativo e o paciente, sem provocar alteração significativa.

13.2 - Produto médico ativo para diagnóstico: Qualquer produto médico ativo, utilizado isoladamente ou em combinação com outros produtos médicos, destinado a proporcionar informações para a detecção, diagnóstico, monitoração ou tratamento das condições fisiológicas ou de saúde, enfermidades ou deformidades congênitas.

13.3 - Produto médico ativo para terapia: Qualquer produto médico ativo, utilizado isoladamente ou em combinação com outros produtos médicos, destinado a sustentar, modificar, substituir ou restaurar funções ou estruturas biológicas, no contexto de tratamento ou alívio de uma enfermidade, lesão ou deficiência.

13.4 - Produto médico de uso único: Qualquer produto médico destinado a ser usado na prevenção, diagnóstico, terapia, reabilitação ou anticoncepção, utilizável somente uma vez, segundo especificado pelo fabricante.

13.5 - Produto médico implantável: Qualquer produto médico projetado para ser totalmente introduzido no corpo humano ou para substituir uma superfície epitelial ou ocular, por meio de intervenção cirúrgica, e destinado a permanecer no local após a intervenção. Também é considerado um produto médico implantável, qualquer produto médico destinado a ser parcialmente introduzido no corpo humano através de intervenção cirúrgica e permanecer após esta intervenção por longo prazo.

13.6 - Produto médico invasivo: Produto médico que penetra total ou parcialmente dentro do corpo humano, seja através de um orifício do corpo ou através da superfície corporal.

13.7 - Produto médico invasivo cirurgicamente: Produto médico invasivo que penetra no interior do corpo humano através da superfície corporal por meio ou no contexto de uma intervenção cirúrgica.

14 - Responsável legal: Pessoa física com poderes suficientes para representar um fabricante ou importador, seja

001208

em virtude de caráter societário ou por delegação.

15 - Responsável técnico: Profissional de nível superior, capacitado nas tecnologias que compõem o produto, responsável pelas informações técnicas apresentadas pelo fabricante ou importador e pela qualidade, segurança e eficácia do produto comercializado.

16 - Rótulo: Identificação impressa aplicada diretamente sobre a embalagem do produto médico.

17 - Sistema circulatório central: Inclui os seguintes vasos: artérias pulmonares, aorta ascendente, artérias coronárias, artéria carótida primitiva, artéria corótida interna, artéria carótida externa, artérias cerebrais, tronco braquiocefálico, veias cardíacas, veias pulmonares, veia cava superior e veia cava inferior.

18 - Sistema nervoso central: Inclui o cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinal.

ANEXO II

CLASSIFICAÇÃO

I. Aplicação

1. A aplicação das regras de classificação deve ser regida pela finalidade prevista dos produtos médicos.

2. Se um produto médico se destina a ser usado em combinação com outro produto médico, as regras de classificação serão aplicadas a cada um dos produtos médicos separadamente. Os acessórios serão classificados por si mesmos, separadamente dos produtos médicos com os quais são utilizados.

3. Os suportes lógicos (software) que comandam um produto médico ou que tenham influência em seu uso, se enquadrarão automaticamente na mesma classe.

4. Se um produto médico não se destina a ser utilizado exclusiva ou principalmente em uma parte específica do corpo, deverá ser considerado para sua classificação seu uso mais crítico.

5. Se a um mesmo produto médico são aplicáveis várias regras, considerando o desempenho atribuído pelo fabricante, se aplicarão as regras que conduzam a classificação mais elevada.

6. Para fins da aplicação desta classificação de produtos médicos à legislação aprovada anteriormente a este documento, se procederá da seguinte forma :
a) Classe 1 anterior corresponde à Classe I deste documento;
b) Classe 2 anterior corresponde à Classe II deste documento;
c) Classe 3 anterior corresponde às Classes III e IV deste documento.

II. Regras

1. Produtos Médicos Não-Invasivos

Regra 1

Todos produtos médicos não invasivos estão na classe I, exceto aqueles aos quais se aplicam as regras a seguir.

Regra 2

Todos produtos médicos não-invasivos destinados ao armazenamento ou condução de sangue, fluidos ou tecidos corporais, líquidos ou gases destinados a perfusão, administração ou introdução no corpo, estão na Classe II:
a) se puderem ser conectados a um produto médico ativo da Classe II ou de uma Classe superior;
b) se forem destinados a condução, armazenamento ou transporte de sangue ou de outros fluidos corporais ou armazenamento de órgãos, partes de órgãos ou tecidos do corpo;

001211

transmissíveis, enquadram-se na Classe III, a não ser que se trate de produtos médicos implantáveis ou de produtos médicos invasivos destinados a uso de longo prazo, neste caso pertencem à classe IV.

Regra 15

Todos produtos médicos destinados especificamente a desinfectar, limpar, lavar e, se necessário, hidratar lentes de contato, enquadram-se na Classe III.
Todos produtos médicos destinados especificamente a desinfectar outros produtos médicos, enquadram-se na Classe II.
Esta regra não se aplica aos produtos destinados à limpeza de produtos médicos, que não sejam lentes de contato, por meio de ação física.

Regra 16

Os produtos médicos não-ativos destinados especificamente para o registro de imagens radiográficas para diagnóstico, enquadram-se na Classe II.

Regra 17

Todos produtos médicos que utilizam tecidos de origem animal ou seus derivados tornados inertes, enquadram-se na Classe IV, exceto quando tais produtos estejam destinados unicamente a entrar em contato com a pele intacta.

Regra 18

Não obstante o disposto nas outras regras, as bolsas de sangue enquadram-se na Classe III.

ANEXO III.A

>> FORMULÁRIO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DE PRODUTOS MÉDICOS (em formato PDF)

ANEXO III.B

INFORMAÇÕES DOS RÓTULOS E INSTRUÇÕES DE USO DE PRODUTOS MÉDICOS

1.Requisitos Gerais

1.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso devem estar escritas no idioma português.

1.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas nas embalagens dos produtos enquadrados nas Classes I e II, desde que a segurança de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções.

1.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto e/ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade disto, no rótulo de sua embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais produtos médicos.

1.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados, devem estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação que acompanha o produto médico.

1.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme aplicável.

001212

2. Rótulos

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações:

2.1 A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme o caso.

2.2 As informações estritamente necessárias para que o usuário possa identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem;

2.3 Quando aplicável, a palavra "Estéril";

2.4 O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de série, conforme o caso;

2.5 Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança;

2.6 Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso único;

2.7 As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto médico;

2.8 As instruções para uso do produto médico;

2.9 Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas;

2.10 Quando aplicável, o método de esterilização;

2.11 Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a função;

2.12 Número de registro do produto médico, precedido da sigla de identificação da ANVISA.

3. Instruções de Uso

O modelo das instruções de uso deve conter as seguintes informações, conforme aplicáveis:

3.1 As informações indicadas no item 2 deste anexo (rótulo), exceto as constantes nas alíneas 2.4 e 2.5;

3.2 O desempenho previsto nos Requisitos Gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis;

3.3 Caso um produto médico deva ser instalado ou conectado a outros produtos para funcionar de acordo com a finalidade prevista, devem ser fornecidas informações suficientemente detalhadas sobre suas características para identificar os produtos que podem ser utilizados com este produto, para que se obtenha uma combinação segura;

3.4 Todas as informações que possibilitem comprovar se um produto médico encontra-se bem instalado e pode funcionar corretamente e em completa segurança, assim como as informações relativas à natureza e freqüência das operações de manutenção e calibração a serem realizadas de forma a garantir o permanente bom funcionamento e a segurança do produto;

3.5 Informações úteis para evitar determinados riscos decorrentes da implantação de produto médico;

3.6 Informações relativas aos riscos de interferência recíproca decorrentes da presença do produto médico em investigações ou tratamentos específicos;

3.7 As instruções necessárias em caso de dano da embalagem protetora da esterilidade de um produto médico esterilizado, e, quando aplicável, a indicação dos métodos adequados de reesterilização;

3.8 Caso o produto médico seja reutilizável, informações sobre os procedimentos apropriados para reutilização, incluindo a limpeza, desinfecção, acondicionamento e, conforme o caso, o método de esterilização, se o produto tiver de ser reesterilizado, bem como quaisquer restrições quanto ao número possível de reutilizações.

Caso o produto médico deva ser esterilizado antes de seu uso, as instruções relativas à limpeza e esterilização devem estar formuladas de forma que, se forem corretamente executadas, o produto satisfaça os requisitos previstos nos Requisitos Gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos;

3.9 Informação sobre tratamento ou procedimento adicional que deva ser realizado antes de se utilizar o produto médico (por exemplo, esterilização ou montagem final, entre outros).

3.10 Caso um produto médico emita radiações para fins médicos, as informações relativas à natureza, tipo, intensidade e distribuição das referidas radiações, devem ser descritas.

As instruções de uso devem incluir informações que permitam ao pessoal médico informar ao paciente sobre as contra-indicações e as precauções a tomar. Essas informações devem conter, especificamente:

3.11 As precauções a adotar em caso de alteração do funcionamento do produto médico;

3.12 As precauções a adotar referentes à exposição, em condições ambientais razoavelmente previsíveis, a campos magnéticos, a influências elétricas externas, a descargas eletrostáticas, à pressão ou às variações de pressão, à aceleração e a fontes térmicas de ignição, entre outras;

3.13 Informações adequadas sobre o(s) medicamento(s) que o produto médico se destina a administrar, incluindo quaisquer restrições na escolha dessas substâncias;

3.14 As precauções a adotar caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico associado à sua eliminação;

3.15 Os medicamentos incorporados ao produto médico como parte integrante deste, conforme o item 7.3 da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde;

3.16 O nível de precisão atribuído aos produtos médicos de medição.

ANEXO III.C

RELATÓRIO TÉCNICO

1. O relatório técnico deve conter as seguintes informações:

1.1. Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto;

1.2. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, segundo indicado pelo fabricante;

1.3. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e transporte;

1.4. Formas de apresentação do produto médico;

1.5. Diagrama de fluxo contendo as etapas do processo de fabricação do produto médico com uma descrição resumida de cada etapa do processo, até a obtenção do produto acabado;

1.6. Descrição da eficácia e segurança do produto médico, em conformidade com a regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Eficácia e Segurança de Produtos Médicos. No caso desta descrição não comprovar a eficácia e segurança do produto, a ANVISA solicitará pesquisa clínica do produto.

001214

2. No caso de registro de produto médico enquadrado na Classe I, o Relatório Técnico deve conter as informações previstas do item 1.1 a 1.4 deste Anexo.

Copyright © 2003 - Anvisa

001215

Produtos para a Saúde

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

O cadastro de produtos para a saúde, conforme previsto no § 1º do Art. 25 da Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976, foi atualizado através da Resolução ANVISA RDC nº 24 de 23 de março de 2009. Complementarmente, a Instrução Normativa ANVISA IN nº 00 traz a lista de exceções dos produtos classes de risco I e II que ainda permanecem no regime de registro. Os produtos cadastrados são os enquadrados como dispensados de registro conforme art. 25 da Lei nº 6360/76, existem ainda os produtos que não são considerados produtos para saúde, que embora relacionados com atividades voltadas para saúde, não necessitam de registro ou cadastro junto a Anvisa para serem comercializados no país.

A seguir seguem as listas dos produtos para saúde classe I e II que devem ser registrados na Anvisa e os produtos não considerados produtos para saúde:

(a) IN nº 7, de 17 de junho de 2009 – produtos para saúde classe I e II que devem ser registrados (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01

Copyright © 2003 - Anvisa

fls 91

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa

Atualizado em 31/08/2017

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
    - 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
    - 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde

30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)

87 VL

001218

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME		
CNPJ	19.973.704/0001-79	**Autorização**	8.10.948-0
Produto	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA RESGATE SP		

Modelo Produto Médico

Adulto; Infantil; Nas cores amarelo, vermelho, laranja e azul.

Nome Técnico	Imobilizador Ortopedico
Registro	81094800005
Processo	25351.669834/2014-34
Origem do Produto	• FABRICANTE: ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

88

001219

INDREL
SCIENTIFIC

INDREL REFRIMED - LINHA DE REFRIGERADORES DE SANGUE, VACINAS, LABORATORIAL E TERMOLÁBEIS.

MANUAL DO USUÁRIO

É IMPRESCINDÍVEL A LEITURA DESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO

REGISTRO ANVISA Nº 10253020013

Rev. 03

Sumário

001220

1 - INTRODUÇÃO 3
2 - SIMBOLOGIA 4
2.1 Simbologia 4
2.2 Simbologias da Embalagem 4
3 - ADVERTÊNCIAS 4
4 - LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO 5
5 - INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O EQUIPAMENTO 7
5.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS 9
Gabinete externo 9
Gabinete interno 9
Gavetas/ Prateleiras/bandejas/ racks 9
Possuem contra portas/tampas de acesso horizontal ou vertical individuais / por compartimento (dependendo do modelo ou linha) válvula de alívio de pressão evitando formação de vácuo interno. 10
Isolamento térmico 10
Tampa basculante 10
Porta vertical/horizontal cega ou de vidro (dupla ou tripla) "NO FOG" - antiembaçante 10
Puxador anatômico 10
Sistema de segurança cadeado, sistema biométrico ou cartão magnético (opcional) / Sistema de controle de acesso de segurança (opcional) 10
Sistema de controle de acesso de segurança/ travamento de painel 10
Sistema de conta portas / contra tampas (opcional) 11
Sistema de compressor 11
Sistema solar para alimentação elétrica/ backup, via placa solar (opcional) 11
Sistema de ventilação interna 12
Termostato de segurança/ redundância 12
Termômetro gráfico / registrador gráfico (opcional) 12
Condensador 12
Evaporador 12
Iluminação interna 12
Solução diatérmica 13
Blocos/ frascos criogênicos (opcional) 13
Multisensores de temperatura (opcional) 13
Sistema de Comando/ Controlador de painel digital LED 13
Sistema de Comando/ Controlador digital LCD 13
Sistema de Comando/ Controlador digital TOUCH SCREEN 14
Painel vivo 15
Controlador de temperatura com sistema P.I.D / Dataloger/ C.L.P./ P.W.M/ MPPT (opcional) 15
Software de gerenciamento/ monitoramento de dados Indrel (opcional) 15
Saída serial RS485/ RS232 (opcional) 15
Saída serial com porta de comando 4/20 mA (opcional sai somente incluso de fabrica) 15
Controlador com comunicação serial em protocolo Modbus (opcional) 15
TAGS de monitoramento remoto (opcional) 15
Sistema de armazenamento de dados através de pendrive ou memória interna/data logger (item opcional para LCD, Touch Screen) 16
Conexão para alarme remoto externo (12V ou contato seco) para acionamento de sirene ou dispositivo compatível (opcional) 16
Sistema de imagens com gerenciamento de vídeo via internet (opcional) ..... **Erro! Indicador não definido.**
Sistema de monitoramento/ transmissor sem fio - (WI-FI) - Nuvem Indrel (opcional) 16
Sistema de Teste de Alarme (opcional) 16
Leitor de código de barras para controle de estoque de produtos armazenados diretamente no painel / RFID (opcional) 16
Chave geral e supressor de surtos/ filtro contra ruídos 16
Discadora telefônica com no mínimo 09 memórias para fixo / celular (opcional) 16
Sistema de envio de mensagem SMS (opcional) 17
Relógio/ calendário com bateria interna 17
Sistema de emergência para falta de energia de até 96 horas - baterias (opcional) 18
Estabilizador de voltagem (opcional) 18
Controlador de tensão / Phaselog (opcional) 18
Impressora térmica com bobina de papel (opcional 18
Qualificação térmica QO, QP, QI (opcional) 18

Certificado de calibração padrão RBC para controladores, por laboratório acreditado (opcional) 18
6 – DADOS TÉCNICOS 19
6.1 – TABELA GERAL DE PRODUTOS 19
6.2 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 20
7 – PAINEL DE CONTROLE 21
7.1 - LIMITES DE TEMPERATURA DE TRABALHO 21
7.2 – CONTROLADORES IRL 234 21
7.3 CONTROLADOR LCD 23
7.4 CONTROLADOR LCD2 28
7.5 CONTROLADOR TOUCH SCREEN 33
8 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA 42
8.1 - Manutenção Preventiva 43
8.2 - Manutenção Corretiva 44
9 - EMBALAGEM E ARMAZENAGEM 44
9.1 - EMBALAGEM 44
9.2 - ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO EMBALADO 45
9.3 - ARMAZENAMENTOS DE COMPONENTES NO EQUIPAMENTO 45
9.4 - TRANSPORTE 45
10 - PROBLEMAS E CAUSAS PROVÁVEIS 46
11 - CERTIFICADO DE GARANTIA 48
ANEXO I 49

1 - INTRODUÇÃO

O objetivo deste manual é dar ao proprietário e usuários as informações necessárias para o perfeito funcionamento e manuseio do equipamento, passo a passo para eventuais ajustes de temperatura ou a reprogramação dos parâmetros operacionais estabelecidos em fábrica.
Cuidados e providências desde a entrega do equipamento, a localização, a instalação e o procedimento para o primeiro funcionamento.
O manual deve estar sempre acessível para qualquer dúvida, próximo ao produto e de fácil utilização pelos usuários do mesmo.
Todos os modelos são projetados de acordo com as normas Internacionais ABHH/AABB, assim como os critérios da marca FDA e ISO 13485 a fim de garantir a qualidade do desempenho e segurança dos produtos armazenados.
Estamos orgulhosos pela sua escolha por equipamentos INDREL, produtos de alta tecnologia, resultado de nossa longa história na garantia de qualidade em refrigeração médico laboratorial e científica.
Além das informações aqui contidas, se algum ponto deste manual não estiver claro ou impreciso, você poderá contar também com o apoio do nosso departamento técnico pelo contato direto através do e-mail: suporte@indrel.com.br.
Com a Nota Fiscal de compra, número de Série do equipamento e o Certificado de Garantia devidamente preenchido, o primeiro usuário terá direito ao serviço gratuito de assistência técnica dentro do período de vigência e garantia (ver certificado).
Devido ao alto nível da nossa tecnologia e as frequentes atualizações tecnológicas, a INDREL coloca-se em total liberdade para eventuais alterações do mesmo sem aviso prévio.
É proibido reproduzir este manual, direitos reservados a INDREL.
A leitura deste manual é de suma importância para seu perfeito funcionamento e longa vida útil do produto.
Os equipamentos são ajustados com padrões pré-configurados de fábricas e chegam ao cliente pronto para utilização, não necessitando nenhum ajuste adicional ao iniciar seu trabalho.

2 - SIMBOLOGIA

2.1 Simbologia

SIMBOLOGIA			
	Cuidado		Corrente alternada
	Perigo de descarga elétrica		Desligado
	Superfície quente		Ligado
	Superfície fria		Cuidado com as mãos
	Terminal de aterramento para proteção		Terminal de aterramento geral
	Falta de Rede (Energia)		Alarme Sonoro
	Min/Max		Luz interna

2.2 Simbologias da Embalagem



3 - ADVERTÊNCIAS

Antes de instalar, utilizar ou realizar manutenção no seu equipamento INDREL, por favor, o manual de instruções e as etiquetas de advertência presente no equipamento com cuidado. O não cumprimento destas instruções pode provocar uma avaria no equipamento e resultar em ferimentos ou danos.
Abaixo estão as precauções de segurança importantes aplicáveis ao nosso equipamento:

ADVERTÊNCIA!
Uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos graves ou morte.

CUIDADO!
Uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves, moderados ou danos ao usuário.

Utilize este aparelho apenas conforme descrito no manual e na sua literatura e por pessoas habilitadas;

Não modificar componentes do equipamento, especialmente o controlador. Utilizar componentes de substituição de peças e partes do equipamento somente da marca INDREL. Antes do uso, confirmar que o produto não tenha sido alterado de alguma forma original;

Desligue o equipamento de todas as fontes de energia antes de limpar, resolver problemas ou realizar outra manutenção no equipamento;

Não tocar em nenhuma peça elétrica (tais como o "plug" da fonte de alimentação) e nem operar os interruptores com as mãos molhadas. Isto pode causar choque elétrico;

O equipamento deve ser devidamente ligado ao ponto terra, em conformidade com a rede elétrica local e/ou nacional de dispositivos elétricos. Nunca ligue o equipamento em fonte de alimentação sobrecarregada;

O cabo de alimentação deve ser conectado em uma tomada fixada permanentemente na parede ou bancada, de acordo com as normas e legislações vigentes para instalações elétricas de baixa tensão e legislações elétricas para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, nunca utilize extensões, adaptadores e tomadas multiplas;
É recomendável utilizar na rede de alimentação do equipamento uma chave blindada com fusíveis de proteção ou de disjuntores, compatíveis com a capacidade do equipamento;
Esse equipamento funciona com sistema microprocessador em painel de LED, LCD ou Touch Screen, assim requer uma rede estabilizada e um bom aterramento

Não acione as teclas de comando com a unha, e também não utilize objetos pontiagudos para acioná-las podendo assim prejudicar o sistema de comando e painéis;

Não forre as prateleiras ou gavetas com toalhas, plásticos ou outros materiais que possam prejudicar a circulação do ar no interior do equipamento;
Recomenda-se distribuir as cargas uniformemente nas prateleiras ou gavetas;
Mantenha a porta da câmara sempre fechada e evite abri-la desnecessariamente. Certifique-se de que não há nada dificultando o fechamento da porta ou seu uso;

Não utilize panos, toalhas ou outros produtos semelhantes sobre o equipamento, para não obstruir o fechamento da porta;

Mantenha a porta da câmara sempre fechada e evite abri-la desnecessariamente;
Certifique-se de que não há nada dificultando o fechamento da porta ou seu uso;
Não utilize panos, toalhas ou outros produtos semelhantes sobre o equipamento, para não obstruir o fechamento da porta;

Este equipamento possui um sistema de isolamento térmico de alta densidade em poliuretano injetado 70 mm a 150 mm. Em dias onde a umidade do ar estiver elevada ou conforme condições climáticas locais o equipamento pode apresentar suor excessivo (gotículas de água) na parte externa. Limpe o equipamento com um pano macio e seco.

Para sua segurança, realize apenas a manutenção prevista nesse manual e trabalhos técnicos com equipe qualificada e credenciada INDREL;

⚠ Não coloque qualquer recipiente com água ou artigos pesados em cima do equipamento, isto pode causar ferimentos caso os mesmos caiam. A água derramada pode provocar vazamento de corrente ou choque elétrico.
Ao manusear os produtos, deve-se usar o menor tempo possível em cada abertura de porta.



Em momento algum se deve tombar o equipamento por mais de 45°. Utilizem nossa rede de assistentes técnicos credenciados – Fone (43) 3378 5500.
Os serviços prestados por equipe técnica para instalação de qualquer equipamento Indrel não deverá ser pago pelo cliente. Rede credenciada e treinada para todo território nacional.

4 - LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

Observações necessárias; o local para instalação do aparelho deve ser arejado e longe de fontes de calor, tais como raios solares, estufas, banho-maria e outros que possam interferir na temperatura do ambiente do equipamento (temperatura ambiente ideal sugerida para trabalho e longa vida útil do mesmo: 25°C). Não instale o equipamento onde estejam presentes vapores ácidos ou corrosivos, podem ocorrer dano ao equipamento ou choque elétrico devido à corrosão.

Características de Controle de Temperatura e Umidade de Ambiente	
Temperatura Ambiente (recomendado):	15°C a 35°C
Umidade relativa:	Máxima 80% para a temperatura até 31°C, que diminui linearmente à umidade relativa de 50% em 40°C.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Para um bom funcionamento do seu equipamento INDREL utilize uma tomada para conexão à rede elétrica (não ligue junto a outros equipamentos, nem com adaptadores ou uso de extensão).
- Se seu produto tiver opcional como discadora deverá ter uma linha telefônica exclusivo próximo para o equipamento.
- Para opcional WIFI deverá ter uma cobertura WIFI próximo ao equipamento.

INSTALAÇÃO

É muito simples e fácil, mas requer atenção para as seguintes observações:

- Ao receber o equipamento verifique se a embalagem encontra-se em perfeitas condições, sem marcas de atritos, quebras ou danos externos aparentes.
- Ao desembalar verifique se o equipamento tem sinal de maus tratos no transporte.

Importante: É necessário notificar a transportadora imediatamente se houver qualquer dano na embalagem / aparência.

- Retire a base de madeira removendo os parafusos, coloque os pés de NYLON reguláveis tipo sapata que acompanham o equipamento ou os rodízios com sistemas de freio, dependendo do modelo de seu equipamento, observando neste caso que os rodízios providos de freios devem ser posicionados na parte dianteira do equipamento para fácil manuseio. Fazer o nivelamento do mesmo, no sentido largura e profundidade.
- No local de instalação, deixar um espaço de no mínimo de 20 cm afastado da parede e 20 cm de cada lado, para permitir a perfeita ventilação do equipamento (caso tenham problemas de espaço ou dúvidas, favor entrar em contato com equipe Indrel).

⚠ ATENÇÃO: O equipamento é programado para acionar o alarme de temperatura após 20 minutos de sua energização. O tempo necessário para atingir a temperatura é de 3 a 6 horas.

⚠ ATENÇÃO – Antes de ligar o equipamento, remova os calços que fixam a unidade frigorífica e as serpentinas, os calços das gavetas ou prateleiras no interior do equipamento e verifique se a hélice do conjunto frigorífico está livre. Gire-a com a mão.

⚠ Antes de ligar a tomada certifique-se da tensão na rede se é de 110-127 ou 220-240 volts. Conecte em tomada exclusiva de boa qualidade e com fios de bitola mínima de 2,5 mm, com chave disjuntor de proteção exclusiva ou com fusíveis do tipo ação retardada de 20 Ampères (itens recomendados).
Após certificado das orientações acima, ligue o equipamento na energia e acione a chave geral (localizada na parte superior ao fundo do equipamento ou embaixo abrindo o painel).

⚠ No primeiro funcionamento deixe o produto ligado por um período médio de 3 a 6 horas (dependendo do modelo e temperatura de trabalho), para estabilizar a temperatura antes do início do armazenamento.
O período de garantia contra defeitos de fabricação é de 12 (doze) meses, (salvo observações em contrário, especialmente observadas na nota fiscal), a partir da data da emissão da Nota Fiscal do fabricante ou revendedor ao primeiro proprietário.
Os equipamentos INDREL possuem filtros eletrônicos contra ruídos eletromagnéticos contra interferências externas de produtos ou de rede local. Recomendamos a utilização de sistemas de estabilizadores de voltagem ou sistemas de segurança tipo no-breaks (safety-system Indrel ou nobreaks – ver opcionais) caso tenham alto índice de variações ou constantes "apagões" no local de instalação dos produtos. Para maiores detalhes entre em contato com nossa departamento de suporte técnico para orientações quanto a capacidades e autonomias dos sistemas.
Estes produtos são equipados com interruptor liga e desliga, localizado na parte posterior, protegido por uma tampa. O interruptor é enviado na posição desligada para evitar descarga da bateria do equipamento. Após conectar o

equipamento à tomada de força adequada, proceder a ligação do interruptor geral do equipamento, o que provocará a iniciação imediata de funcionamento do equipamento.

FIO TERRA:

Todos os equipamentos INDREL possuem em seu cabo de força a ligação para fio terra. Pedimos para conectar o fio terra do seu produto a um cabo terra eficiente, evitando riscos a quaisquer pessoas próximas ao produto. A ligação do fio terra é necessária em qualquer tensão (110v ou 220v) e em qualquer produto eletroeletrônico, não devendo ser conectado ao fio neutro da rede, tubulações elétricas, hidráulicas, de gás entre outras. Para execução do aterramento, siga as normas da ABNT-NBR 5410 Seção "ATERRAMENTO" ou chame um eletricista de sua confiança.

5 - INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O EQUIPAMENTO

Equipamento projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de produtos como sangue, hemoderivados, hemocomponentes, reagentes, remédios, medicamentos e assemelhados, imunobiológicos, termolábeis, amostras biológicas, orgãos e tecidos humanos, componentes celulares, enzimas, DNA, lipídios, culturas, componentes de anatomia e células.
Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde, laboratórios e centros de pesquisas científicas e industriais, empresas da área médico hospitalar, hemocentros, lactários, enzimologia, engenharia genética, perícias judiciais, laboratórios farmacêuticos.

5.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS

Todos os modelos oferecem a mais alta tecnologia em refrigeração médico, hospitalar, laboratorial e cientifica, atendendo aos requisitos estabelecidos pela O.M.S (Organização Munidial da Saúde), pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) com certificados e registros. Os equipamentos possuem uniformidade e ráp ida recuperação de temperatura. Fabricados com todo seu interior em aço inoxidável e isolamento de alta eficiência, com sistema de comandos digitais em toda linha.
A informações deste manual são referente aos modelos:
CI3D, RVH137D, RVH137D/2, RVH137D SOLAR, RVH137D/2 SOLAR, BSG02D, RC02D, RVV11D, BSG04D, RC220D, RVV22D, BSG05D, RC330D, RVV440D, RVV430D, RC430D, RVV504D, RC504D, RC680D, RVV880D, RVV1500D, RC1500D, RVV1500D/2, RC1500D/2, RVV2000D, RC2000D

Gabinete externo

Equipamento projetado e desenvolvido de acordo com as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Fabricado em aço carbono (outras opções em aço inox AISI 430, AISI 304) DESIGN diferenciado retangular, estrutura robusta em aço carbono, que recebe tratamentos especiais para maior durabilidade, pintura é secada em alta temperatura, oferecendo acabamento esmerado e durável. Possui pintura com tratamento nanotecnológico de alta resistência e pintura eletrostática a pó, na cor redominante branca com pintura "anti-riscos".
*Opcional aço Inox AISI 316, AISI430, AISI304;
*Opcionais em aço inox externo liso ou escovado.
*Opcional acesso lateral (orifício), superior ou traseiro através de portas, portinholas ou dutos para passagem de sondas/sensores de qualificação.

- Provido com rodízios/ sapatas com freio e/ou pés tipo sapata em nylon, alumínio, polipropileno, poliamida, poliuretano ou borracha ou inox podendo ser ajustáveis em nível.
*Opcional de rodízios com freio nas rodas dianteiras de fácil travamento. Equipamentos com quatro ou seis rodas.

Gabinete interno

Câmara de armazenamento totalmente em aço inoxidável (Aço inox AISI 430 ou AISI 304) para perfeita assepsia, segurança do produto e longa durabilidade. Possui sistema de compartimentos (gavetas ou prateleiras) telescópicos construídos em aço inoxidável sobre rodízios simples duplo ou triplo (dependendo do modelo) removíveis e/ou ajustáveis. Possuem contra portas/tampas de acesso horizontal ou vertical (dependendo modelo ou linha).
*Opcional válvula de alívio de pressão evitando formação de vácuo interno, possibilitando a fácil abertura de porta pelo cliente.

Gavetas/ Prateleiras/bandejas/ racks

Possui sistema de compartimentos de trilhos ou corrediças telescópicas em aço inoxidável (AISI 430, AISI 304) sobre rodízios simples, duplo ou triplo (dependendo do modelo) removíveis e/ou ajustáveis. Gavetas com sistema de trava, permitindo trazer ela totalmente para o lado externo do gabinete, sem riscos de quedas acidentais.
* Opcional de prateleiras ou gavetas em alumínio, aço pintado, aço inox AISI 316;

Possuem contra portas/tampas de acesso horizontal ou vertical individuais / por compartimento (dependendo do modelo ou linha) válvula de alivio de pressão evitando formação de vácuo interno.

*Opcional contra portas/tampas de acesso horizontal ou vertical
*Opcional de prateleiras, gavetas, bandejas ou racks em alumínio, aço pintado, aço inox AISI430, AISI304 ou AISI 316.

Isolamento térmico

Os equipamentos possuem isolamento térmico de alta densidade em poliuretano injetado expandido, livre de CFC, com espessura mínima de 70 mm a 150 mm nas paredes, evitando assim sudação nas paredes e com ótimo rendimento para controle da temperatura interna. Material livre de CFC (Clorofluorcarbono - Free).
*Possibilidades de isolamentos especiais, como item opcional: Possuir isolamento a vácuo com misturas INDREL (diminui a espessura da parede do equipamento).

Tampa basculante/Tampa removível

Tampa basculante frontal ou traseira para limpeza da unidade condensadora (depende do modelo adquirido).

Porta vertical/horizontal cega ou de vidro (dupla ou tripla) "NO FOG" – antiembaçante

Porta fechada tipo "cega", de acesso vertical ou horizontal com gaxeta simples, dupla ou tripla nos quatro lados – magnética em PVC ou silicone, dobradiças. Sistema de fechadura com chave de segurança.
*Opcional porta de vidro (dupla ou tripla) " NO FOG " - antiembaçante. Modelo com acabamento fino e de alta resistência, com exclusivo sistema de fechamento automático da porta por dobradiças especiais. Para este opcional o produto trabalha com sistema de temporização automática da luz interna por acionamento programado em painel digital. Tem seu funcionamento por sistema direto no painel sem abertura de porta para total visualização por 60 segundos reguláveis (Comando LCD e Touch Screen).
* Porta de vidro deslizante de abertura e fechamento automático (opcional);
* Opcional com 02 portas externas para fácil acesso.
* Opcional sistema de segurança com cadeado, sistema de biométrico, cartão magnético, tecnologia mobile, chave e fechadura, senha eletrônica.
* Opcional de sistema de autofechamento das portas.
* Opcional sistema de travamento da porta aberta em 90°

Puxador anatômico

Para as portas/ tampas cegas ou de vidro contem puxador anatômico.

Sistema de segurança cadeado, sistema biométrico ou cartão magnético (opcional) / Sistema de controle de acesso de segurança (opcional)

Por cartões magnéticos sendo possível cadastrar de 09 a 10 cartões, biometria, tecnologia Mobile, chave na porta, senha eletrônica, chave e fechadura.

Sistema de controle de acesso de segurança/ travamento de painel

Possui sistema de proteção da programação dos controladores LED, LCD e Touch Screen através de senhas no painel, feito em 02 níveis de segurança. Protegendo contra alterações indevidas que podem comprometer o funcionamento do equipamento (usuário: acesso as funções de rotina e configurações básicas do equipamento/ técnico: acessa as funções de controle do equipamento). As configurações do equipamento são armazenadas em memória permanente mesmo em caso de falta de energia ou desligamento do equipamento.

Sistema de conta portas / contra tampas (opcional)

Sistema de contra portas/tampas internas serve para minimizar a troca de calor entre o produto e o ambiente externo podendo ser em inox ou acrílicas dependendo o modelo (consultar fabricante). São individuais por compartimento
*Opcional em acrílico transparente, alumínio, aço pintado, inox AISI 430, AISI 304, AISI 316 ou polímero de alta resistência.
* Opcional sistema de isolamento e fechamento magnético.

Sistema de compressor

Refrigeração
Dotado de sistema de refrigeração ecológico isento de C.F.C (Clorofluorcarbono), com compressor hermético AC com capacidade mínima de ¼ HP, selado, baixo consumo de energia e alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna após carregar o refrigerador, selado, montado sobre base especial que evita a transmissão de vibração para o produto armazenado, condensação a ar forçado ou estático, ultra silencioso.
Circulação de ar interna por ar foçado ou estático através de ventiladores interno ou convecção de frio garantindo uma distribuição térmica homogenea em todo o interior do gabinete. O sistema possui controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta. Mesmo em dias frios o sistema de controle de temperatura Indrel garante a estabilidade da temperatura interna sem a necessidade de elementos internos de aquecimento que podem causar variações indesejadas na temperatura interna da câmara.
A temperatura é controlada através de controlador eletrônico calibrado de acordo com as normas RBC (Rede Brasileira de Calibração), com sistema de exibição e registro das temperaturas de momento, máxima e de mínima no painel, podendo ser simultâneo. Os sensores encontram-se um imerso em solução diatérmica para controlar a temperatura efetiva do produto armazenado na câmara e os outros dentro do gabinete interno. O equipamento pode conter sensores adicionais para controle e segurança por gavetas.
O equipamento recupera a temperatura rapidamente em aproximadamente 15 minutos após recarga de produtos e abertura de porta, estabilizando a mesma em 4°C ou na temperatura configurada pelo cliente, mantendo assim a estabilidade térmica oferecendo maior segurança para o produto armazenado.
Alimentação 110-127 ou 220-240Volts - 50 ou 60 Hz.
*Opcional de produtos 12 / 24 volts.
*Opcional de comando duplo de compressores e de comando eletroeletrônico, sendo um compressor principal e um segundo acionando em caso de pane do principal mantendo o perfeito funcionamento de todas as funções do equipamento e de comando com acionamento de alerta no painel informando a falha ao usuário.
* Projetos especiais equipamentos fabricados em BIVOLT (opcional);
* Opcional compressores DC;

Sistema solar para alimentação elétrica/ backup, via placa solar (opcional)

Sistema de fonte de energia fotovoltaica por placa solar funcionando como um substituto para energia por rede elétrica ou baterias. Placa solar adquirida opcionalmente.
Sistema de backup de frio armazenado que possibilita a manutenção da temperatura interna do equipamento estabilizada em 4,0° C por até 144 horas (6 dias) mesmo sem luz solar ou durante uma semana chuvosa.
Composto de exclusivo sistema de backup de frio armazenado acoplado ao safety system, é possível manter a temperatura interna do equipamento estabilizada em 4,0° C por até 144 horas (6 dias) mesmo sem luz solar ou durante uma semana chuvosa. Exclusivo para modelos RVH 137D Solar e RVH 137D/2 solar.
- Dotado de dispositivo automático de recarga que não demanda consumo e nem adição de mecanismos extraordinários, bastando retorno da energia ou luz solar;
- Dotado ainda de dispositivo automático de alimentação que não demanda consumo e nem adição de mecanismos extraordinários, é realimentado de forma autônoma pelas placas solares ou pela energia elétrica convencional bastando retorno da energia elétrica ou da luz solar;
- Em regiões onde não há energia elétrica convencional, o equipamento mantém sua funcionalidade de forma independente apenas pela placa solar.

- Unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia (1/5 HP), refrigerante ecológico livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçado, gabinete externo em aço tratado com pintura epóxi a alta temperatura.

Sistema de ventilação interna

Circulação de ar interna por ar foçado através de ventiladores interno garantindo uma distribuição térmica homogenia em todo o interior do gabinete. O sistema possui controle de desligamento automático da ventilação em caso de abertura de porta. Mesmo em dias frios o sistema de controle de temperatura Indrel garante a estabilidade da temperatura interna sem a necessidade de elementos internos de aquecimento que podem causar variações indesejadas na temperatura interna da câmara.

Termostato de segurança/ redundância

Termostato de segurança analógico ou digital programado para controlar emergencialmente a temperatura interna caso o sistema principal pare de funcionar.

Termômetro gráfico / registrador gráfico (opcional)

O registrador gráfico registra continuamente as oscilações de temperatura do produto na câmara de armazenamento. Instalado junto do painel frontal (Superior ou Inferior).
Através de carta gráfica circular de 6 polegadas para 7 (sete) dias de duração e registros em modo contínuo e com suprimento fornecido para atender 12 meses.
Os equipamentos com REGISTRADOR GRÁFICO são sempre acompanhados de um manual específico do registrador com as instruções operacionais necessárias para o perfeito funcionamento.
Papel Indrel na cor verde de temperatura de 60°C a -40°C e de 0°C a -100°C. Caneta (pena gráfica) na cor azul para uso descartável (itens inclusos aos produtos com o opcional).
*Opcional de registro térmico ou Isento de tintas através do sistema Touch Screen.
*Opcional de registrador gráfico, eletromecânico de 05 polegadas para registro de 07 dias com sistema isento de tinta.

Condensador

Condensador de ar forçado de alta eficácia para equipamentos científicos, trocador de calor que utiliza o ar forçado para troca térmica entre o ambiente a parte interna do equipamento com rápida recuperação de temperatura, não utilizando condensador estático de linha doméstica.

Evaporador

Sistema de evaporadores Indrel por ar forçado que não necessita de degelo. Os refrigeradores Indrel são montados com uma alta tecnologia científica fazendo com que o equipamento funcione sem nenhum tipo de interrupção para degelo tanto da resistência como de ar quente, não mudando em nenhum momento a temperatura do ambiente interno do equipamento sem utilização de placa fria interna ao gabinete evitando qualquer problema de acúmulos de gelo ou riscos ao produto armazenado. Evitando assim a utilização de qualquer fonte de calor interna ao produto, tais como, resistências, gás quente entre outros. O degelo é automático seco com evaporação de condensado.
Com estes sistemas de condensadores e evaporadores científicos Indrel, o equipamento garante um perfeito armazenamento entre 2°C e 8°C (temperaturas recomendadas pela OMS e ANVISA para armazenamento), recuperando as temperaturas e evitando perdas com aberturas de porta de forma eficaz.
O tempo médio de recuperação e estabilidade de um equipamento científico Indrel é de 15 minutos após recarga de produtos.

Iluminação interna

Os produtos possuem iluminação interna em LED de alta eficiência e baixo consumo de energia. Com acionamento em painel externo, frontal de fácil acesso, podendo ser ligado e desligado a qualquer momento por período programável pelo usuário mesmo com porta fechada (não forçando o cliente abrir a porta para visualização do produto armazenado). Para o sistema de comando em LCD ou Touch Screen o

periodo de tempo de iluminação interna é programável pelo cliente. O acionamento da iluminação interna também ocorre automaticamente na abertura da porta por sistema automático.

Solução diatérmica

Os equipamentos possuem uma solução diatérmica com características termodinâmicas similares aos produtos armazenados dentro do equipamento. Assim os sensores imersos em solução, representam a temperatura real do produto armazenado e não somente do ar do gabinete.

Blocos/ frascos criogênicos (opcional)

Material criogênico para manutenção inercial de temperatura sem energia elétrica por sistema de troca de calor. Este material é fabricado especificamente para produtos Indrel, de uso permanente, não possuindo validade ou data para trocas. O produto não deve ser retirado e congelado para utilização em outros refrigeradores ou caixas de transportes.

Multisensores de temperatura (opcional)

Os sensores encontram-se posicionados em solução diatérmica para controlar a temperatura efetiva do produto armazenado na câmara e demais sensores de controle e segurança. O equipamento recupera rapidamente e mantém a estabilidade da temperatura oferecendo maior segurança ao produto armazenado, com até 06 sensores para LCD ou até 12 sensores para Touch Screen.

Sistema de Comando/ Controlador de painel digital LED

O controlador é um sistema eletrônico integrado em um único display frontal de fácil acesso, equipado com microprocessador de controle eletrônico digital, totalmente automático, parâmetros operacionais programados na fábrica para o perfeito funcionamento com senha de acesso, sensor controlador que indica a temperatura do produto na câmara de armazenamento (opção multisensores). Controlador e teclas (tipo membrana ou superior) com design sinóptico e visor digital para leitura de temperatura e ajuste eventual, alarmes audiovisuais de desvio de temperatura configurável de alta e baixa temperaturas, sinalizadores em lâmpadas LED que indicam equipamento energizado, sistemas de alarmes gerais, refrigeração em recuperação entre outros. Interruptor de silenciador do sistema de alarme e chave geral liga/desliga. Sistema de registros de momento, máxima e mínima temperatura diretamente no painel com memória, para total segurança em toda linha por até 06 sensores (opcional), sendo 01 direto em solução diatérmica para controlar a temperatura efetiva do produto armazenado na câmara e outros posicionados estrategicamente no gabinete interno. Podendo ser direcionado para monitoramento de cada gaveta.
Demais características:
- Sistema de senha de segurança de acesso.
- Sistema de restart com padrões de fábrica.
- Sistema com temperatura de momento, máxima e mínima registradas diretamente no painel.
> Modo multisensores de temperatura.
> Filtro contra ruídos eletromagnéticos.
> Sistema de controle dos alarmes:
Porta aberta.
Alarme de alta temperatura.
Alarme de baixa temperatura.
Alarme de falha de energia.
> Tecla silenciadora de alarmes (botão direto no painel).
> Tecla de acionamento de luz interna temporizada por 60 segundos sem abertura de porta. Com acionamento direto ao abrir a porta.
> Sistema de monitoramento de rede, restabelecendo parâmetros de programação em caso de variação brusca de energia elétrica (função acrescentada com o opcional phaselog).

Sistema de Comando/ Controlador digital LCD (opcional)

O controlador é um sistema eletrônico integrado em um único display frontal e comando unificado que realiza todas as funções necessárias para o funcionamento do equipamento.

Display de cristal líquido ou OLED com caracteres alfanuméricos e luz de fundo em LED para fácil visualização de leitura mesmo em ambientes escuros. Os caracteres são de grandes dimensões (big number) com área visível superior a 10 cm de largura. Possui teclas do tipo chave táctil - sensível ao toque e de longa durabilidade.
Seu sistema eletrônico é calibrado com padrões RBC de fábrica.
Entre as suas diversas funcionalidades estão:
>Temperaturas de MOMENTO, MÍNIMA e MÁXIMA exibidas simultaneamente em um único display, alternadamente com DATA/HORA e identificação dos ALARMES por escrito no painel, sem a necessidade de nenhum comando adicional para visualizar esses dados.
>Tecla de reset de mínima e máxima temperaturas direto no painel frontal superior.
>Possui porta USB para exportação de dados via pen drive que armazena dados periódicos de temperatura de todos os sensores, registro imediato de alarmes, eventos e parâmetros de ajustes (temperatura de operação e alarmes de temperatura alta e baixa).
> Sistema de memória interna (Data logger) com capacidade de armazenamento permanente para 30 anos de dados: temperaturas, eventos e alarmes com data e hora registradas. Os dados da memória interna são protegidos e codificados podendo ser exportados via pendrive para gerar relatórios em arquivos fechados tipo PDF.
> Sistema de relatório único, contendo gráfico de funcionamento, resumo do período, histórico de temperaturas com intervalos programáveis de 1 a 60 minutos.
>Alerta de memória cheia descrito em painel frontal, evitando perda de dados do equipamento.
>Software de gerenciamento de relatórios para os dados exportados da memória interna.
>Parâmetros do equipamento protegidos por senha, proporcionando maior segurança contra alterações de configurações por pessoas não autorizado.
>Sistema com 3 opções de idiomas: português, inglês e espanhol.
>Opcional de montagem de 1 a 6 sensores de temperatura independentes exibidos diretamente no Display frontal com registros individuais de MÍNIMA e MÁXIMA armazenados em memória interna. Estes sensores podem ser interno e externo ao equipamento. Internamente ficam em solução diatérmica em em locais / pontos selecionado pelo cliente.
>Sistema de acompanhamento de data e hora do último reset de mínima e máxima realizado diretamente no painel frontal.
>Identificação do tipo de alarme com descrição no display frontal.
>Identificação de parâmetros com descrição no display frontal.
>Alteração de parâmetros protegida por senha em dois níveis de acesso (usuário e técnico).
>Sistema de alarmes audiovisual em um só display frontal de: falta de energia elétrica, porta aberta, temperatura fora de faixa, alarme de bateria fraca, falha de sensor de temperatura, pendrive ausente, filtro sujo, degelo (quando utilizado), falha de memória interna, serviço de manutenção periódica, entre outros.
>Possui tecla dedicada para silenciamento temporário do alarme sonoro.
>Acionamento de discadora em caso de alarme.
>Controle de iluminação interna por LED.
>Sistema de relógio interno permanente, com bateria dedicada à função.
>Sistema de teste de alarmes (opcional).
>Sistema de auto teste das funções.

Sistema de Comando/ Controlador digital TOUCH SCREEN (opcional)

O controlador é um sistema eletrônico integrado em um único display frontal e comando unificado que realiza todas as funções necessárias para o funcionamento do equipamento.
Painel com display de cristal líquido ou OLED de 7 polegadas ou maior com múltiplas cores e tela sensível ao toque.
Entre as suas diversas funcionalidades estão:
>Temperaturas de MOMENTO, MÍNIMA e MÁXIMA exibidas simultaneamente em um único display com DATA/HORA e identificação dos ALARMES por escrito no painel. Exibição de gráfico em tempo real da temperatura de momento e nível de carga de bateria.
>Montagem de 1 a 12 sensores de temperatura independentes exibidos diretamente no Display frontal com registros individuais de MÍNIMA e MÁXIMA armazenados em memória interna.
>Histórico de temperaturas e eventos disponíveis para visualização na própria tela.

>Sistema de memória interna (Data logger) com capacidade de armazenamento permanente para 1 ano de dados: temperaturas, eventos e alarmes com data e hora registradas. Os dados da memória interna são protegidos e codificados podendo ser exportados via pendrive para gerar relatórios em arquivos fechados tipo PDF. Com possibilidade de expansão para até 30 anos de armazenamento.
> Parâmetros do equipamento protegidos por senha contra alterações de configurações por pessoas não autorizado.
> Sistema com 3 opções de idiomas: português, inglês e espanhol.
>Possibilidade de monitoramento da temperatura do ambiente externo.
>Interface USB frontal para exportar o conteúdo da memória para pendrive.
>Software de gerenciamento de relatórios para os dados exportados da memória interna.
>Possibilidade de criação de até múltiplos usuários, cada um com seu próprio login e senha com identificação de alterações de programação.
>Sistema de acompanhamento de data e hora do último reset de mínima e máxima realizado diretamente no painel frontal.
>Sistema de alarmes audiovisual em um só display frontal de: falta de energia elétrica, porta aberta, temperatura fora de faixa, alarme de bateria fraca, falha de sensor de temperatura, pendrive ausente, filtro sujo, degelo (quando utilizado), falha de memória interna, serviço de manutenção periódica, entre outros. Com possibilidade de silenciamento temporário do alarme sonoro.

Painel vivo

Sistema composto por uma bateria interna que mantém as funções do painel em funcionamento em caso de falta de energia elétrica.

Controlador de temperatura com sistema P.I.D / Dataloger/ C.L.P./ P.W.M/ MPPT (opcional)

Sistemas de controles opcionais para projetos e câmaras especiais.

Software de gerenciamento/ monitoramento de dados Indrel (opcional)

O Software Indrel é compatível com todos os equipamentos de fábrica. Sistema completo para leitura de temperaturas e eventos do equipamento, armazenamento permanente em banco de dados, gerenciamento dos históricos através de relatórios e gráficos, possibilidade de acesso remoto por dispositivo móvel, alertas por e-mail entre outras.
Outras funcionalidades:
>Emissão de relatórios de temperaturas em PDF e gráficos, por período selecionado;
>Emissão de relatórios de eventos como alarmes, aberturas de portas, falta de energia elétrica, etc;
>Possibilidade de acesso remoto, para visualização do sistema em qualquer computador, tablet ou smartphone, sem necessidade de instalação de nenhum aplicativo adicional;
>Envio de alertas por e-mail, com possibilidade de seleção de quais eventos serão enviados;
>Proteção do sistema contra alterações, em 2 níveis: administrador e operador;
>Sistema de programação de envio de relatórios (opcional).

Saída serial RS485/ RS232 (opcional)

Conector externo para monitoramento do equipamento e gerenciamento de produtos para emissão de relatórios e gráficos através de software instalado em computador pela porta serial RS 232/485. Interface/conversor serial - USB.

Saída serial com porta de comando 4/20 mA (opcional sai somente incluso de fabrica)

Controlador com comunicação serial em protocolo Modbus (opcional)

TAGS de monitoramento remoto (opcional)

Data logger INDREL para monitoramento de produtos em transporte ou por gavetas / prateleiras.

Sistema de armazenamento de dados através de pendrive ou memória interna/data logger (item opcional para LCD, Touch Screen)

Conexão para alarme remoto externo (12V ou contato seco) para acionamento de sirene ou dispositivo compatível (opcional)

Sistema de monitoramento/ transmissor sem fio - (WI-FI) - Nuvem Indrel (opcional)

Sistema que permite monitorar a temperatura do equipamento através de servidor WEB (nuvem).
Os dados podem ser acessados remotamente a qualquer momento a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet (computadores, smartphones, tablets).
Possibilita gerenciar o histórico do equipamento através de gráficos, relatórios e emissão de alertas em caso de desvios no controle de temperatura.

Sistema de Teste de Alarme (opcional)

Sistema embarcado que executa um procedimento de verificação do funcionamento dos alarmes do sistema, simulando temperaturas fora de faixa através de componentes que aquecem ou resfriam o sensor sem oscilar a temperatura interna do gabinete garantindo segurança do produto armazenado.
O acesso pode ser feito através de teclas dedicadas localizadas no painel lateral, frontal ou internamente via display.
Os testes ficam registrados em pendrive, memória interna.
*Opcional dispositivo Peltier para teste de alarme que eleva e abaixa a temperatura do sensor sem afetar a temperatura interna do equipamento.





Tem como objetivo executar um procedimento de verificação do funcionamento dos alarmes do sistema, simulando no painel situações de alta e baixa temperatura por sistema embutido que aquece ou resfria o sensor sem efetivamente oscilar a temperatura interna da câmara, garantindo segurança do produto armazenado (processo de teste que dura até 5 minutos). O sistema pode ser acionado através de teclas lateral ou frontal (no sistema de Touch Screen ou LED pode ser feito diretamente no painel), sendo possível assim, verificar o funcionamento completo dos dispositivos de alarme (Sinais sonoros, visuais, mensagens e etc). As mudanças de temperatura são exibidas no display frontal, quando estiver concluido o testa a mensagem será exibida no painel (Touch Screen e LED).
Os testes ficam registrados em pen drive, cartão de memória ou memória integrada ou gráfico de tela.

Leitor de código de barras para controle de estoque de produtos armazenados diretamente no painel / RFID (opcional)

Chave geral e supressor de surtos/ filtro contra ruídos

Possui chave geral liga/desliga e filtro supressor de surtos /ruídos.

Discadora telefônica com no mínimo 09 memórias para fixo / celular (opcional)

Sistema é programável para mínimo 09 (nove) memórias de telefones (fixos, móvel, PABX, intermunicipais) para envio de alertas sonoros por meio de central telefônica ou linha direta, sem necessidade de chip de

operadora móvel. Em caso de pane, desvio de temperatura ou falta de energia elétrica, a discadora enviará uma mensagem pré-gravada para os números programados em memória.
Discadora programável com sistema de seleção de eventos como falta de energia, porta aberta, temperatura fora de faixa configurável pelo cliente.

Instruções de uso do Sistema de Discadora Indrel.

Passo a passo para programação de seu sistema de discadora Indrel.

1° passo
Desligar a chave lateral da discadora (colocar em posição "desligar") após isto, segurar pressionado a tecla FIM até que a mesma emita um bip.
2° passo
Pressione a tecla INICIO em seguida a tecla de n° 1 e programar o telefone que será memorizado, para finalizar aperte a tecla FIM e assim o número será memorizado. Ex: tecla INICIO / tecla n°1 / fone: 33785500 / tecla FIM.
Para memorizar os outros 02 números de telefone restantes, seguir o mesmo passo acima trocando a tecla 1 pelas teclas 2 e 3.
Ex: tecla INICIO / tecla n° 2 / fone: 33785500 / tecla FIM.
Ex: tecla INICIO / tecla n° 3 / fone: 33785500 / tecla FIM.
3° passo
Pressione a tecla INICIO em seguida a tecla n° 5 e em seguida a tecla n° 2 (significando 2 segundos)
Assim será selecionado o tempo de discagem.
4° passo
Pressione a tecla INICIO em seguida a tecla n° 6 e em seguida a tecla n° 2 (escolha de sistema)
Assim será definido sistema TOM.
5° passo
Pressione a tecla INICIO em seguida a tecla n° 7 e em seguida a tecla n° 1
(escolha de sistema digital ou analógico)
Assim está definido sistema digital.
6° passo
Pressione a tecla INICIO em seguida a tecla n° 8 e em seguida a tecla n° 2
(escolha da velocidade de discagem)
7° passo
Pressione a tecla INICIO em seguida a tecla n° 9 e em seguida a tecla n° 1
(escolha de sistema em modo automático)
8° passo
Pressione a tecla INICIO em seguida a tecla n° 0 e em seguida a tecla n° 8
(escolha de sistema de chamada)
9° passo
Teste final de programação.
Pressione a tecla INICIO em seguida a tecla n° 4 e em seguida a memória programada. (Memória 1 / Memória 2 / Memória 3).
Assim irá chamar os números das memórias programadas no passo 2.

Obs: Para fazer todos os procedimentos acima de configuração dos números em memória, a chave lateral da discadora deve estar na posição "desligar". Para fazermos os testes de discagem (verificar se estão ligando para os números programados), após os procedimentos acima, a chave deve estar na posição "ligar".

Sistema de envio de mensagem SMS (opcional)

Sistema de envio de mensagens de alertas por SMS para no mínimo 09 números de celulares, através do software de monitoramento INDREL/INDREL CLOUD/ dispositivos coletor wi-fi (opcionais), sem necessidade de CHIP de operadora de telefone móvel. O sistema identifica equipamento e informa o evento que causou o alerta.
*Opcional módulo GPRS/GSM independentes

Relógio/ calendário com bateria interna

Sistema de emergência para falta de energia de até 96 horas - baterias (opcional)

Safety System: sistema de segurança que garante o funcionamento total do equipamento em caso de falta ou instabilidade de energia elétrica. Os componentes são montados internamente no próprio gabinete do equipamento e funcionam através de baterias estacionárias com autonomia para períodos de até 96 horas (dependendo do modelo de equipamentos e número de baterias).
Possui supressor de surtos para evitar problemas mecânicos.
O sistema de recarga das baterias é acionado automaticamente na presença da energia elétrica.
No break: sistema de segurança para falta ou instabilidade de energia elétrica garantindo o funcionamento do equipamento. Os componentes são montados externamente ao equipamento através de módulo de comando digital e microprocessado, com estabilizador automático de voltagem e banco de baterias com autonomia para períodos de até 96 horas (dependendo do número de bancos de baterias e modelo de equipamento).

Estabilizador de voltagem (opcional)

Dispositivo que regula a tensão de alimentação do equipamento garantindo o funcionamento dentro das faixas estabelecidas (127V e 220V). Protege o equipamento contra surtos elétricos e pico de tensão. Recomendado para locais onde há instabilidade de energia e tensões elétricas fora da faixa padrão.

Controlador de tensão / Phaselog (opcional)

Dispositivo instalado nos equipamentos com a função de proteger, monitorar, registrar a tensão elétrica da rede local. Aciona o sistema de emergência quando houver instabilidade ou falta de energia elétrica. Emite relatórios e gráficos de desempenho imediato ou retroativo via data logger e software.

Impressora térmica com bobina de papel (opcional)

Sistema de impressão em papel térmico INDREL de parâmetros de temperatura, data, hora e eventos.

Qualificação térmica QO, QP, QI (opcional)

>Validação – QO/QP/QI, por equipe profissional e qualificada.

Certificado de calibração padrão RBC para controladores, por laboratório acreditado (opcional)

Certificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO/RBC com rastreabilidade em três pontos de referência de temperatura.

6 – DADOS TÉCNICOS

6.1 – TABELA GERAL DE PRODUTOS

001238

REFRIGERADORES 2° C a 8°C					
MODELO	**Capacidade (LITROS – L)**	**Capacidade Doses/ bolsas**	**Dimensões externas (mm)**	**Gavetas / Prateleiras / Racks**	**Disposição**
CI3D	30 L	3.200 doses 10 bolsas	800 x 600 x 480	02 RACKS	Horizontal
RVH137D RVH137D SOLAR	140 L	13.700 doses	1150 x 1100 x 600	04 RACKS	Horizontal
RVH137D/2 RVH137D/2 SOLAR	325 L	27.000 doses	1150 x 1630 x 890	06 RACKS	Horizontal
BSG02D RC02D RVV11D	120 L	8.100 doses 72 bolsas	1350 x 650 x 720	02 A 03	Vertical
BSG04D RC220D RVV22D	280 L	12.500 doses 220 bolsas	1750 x 650 x 800	04 A 06	Vertical
BSG05D RVV440D RC330D	342 L	22.000 doses 260 bolsas	1950 x 750 x 850	05 A 07	Vertical
BSG05D RVV440D RVV430D RC430D	430 L	27.000 doses 300 bolsas	1950 x 750 x 850	05 A 07	Vertical
RVV504D RC504D	504 L	32.000 doses 360 bolsas	2050 x 750 x 830	05 A 07	Vertical
RVV880D	684 L	45.000 doses 595 bolsas	2000 x 900 x 940	06 A 08	Vertical
RVV1500D RC1500D	972 L	98.000 doses 672 bolsas	2050 x 1400 x 790	08 A 12	Vertical
RVV1500D/2 RC1500D/2	1200 L	120.000 doses 720 bolsas	2050 x 1400 x 890	08 A 14	Vertical
RVV2000D RC2000D	1560 L	148.000 doses 1008 bolsas	2050 x 2050 x 790	12 A 16	Vertical

6.2 – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

001239

MODELO	Voltagem [V~]	Corrente [A]	Potência [W]
CI3D	127	1.4	178
	220	0.65	143
RVH137D RVH137D SOLAR	127	2.9	368
	220	1.4	308
RVH137D/2 RVH137D/2 SOLAR	127	3.7	470
	220	1.6	352
BSG02D RC02D RVV11D	127	2.2	279
	220	1.3	286
BSG04D RC220D RVV22D	127	3.7	470
	220	2.1	462
BSG05D RVV440D RC330D	127	4.9	622
	220	3.5	770
BSG05D RVV440D RVV430D RC430D	127	4.8	610
	220	3.5	770
RVV504D RC504D	127	5.1	648
	220	2.9	638
RVV880D	127	5.9	750
	220	3.1	682
RVV1500D RC1500D	127	6.0	762
	220	3.2	704
RVV1500D/2 RC1500D/2	127	5.5	698
	220	3.2	704
RVV2000D RC2000D	127	6.7	851
	220	2.8	616

7 – PAINEL DE CONTROLE

7.1 - LIMITES DE TEMPERATURA DE TRABALHO

001240

Características de Controle – LED e LCD	
Temperaturas	
Resolução do Display de Temperaturas	0,1ºC
Faixa de Controle	-2,5°C a +8°C pré set
Pré-set - produtos	4,0°C
Precisão do Controle – Ajustáveis de:	± 0,7ºC a 4,0ºC
Faixa de Atuação do Display de Temperatura	- 40,0ºC a 60,0ºC

Faixa de trabalho dos equipamentos para imunobiológicos, hemoderivados, medicamentos, termolábeis e assemelhados. Entre 2°C a 8°C com set point pré-ajustado em fábrica em 4,0°C.

7.2 – CONTROLADORES IRL 234



DESCRIÇÃO GERAL	
Os controladores IRL234 são utilizados em vários modelos de equipamentos INDREL, com a finalidade de executar o controle de refrigeração, alarmes e acionamentos.	
Display	Display em LED 7 segmentos, com 3 dígitos.
Faixa de Leitura	Linha geral: -50 a 105°C
Resolução	Linha geral: 0,1°C
Alarmes	Temperatura Alta Temperatura Baixa Sensor Desconectado (Err)
Quant. Sensores	01 (câmara interna) á 03 sensores
Controle de Ventilação	Não
Controle de Degelo	Não
Quant. Parâmetros	35
Protegido por senha	Sim
Teclas para controle e ajustes	3
Registro de mínima e máxima	Sim

INDICADORES DO PAINEL		
LED	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO**

ENERGIA	Sinaliza a situação da alimentação elétrica do equipamento.	VERDE: energia elétrica presente. VERMELHO: falta de energia. APAGADO: equipamento desligado (chave geral.)
REFRIGERAÇÃO	Sinaliza funcionamento da refrigeração do equipamento.	AZUL: equipamento está refrigerando APAGADO: refrigeração desligada
FALTA DE ENERGIA	Sinaliza alarme de FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	APAGADO: Funcionamento OK. Nenhum alarme ativo. VERMELHO: Sinaliza alarme de falta de energia.

INDICADORES DO CONTROLADOR



LED	IRL 234
1	Indica que o controlador enviou sinal para ligar o COMPRESSOR do equipamento.
2	Indica que o controlador enviou o sinal para acionamento de discadora ou alarme remoto (opcionais), em caso de ALARME.
3	Indica que a saída AUX está ativada.
4	Sinaliza "Saída Sonora" (BUZZER)
5	Não utilizado

TECLAS DE USO GERAL

TECLA	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
LUZ INTERNA	Acende a iluminação interna do equipamento (somente em equipamentos com porta de vidro)	- Pressione esta tecla uma vez para acender a iluminação interna. - A iluminação desligará automaticamente depois de 60 segundos.
SILENCIAR ALARME	Silenciador do alarme sonoro.	- Pressione esta tecla para silenciar o alarme sonoro de falta de energia elétrica.

▲ MENU ▼	IRL 234 - TECLAS DE CONTROLE E AJUSTES

Ajuste de Set Point (Temperatura de Operação)

- Pressione **MENU** por 2 segundos até aparecer **Set**, soltando em seguida. Aparecerá a temperatura de trabalho ajustada.
- Utilize as teclas ▲ e ▼ para modificar o valor e, quando pronto, pressione **MENU** para gravar.
- Aguarde o retorno automático para o visor de temperaturas, ou mantenha **MENU** pressionado para retorno imediato.

Alteração de Parâmetros (*)

- Pressione simultaneamente as teclas ▲ e ▼ por 2 segundos até aparecer Fun, soltando em seguida. Logo aparecerá F01.
- Pressione **MENU** (toque curto).
- Utilize as teclas ▲ e ▼ para entrar com o código de acesso (123) e, quando pronto, pressione **MENU** para entrar;
- Utilize as teclas ▲ e ▼ para acessar a função desejada.
- Após selecionar a função, pressione **MENU** (toque curto) para visualizar o valor configurado para aquela função.
- Utilize as teclas ▲ e ▼ para alterar o valor e, quando pronto, pressione **MENU** para memorizar o valor configurado e retornar ao menu de funções.
- Para sair do menu e retornar à operação normal (indicação da temperatura) pressione **MENU** (toque longo) até aparecer "---".

Registros das temperaturas máxima e mínima

- Pressione ▲: aparecerá a temperatura mínima registrada. Logo após aparecerá a temperatura máxima registrada.
- Para reinicializar os registros, mantenha pressionada a tecla ▲ durante a visualização das temperaturas mínima e máxima até aparecer RST.

Silenciar alarme

- Para inibir temporariamente o alarme sonoro pressione simultaneamente as teclas **MENU** e ▼.

(*) Os equipamentos INDREL são desenvolvidos e ajustados pela fábrica para obterem o melhor desempenho de qualidade, confiabilidade e segurança. A alteração indevida dos parâmetros pode causar problemas na performance do equipamento e eventualmente ocasionar a obtenção de resultados indesejados.

7.3 CONTROLADOR LCD



INDICADORES		
LED	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO**
ENERGIA	Sinaliza a situação da alimentação elétrica do equipamento.	VERDE: energia elétrica presente. VERMELHO: falta de energia. APAGADO: equipamento desligado (chave geral.)
REFRIGERAÇÃO	Sinaliza funcionamento da refrigeração do equipamento.	AZUL: equipamento está refrigerando APAGADO: refrigeração desligada
ALARME	Sinaliza alertas, alarmes e outras situações que requerem atenção do usuário. O evento que gerou o alarme será exibido no visor. Ex: temperatura alta, porta aberta, falta de energia, etc.	APAGADO: Funcionamento OK. Nenhum alarme ativo. VERMELHO: Sinaliza alarme (requer ação do usuário) AMARELO: Sinaliza alerta (apenas informa usuário)

TECLAS DE USO GERAL		
TECLA	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO**
LUZ INTERNA	Acende ou apaga a iluminação interna do equipamento.	- Pressione esta tecla uma vez para acender a iluminação interna. - Pressione novamente para apagar. - OBS: Se nenhuma tecla for pressionada, a iluminação desligará automaticamente depois de um tempo pré-programado.
MIN/MAX	Permite visualizar ou apagar os registros de temperaturas máxima e mínima.	- Mantenha a tecla pressionada por 2 segundos para apagar os registros de MIN/MAX. - Se o visor estiver exibindo DATA/HORA, pressione e solte esta tecla para visualizar MIN/MAX. - **Modo Multi-sensor (OPCIONAL):** Pressione a tecla **MIN/MAX** para alternar entre a tela com leitura de 3 sensores e a tela com temperaturas mínima e máxima.
SILENCIAR ALARME	Silenciador do alarme sonoro.	- Pressione esta tecla para silenciar temporariamente o alarme sonoro. OBS: - Esta ação apenas silencia o alarme, mantendo ativas as mensagens na tela. - Se a condição que gerou o alarme não for eliminada, este será novamente ativado dentro de um tempo pré-programado.

TECLAS DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA		
TECLA	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO**
▲ MENU ▼	Visualização e programação de parâmetros.	**Acesso ao Menu de Opções** - Pressione a tecla **MENU** para acessar configurações do sistema. - Uma senha será solicitada. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para digitar a senha de até 3 dígitos (padrão de fábrica: 11). - Para confirmar senha, pressione novamente a tecla **MENU**. - Aguarde confirmação de acesso liberado. **Visualização / Alteração de Parâmetros (*)** (somente após a confirmação da senha)

		- Pressione as teclas ▲ ou ▼ para escolher e visualizar o parâmetro desejado. - Para alterar um valor pressione a tecla **MENU.** - O sinal " > " aparecerá no canto da tela, indicando que o valor está liberado para alteração. - Pressione as teclas ▲ ou ▼ para digitar os valores desejados. - Pressione novamente a tecla **MENU** para confirmar e salvar alterações. OBS: - Se nenhuma tecla for pressionada dentro de um tempo pré-programado, o sistema cancelará a operação. - Mantenha a tecla **MENU** pressionada para voltar à tela principal.

(*) Os equipamentos INDREL são desenvolvidos e ajustados pela fábrica para obterem o melhor desempenho de qualidade, confiabilidade e segurança. A alteração indevida dos parâmetros pode causar problemas na performance do equipamento e eventualmente ocasionar a obtenção de resultados indesejados.

TELAS DE USO GERAL		
FUNÇÃO	**VISOR**	**DESCRIÇÃO**
Tela de abertura	*** INDREL *** REFRIG. v1.65	Informa a linha de trabalho do equipamento (refrigeração, congelamento, etc) e versão do sistema.
Tela principal. (Temperaturas MIN/MAX)	Temp: 4.0°C Mi: 3.8 Ma: 5.2	Linha 1: exibe temp. interna / nível de bateria Linha 2: exibe temperaturas mín. e máx.
Tela principal. (DATA / HORA)	Temp: 4.0°C 19/06/14 18:00	Linha 1: exibe temp. interna / nível de bateria Linha 2: exibe DATA e HORA.
Tela Multisensor (OPCIONAL) (Modelo com 3 sensores)	T1: 4.0 T2: 5.0 T3: 6.0	Linha 1: exibe temp. T1 / nível de bateria Linha 2: exibe temperaturas T2, T3

TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO		
FUNÇÃO	**VISOR**	**DESCRIÇÃO**
		MIN | PADRÃO | MAX
Tela de entrada de menu do usuário.	> ACESSAR MENU Digite senha:11	Permite acesso à configuração de parâmetros pelo usuário. É necessário digitar senha de 3 dígitos através das teclas ▲▼ 000 | 11 | 999
Mensagem de senha inválida	> ACESSAR MENU Senha invalida!	Informa que a senha digitada está incorreta. Acesso aos parâmetros continua protegido.
Mensagem de senha correta.	> ACESSAR MENU Acesso liberado!	Informa que a senha digitada está correta. Acesso aos parâmetros está liberado.
Programar temperatura	Temp. Operação 4.0°C	Temperatura desejada para controle (set point).

		2.0 °C	**4.0 °C**	35.0 °C

Programar alarme de temperatura alta	Alarme Temp.Alta 7.0°C	Temperatura para acionamento de alarme de "alta temperatura"		
		SP+2.0°C	**7.0 °C**	35.0 °C
Programar alarme de temperatura baixa	Alarm.Temp.Baixa 2.0°C	Temperatura para acionamento de alarme de "baixa temperatura"		
		0.0 °C	**2.0 °C**	SP-2.0°C
Programar tempo de iluminação interna	Tempo da Lampada 60 seg.	Tempo para desligamento automático da iluminação interna após acionamento da tecla.		
		0 (não liga)	**60 seg.**	300 seg.
Programar tempo para alarme de porta aberta.	Alarme Porta Ab. 60 seg.	Tempo para alarme indicando que a porta do equipamento está aberta.		
		2 seg.	**60 seg.**	300 seg.
Seleção de idioma	Escolher Idioma: Portugues Español English	Permite selecionar o idioma do texto exibido no visor: português, espanhol ou inglês.		
		Espanhol	**Português**	Inglês
Configurar intervalo para envio de dados pela porta serial	Intervalo Reais. 5 min	Periodo de amostragem para monitoramento por software ou gravação na pendrive.		
		1	**5 min**	60 min
Ativar alerta de "pendrive ausente"	Alerta Pendrive? NÃO SIM	Quando habilitado, gera alertas a cada 1 minuto, em caso de pendrive ausente. OBS: Disponível apenas em equipamentos com este opcional.		
		NÃO	**NÃO**	SIM
Ajuste de relógio. Acertar "dia".	Ajuste Relogio Dia: 31	Permite ajustar data do sistema. Programar "dia".		
		1	**dia**	31
Ajuste de relógio. Acertar "mês".	Ajuste Relogio Mes: 12	Permite ajustar data do sistema. Programar "mês".		
		1	**mês**	12
Ajuste de relógio. Acertar "ano".	Ajuste Relogio Ano: 2014	Permite ajustar data do sistema. Programar "ano".		

2012	ano	2099

Ajuste de relógio. Acertar "hora".	Ajuste Relogio Hora: 23	Permite ajustar relógio do sistema. Programar "hora".

0	hora	23

Ajuste de relógio. Acertar "minuto".	Ajuste Relogio Minuto: 59	Permite ajustar relógio do sistema. Programar "minuto".

0	minuto	59

Exibição da data.	Ajuste Relogio Data: 31/12/14	Tela para exibição da data, após ajustes.
Exibição de horas.	Ajuste Relogio Hora: 23:59:59	Tela para exibição da hora, após ajustes.
Endereço do equipamento na rede.	Endereco de Rede 1	Identifica o equipamento para comunicação na rede RS485 e registro na pendrive.

1	1	64


Restauração das configurações originais de fábrica (parâmetros do usuario)	Restaura Confies [NÃO] [SIM]	Permite reiniciar o sistema com as configurações padrão recomendadas pelo fabricante. (apenas parâmetros do usuário)

ALARMES E ALERTAS

FUNÇÃO	VISOR	DESCRIÇÃO
Alarme de temperatura alta	Temp: 8.0°C * TEMP. ALTA! *	Temperatura interna está acima da configurada.
Alarme de temperatura baixa.	Temp: 1.9°C * TEMP. BAIXA! *	Temperatura interna está abaixo da configurada.
Alarme de porta aberta.	Temp: 4.0°C * PORTA ABERTA!*	A porta do equipamento ficou aberta por um tempo maior do que o configurado.
Alarme de "FALTA DE REDE"	Temp: 4.0°C *FALTA ENERGIA!*	O equipamento está trabalhando sem energia elétrica.
Alarme de "SENSOR DESCONECTADO"	Temp: *FALHA DE SENSOR	O sensor de temperatura está desconectado ou com erro de leitura. Entrar em contato com a rede de assistência técnica.

Alerta de bateria fraca.	Temp: 4.0°C * BAT. FRACA! *	A bateria interna do equipamento está descarregada ou desconectada.
Alerta de "Pendrivre ausente"	Temp: 4.0°C PENDRIVE AUSENTE	Quando habilitado, avisa que a pendrive não está inserida no equipamento.
Reset/Falha de EEPROM	Confis. de Fabr. Restaurando ...	Esta mensagem aparece quando houver perda da memória interna do sistema ou restauração dos valores padrão de fábrica.
Alerta de manutenção preventiva.	Temp: 4.0°C MAN ...manutenção...	O equipamento atingiu o tempo programado para manutenção preventiva. Entrar em contato com a rede de assistência técnica.

7.4 CONTROLADOR LCD2

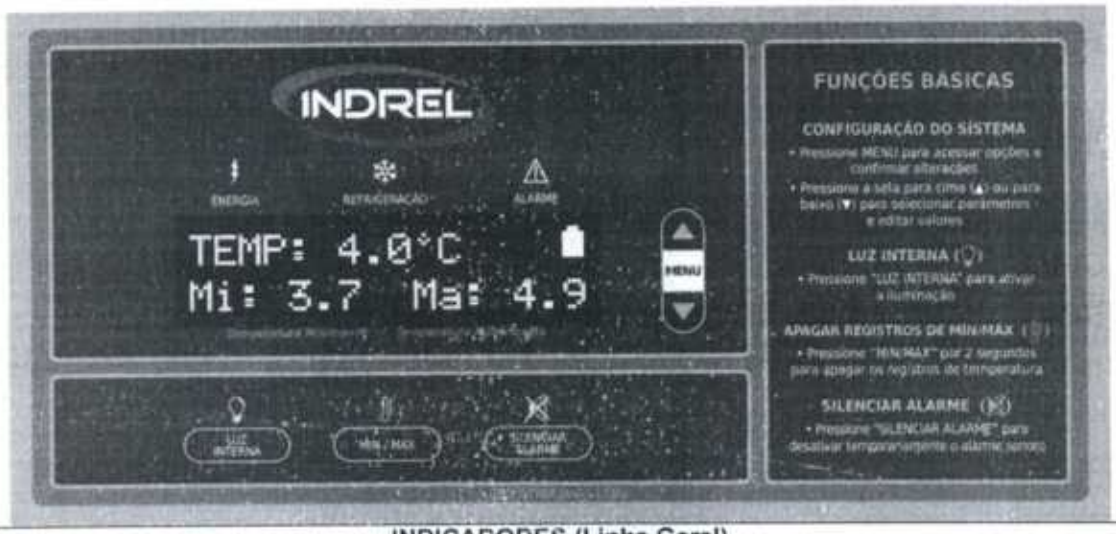

INDICADORES (Linha Geral)		
LED	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO**
ENERGIA	Sinaliza a situação da alimentação elétrica do equipamento.	VERDE: energia elétrica presente. VERMELHO: falta de energia. APAGADO: equipamento desligado (chave geral.)
REFRIGERAÇÃO	Sinaliza funcionamento da refrigeração do equipamento.	AZUL: equipamento está refrigerando APAGADO: refrigeração desligada
ALARME	Sinaliza alertas, alarmes e outras situações que requerem atenção do usuário. O evento que gerou o alarme será exibido no visor. Ex: temperatura alta, porta aberta, falta de energia, etc.	APAGADO: Funcionamento OK. Nenhum alarme ativo. VERMELHO: Sinaliza alarme (requer ação do usuário) AMARELO: Sinaliza alerta (apenas informa usuário)

TECLAS DE USO GERAL		
TECLA	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO**
LUZ INTERNA	Acende ou apaga a iluminação interna do equipamento.	- Pressione esta tecla uma vez para acender a iluminação interna. - Pressione novamente para apagar. - OBS: Se nenhuma tecla for pressionada, a iluminação desligará automaticamente depois de um tempo pré-programado.

 **MIN/MAX**	Permite visualizar ou apagar os registros de temperaturas máxima e mínima.	- Se o visor estiver exibindo DATA/HORA, pressione e solte esta tecla para visualizar MIN/MAX. - Se o visor estiver exibindo MIN/MAX, pressione e solte esta tecla para visualizar a data e hora do último reset dos registros. - Mantenha a tecla pressionada por 2 segundos para apagar os registros de MIN/MAX.
 **SILENCIAR ALARME**	Silenciador do alarme sonoro.	- Pressione esta tecla para silenciar temporariamente o alarme sonoro. - Esta ação apenas silencia o alarme, mantendo ativas as mensagens na tela. - Se a condição que gerou o alarme não for eliminada, este será novamente ativado dentro de um tempo pré-programado. - Pressione a tecla novamente para restaurar o alarme.

TECLAS DE CONTROLE DO SISTEMA		
TECLA	**FUNÇÃO**	**DESCRIÇÃO**
▲ MENU ▼	Visualização e programação de parâmetros.	**Modo Multi-sensor (OPCIONAL)** - Pressione as teclas ▲ ou ▼ para visualizar as temperaturas dos demais sensores. Pressione **MIN/MAX** para retornar. **Acesso ao Menu de Opções** - Pressione a tecla **MENU** para acessar configurações do sistema. - Uma senha será solicitada. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para digitar a senha de até 3 dígitos (padrão de fábrica: 11). - Para confirmar senha, pressione novamente a tecla **MENU**. - Aguarde confirmação de acesso liberado. **Visualização / Alteração de Parâmetros (*)** (somente após a confirmação da senha) - Pressione as teclas ▲ ou ▼ para escolher e visualizar o parâmetro desejado. - Para alterar um valor pressione a tecla **MENU.** - O sinal " > " aparecerá no canto da tela, indicando que o valor está liberado para alteração. - Pressione as teclas ▲ ou ▼ para digitar os valores desejados. - Pressione novamente a tecla **MENU** para confirmar e salvar alterações. OBS: - Se nenhuma tecla for pressionada dentro de um tempo pré-programado, o sistema cancelará a operação. - Mantenha a tecla **MENU** pressionada para voltar à tela principal.
(*) Os equipamentos INDREL são desenvolvidos e ajustados pela fábrica para obterem o melhor desempenho de qualidade, confiabilidade e segurança. A alteração indevida dos parâmetros pode causar problemas na performance do equipamento e eventualmente ocasionar a obtenção de resultados indesejados.		

EXPORTAÇÃO DE DADOS

Este controlador possui sistema de registro permanente em memória interna do histórico de temperaturas e eventos. Para acessar estes dados, proceder da seguinte maneira:

1. Inserir uma pendrive no conector USB
2. Aguardar a abertura da TELA DE EXPORTAÇÃO DE DADOS (Ver telas adiante).
3. Irá abrir uma tela perguntando se deseja exportar dados.
4. Pressionar a tecla **MENU**, depois pressione ▲ para selecionar "SIM". Confirmar com a tecla **MENU**.
5. Em seguida aparecerá uma tela para selecionar a data de início. O sistema irá sugerir ao usuário a última data em que houve uma exportação bem sucedida. Se a data sugerida estiver OK, basta avançar, teclando **MENU**

por 3 vezes. Caso queira escolher outra data, use as teclas ▲ ▼ para alterar valores. Pressione **MENU** para avançar e confirmar exportação.

6. Aguarde o término da exportação e retire a pendrive do conector. Pressione **MENU** para finalizar.

OBS: Com a intenção de tornar esse sistema inviolável, os dados exportados são criptografados. Para fazer a leitura dos mesmos, será necessário utilizar o SOFTWARE "INDREL DATA READER LCD2".
ATENÇÃO: Este equipamento foi desenvolvido para operar sem a necessidade de manter a pendrive inserida no conector USB em tempo integral. Se a pendrive não for retirada do conector USB, o sistema emitirá alertas, informando a necessidade de retirar a pendrive.

TELA DO SISTEMA

TELAS DE USO GERAL		
FUNÇÃO	**VISOR**	**DESCRIÇÃO**
Tela de abertura	* INDREL REFR. * * INDREL REF.SS* * INDREL IULT * * INDREL CPS * * INDREL CLC * IM 2.00 CM 2.00	Linha 1: Informa a linha de trabalho do equipamento. Linha 2: Informa as versões dos softwares de controle das placas eletrônicas.
Tela sensor principal. (DATA / HORA)	TEMP: 4.0°C 19/06/17 18:00	Linha 1: exibe temp. sensor principal e nível de bateria. Linha 2: exibe DATA e HORA.
Tela sensor principal. (Temperaturas MIN/MAX)	TEMP: 4.0°C Mi: 3.8 Ma: 5.2	Linha 1: exibe temp. sensor principal e nível de bateria. Linha 2: exibe temperaturas mín. e máx. do sensor selecionado.
Tela sensor principal. (Último reset de MIN/MAX)	TEMP: 4.0°C Rst: 19/07 18:00	Linha 1: exibe temp. sensor principal e nível de bateria. Linha 2: exibe data e hora do último reset de MIN/MAX.
Tela Multisensores (OPCIONAL)	T02: 4.2°C Mi: 3.8 Ma: 5.2 T03: 4.3°C Mi: 3.8 Ma: 5.2 T04: 4.4°C Mi: 3.8 Ma: 5.2 T05: 4.5°C Mi: 3.8 Ma: 5.2 T06: 4.6°C Mi: 3.8 Ma: 5.2	Linha 1: exibe temp. T(1-6) / nível de bateria Linha 2: exibe temperaturas mín. e máx. do sensor selecionado. Neste exemplo, estamos exibindo as temperaturas T02 a T06.

TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO				
FUNÇÃO	**VISOR**	**DESCRIÇÃO**		
		MIN	PADRÃO	MAX
Tela de entrada de menu do usuário.	> ACESSAR MENU Digite senha:11	Permite acesso à configuração de parâmetros pelo usuário. É necessário digitar senha de 3 dígitos através das teclas ▲ ▼		
		000	11	999

Mensagem de senha inválida	> ACESSAR MENU Senha invalida!	Informa que a senha digitada está incorreta. Acesso aos parâmetros continua protegido.
Mensagem de senha correta.	> ACESSAR MENU Acesso liberado!	Informa que a senha digitada está correta. Acesso aos parâmetros está liberado.
Programar temperatura	Temp. Operação 4.0°C	Temperatura desejada para controle (set point). 2.0 °C | **4.0 °C** | 35.0 °C
Programar alarme de temperatura alta	Alarme Temp.Alta 7.0°C	Temperatura para acionamento de alarme de "alta temperatura" SP+2.0°C | **7.0 °C** | 35.0 °C
Programar alarme de temperatura baixa	Alarm.Temp.Baixa 2.0°C	Temperatura para acionamento de alarme de "baixa temperatura" 0.0 °C | **2.0 °C** | SP-2.0°C
Função para teste do alarme sonoro (buzzer)	Teste Al.Sonoro? [NÃO] [SIM]	Solicita execução de rotina do teste de alarme sonoro do sistema. Este será executado 10 segundos após saída do Menu.
Programar tempo de iluminação interna	Tempo da Lampada 60 seg.	Tempo para desligamento automático da iluminação interna após acionamento da tecla. 0 (não liga) | **60 seg.** | 300 seg.
Programar tempo para alarme de porta aberta.	Alarme Porta Ab. 60 seg.	Tempo para alarme indicando que a porta do equipamento está aberta. 0 (imediato) | **60 seg.** | 300 seg.
Tempo de inibição do alarme após acionamento da tecla "SILENCIAR"	T.Inibir Alarme Silenc.: 10 min	Após decorrido este tempo, o alarme sonoro será novamente habilitado. 0 (ñ silencia) | **10 min** | 60 min
Função da Discadora	Func. Discadora Alta/Baixa Discar Tudo	Seleciona modo de atuação do relê de alarme (discadora). 0: atua somente nos alarmes de alta/baixa. 1: atua para todos os alarmes. 0 | 1 | 1
Seleção de idioma	Escolher Idioma: Portugues Español English	Permite selecionar o idioma do texto exibido no visor: português, espanhol ou inglês. Espanhol | **Português** | Inglês
Ajuste DATA/HORA	Ajuste Relogio 31/12/17 23:59	Permite ajustar DATA/HORA do sistema. Pressione MENU para avançar e ▲ ▼ para alterar valores.

Exibição de DATA.	Ajuste Relogio Data: 31/12/17	Tela para exibição de DATA, após ajustes.
Exibição de HORA.	Ajuste Relogio Hora: 23:59:59	Tela para exibição de HORA, após ajustes.
Endereço do equipamento na rede.	Endereco de Rede 1	Identifica o equipamento para comunicação na rede RS485 e registro na pendrive. 1 | 1 | 64
Restauração das configurações originais de fábrica (parâmetros do usuário)	Restaura Confiss [NÃO] [SIM]	Permite reiniciar o sistema com as configurações padrão recomendadas pelo fabricante. (Apenas parâmetros do usuário)


EXPORTAÇÃO DE DADOS		
FUNÇÃO	**VISOR**	**DESCRIÇÃO**
Iniciar exportação dos dados para pendrive	Exportar Dados? [SIM] [NÃO]	Tela que aparece ao inserir a pendrive na porta USB.
Tela para seleção de data de início de exportação	Data de Início: > 01/08/2016	Permite ao usuário selecionar dia/mês/ano a partir do qual os dados do histórico serão exportados.
Mensagem "exportando dados para pendrive"	Exportando Dados Aguarde...	Os dados estão sendo copiados da memória do controlador para a pendrive.
Mensagem "exportação concluída".	OK! Remova pen e pressione [MENU]	Sinaliza que a exportação dos dados foi bem sucedida. Após esse procedimento, remover a pendrive e pressionar a tecla **MENU**.
Falha na exportação dos dados.	ERRO! Remova pen pressione [MENU]	Indica que houve erro durante o processo de exportação dos dados. Remover a pendrive e pressionar a tecla **MENU**.
Tempo esgotado para a exportação dos dados.	FIM TEMPO!Remova pen, press[MENU]	Indica que a pendrive foi inserida no conector USB, mas o comando para exportar não foi acionado. O procedimento foi cancelado.

ALARMES E ALERTAS		
FUNÇÃO	**VISOR**	**DESCRIÇÃO**
Alarme de temperatura alta	TEMP: 8.0°C * TEMP. ALTA! *	Temperatura interna está acima da configurada.

Alarme de temperatura baixa.	TEMP: 2.0°C * TEMP. BAIXA! *	Temperatura interna está abaixo da configurada.
Alarme de porta aberta.	TEMP: 4.0°C * PORTA ABERTA!*	A porta do equipamento ficou aberta por um tempo maior do que o configurado.
Alarme de "FALTA DE REDE"	TEMP: 4.0°C *FALTA ENERGIA!*	O equipamento está trabalhando sem energia elétrica.
Alarme de "FALHA DE SENSOR".	TEMP: *FALHA DE SENSOR	O sensor de temperatura está desconectado, em curto ou com erro de leitura. Entrar em contato com a rede de assistência técnica.
Alarme de "FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERNA".	TEMP: 4.0°C *S/COMUM. INTERNA	As placas do sistema estão sem comunicação. Entrar em contato com a rede de assistência técnica.
Alarme de "FALHA DE MEMÓRIA INTERNA".	TEMP: 4.0°C *FALHA MEMORIA!*	O sistema encontrou falhas no armazenamento dos dados. Entrar em contato com a rede de assistência técnica.
Alerta de bateria fraca.	TEMP: 4.0°C * BAT. FRACA! *	A bateria interna do equipamento está descarregada ou desconectada.
Teste de alarme sonoro	Temp: 7.0°C Iniciando Teste.	Indica que o sistema está iniciando o teste do alarme sonoro (solicitado no menu do usuário).
Teste de alarme sonoro	Temp: 7.0°C * TESTE ALARME *	Indica que o sistema está executando o teste do alarme sonoro (solicitado no menu do usuário).
Reset/Falha de EEPROM	Restaurando ... * Rest. OK! *	Esta merisagem aparece quando houver perda da memória interna do sistema ou restauração dos valores padrão de fábrica.
Alerta de manutenção preventiva.	TEMP: 4.0°C *MANUT.PREVENT.*	O equipamento atingiu o tempo programado para manutenção preventiva. Entrar em contato com a rede de assistência técnica.

7.5 CONTROLADOR TOUCH SCREEN

Esta é a tela principal do controlador. É aqui que são exibidas as informações mais importantes para o funcionamento do equipamento. O sistema é programado para sempre retornar à essa tela.

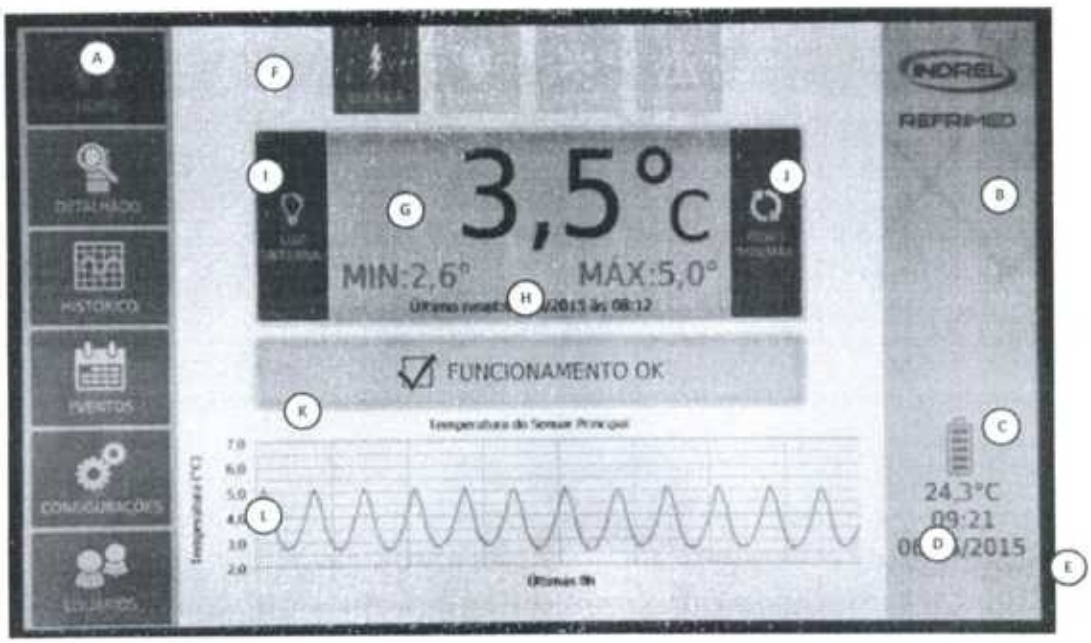

(A) MENU LATERAL

Aqui temos os botões para alternar para as demais telas do sistema:



TELA "HOME"

Acesso à tela principal, que exibe temperaturas de momento, mínima, máxima, alarmes ativos, sinalizações de acionamentos, gráfico em tempo real, etc.



TELA "DETALHADO"

Permite visualizar mais detalhes sobre o funcionamento do equipamento, tais como: todos os sensores, tempo de trabalho do compressor, abertura de portas, etc.



TELA "HISTÓRICO"

Acesso aos registros de dados do equipamento, onde é possível gerar e visualizar relatórios de vários tipos: resumido, completo e gráfico.



TELA "EVENTOS"

Acesso aos registros de eventos do equipamento, onde é possível gerar e visualizar relatórios de vários tipos: alarmes, acionamentos e alterações de parâmetros.



TELA "CONFIGURAÇÕES"

Tela onde é possível alterar parâmetros de funcionamento do equipamento e realizar outras configurações e ajustes. Tela protegida por senha.



TELA "USUÁRIOS"

Tela para gerenciamento dos usuários que terão acesso ao sistema.

(B) FAIXA LATERAL

Nessa faixa estão contidas informações que estarão disponíveis em todas as outras telas.


(C) INDICADOR DE BATERIA

Ícone que indica o nível de carga da bateria. São 5 níveis:



(D) INDICADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE

Quando habilitado, indica a temperatura ambiente (externa). É uma variável importante para se monitorar a climatização do ambiente onde o equipamento está instalado.



(E) DATA/HORA

Informa a data e hora atual, utilizada pelo sistema.

(F) ÍCONES INDICADORES DE ACIONAMENTOS

	**"ENERGIA"** Indica estado da alimentação AC do equipamento.	VERDE: Energia elétrica presente VERMELHO: Falta de energia
	**"SAFETY SYSTEM"** (OPCIONAL) Sinaliza funcionamento do SAFETY SYSTEM (Sistema que mantém o equipamento refrigerando em caso de falta de energia).	AMARELO: SAFETY SYSTEM ATIVADO. CINZA: compressor desligado.
	**"REFRIGERAÇÃO"** Sinaliza funcionamento da refrigeração do equipamento.	AZUL: compressor está refrigerando. CINZA: compressor desligado.
	**"ALARME"** Sinaliza alertas, alarmes e outras situações que requerem atenção do usuário. O evento que gerou o alarme será exibido no visor.	CINZA: Funcionamento OK. Nenhum alarme ativo. VERMELHO: Sinaliza alarme (requer ação do usuário) AMARELO: Sinaliza alerta (apenas informa usuário)


(G) DISPLAY PRINCIPAL

Exibe a temperatura de momento no interior do gabinete referente ao sensor definido como SENSOR PRINCIPAL (sensor que efetua o controle de temperatura do equipamento).



(H)DISPLAY MIN/MAX

Exibe a maior e a menor temperatura registrada desde o último reset de MIN/MAX. A data e hora do último reset também são exibidas na tela, o que permite uma interpretação rápida e eficaz da variação da temperatura do período.



No exemplo acima, podemos fazer a seguinte leitura: "Desde o último reset de MIN/MAX, que foi feito no dia 06/05/2015 às 08:12, até este instante de agora, a mínima registrada foi de 2.6°C e a máxima 5.0°C".

(I) BOTÃO "LUZ INTERNA

Pressione este botão para acender a luz interna do equipamento. A luz interna se acende e apagará automaticamente após o término do tempo programado.



001256

(J) BOTÃO "RESET MIN/MAX"
Pressione este botão para reiniciar os registros de mínima e máxima temperaturas.




(K) TELA DE ALARMES
Nesta área da tela irão ser exibidos os alarmes e alertas ativos, de forma alternada.

FUNCIONAMENTO OK	**"FUNCIONAMENTO OK"** Indica que nenhum alarme ou alerta está ativo no momento.
PORTA ABERTA!	**"PORTA ABERTA"** A porta do equipamento ficou aberta por um tempo maior do que o configurado para alarme.
TEMPERATURA ALTA	**"TEMPERATURA ALTA"** Temperatura interna está acima da configurada para alarme de temperatura alta.
TEMPERATURA BAIXA	**"TEMPERATURA BAIXA"** Temperatura interna está abaixo da configurada para alarme de temperatura baixa.
FALTA ENERGIA	**"FALTA ENERGIA"** O equipamento está trabalhando sem energia elétrica.
FALHA DE SENSOR	**"FALHA DE SENSOR"** O sensor de temperatura está desconectado ou com erro de leitura.
BATERIA FRACA	**"BATERIA FRACA"** Tela para gerenciamento dos usuários que terão acesso ao sistema.

 **"SILENCIAR ALARME"**	Juntamente com esta tela, em caso de alarmes, será disponibilizado este botão. - Pressione esta tecla para silenciar temporariamente o alarme sonoro. OBS: - Esta ação apenas silencia o alarme, mantendo ativas as mensagens na tela. - Se a condição que gerou o alarme não for eliminada, este será novamente ativado dentro de um tempo pré-programado.

 **"TESTE ALARME"**	Use este botão para executar uma rotina de TESTE DO ALARME do equipamento. Selecione o tipo de alarme desejado para teste (ALTA ou BAIXA) e o equipamento irá acionar o sistema de aquecimento/resfriamento dos sensores, permitindo a verificação audiovisual dos alarmes em funcionamento. OBS: - Esta rotina não afeta o sistema de controle de temperatura e registros de MIN/MAX. - Esta tecla estará disponível somente enquanto não houver nenhum outro alarme ativo no sistema (FUNCIONAMENTO NORMAL).

(L)GRÁFICO EM TEMPO REAL

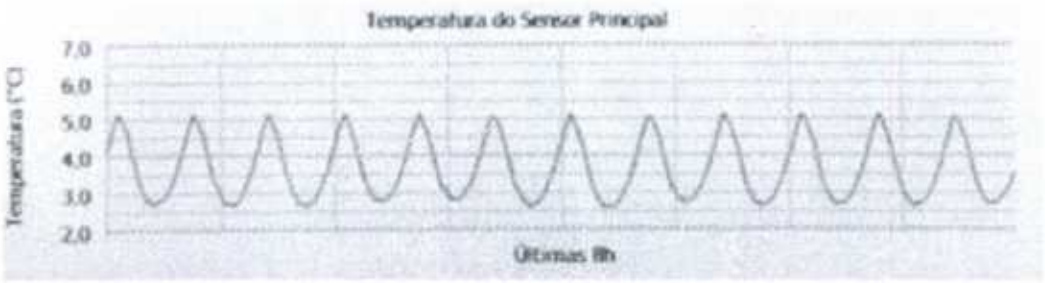

Na tela HOME é exibido um gráfico de temperaturas em tempo real referente às últimas 8 horas de trabalho do equipamento. O sensor exibido é o sensor principal do equipamento (controle). São exibidas também as linhas de referência: ALARME DE TEMP. ALTA, ALARME DE TEMP. BAIXA e SET POINT.

Ao tocar sobre qualquer ponto do gráfico, o sistema abrirá opções para análise detalhada do histórico. Ver adiante.


TELA "DETALHADO"

Esta é a tela onde é possível obter informações mais detalhadas sobre o funcionamento do controlador. É aqui que são exibidas as informações referentes aos demais sensores instalados, tempo de funcionamento dos compressores, contagem de abertura de portas, etc.



Cada sensor possui um padrão de cores que é utilizado em todas as telas. Para saber onde eles estão instalados, clique no botão "SENSORES".

001253

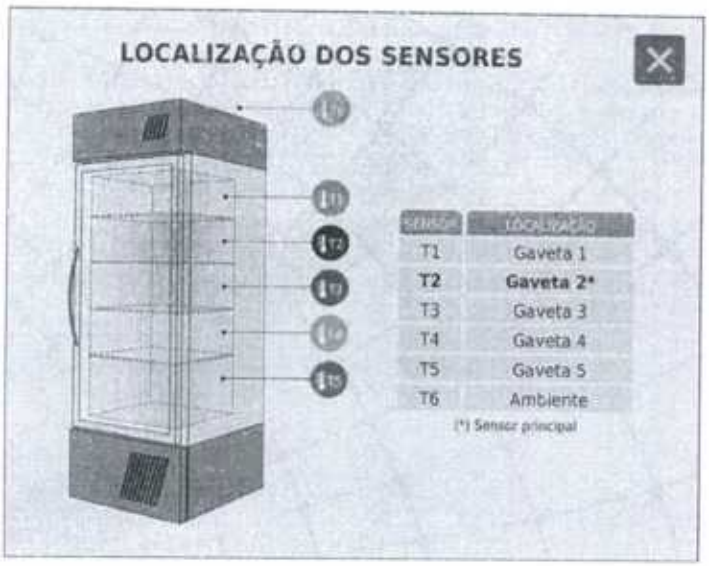

TELA HISTÓRICO


Esta é a tela onde é possível acessar os registros gravados na memória interna do equipamento, de forma a se obter histórico de temperatura em 3 tipos de formato: RESUMO, COMPLETO e GRÁFICO.
Nessa tela está disponibilizado o botão EXPORTAR, que serve para transferir os dados da memória interna do equipamento para uma Pendrive externa. Após teclar esse botão, selecione o tipo de arquivo que deseja exportar e o período desejado. OBS: Os dados são criptografados e só podem ser lidos em um computador com o software LEITOR DE DADOS INDREL instalado. Entrar em contato com o SUPORTE INDREL para fazer o download do instalador.

HISTÓRICO / RESUMO



Nesta tela temos uma tabela onde são exibidos os registros de temperaturas de todos os sensores instalados no equipamento. É possível visualizar as TEMPERATURAS MÉDIA, MÍNIMAS e MÁXIMAS registradas para cada sensor.
Cada tela exibe os dados referentes ao período de 1 dia. É possível navegar por dias anteriores, usando a barra de navegação através das setas ou edição de data.
DICA: Usar esta tela para ter um resumo rápido sobre como tem sido a variação de temperatura ao longo do período de trabalho do equipamento.

HISTÓRICO / COMPLETO

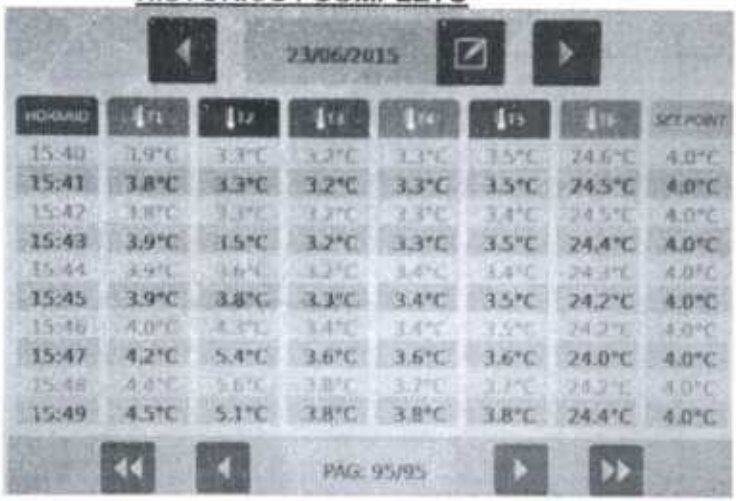


Nesta tela temos uma tabela onde são exibidos os registros de temperaturas de todos os sensores instalados no equipamento. É possível visualizar as TEMPERATURAS registradas a cada instante

Cada tela exibe os dados referentes ao período de 1 dia. É possível navegar por dias anteriores, usando a barra de navegação através das setas ou edição de data. Como este relatório é longo, temos na parte inferior uma barra de navegação por páginas.

DICA: Usar esta tela para fazer uma investigação mais minuciosa sobre como tem sido a variação de temperatura ao longo do período de trabalho do equipamento.

HISTÓRICO / GRÁFICO

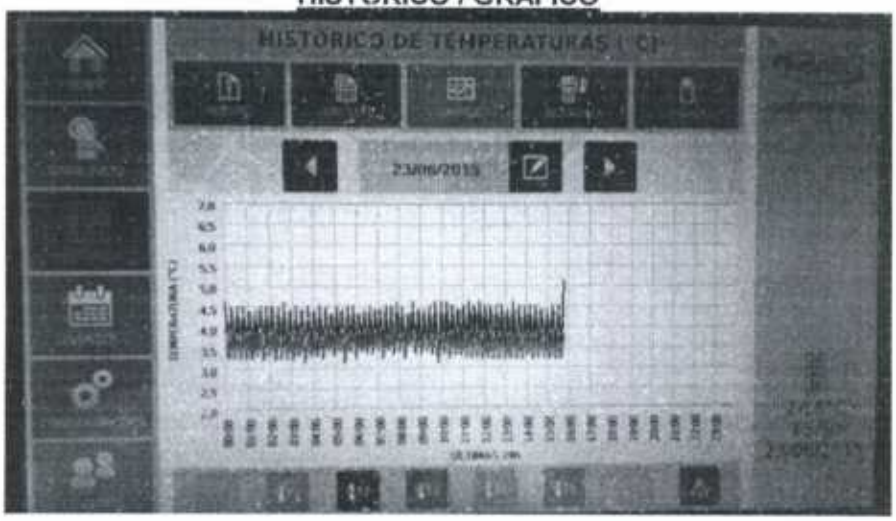

Nesta tela temos um gráfico onde são exibidos os registros de temperaturas de todos os sensores instalados no equipamento. É possível visualizar a forma como as TEMPERATURAS foram registradas a cada instante e a distribuição térmica do equipamento.

Cada tela exibe os dados referentes ao período de 1 dia. É possível navegar por dias anteriores, usando a barra de navegação através das setas ou edição de data. É possível escolher quais serão as curvas a serem plotadas, clicando na respectiva legenda, na parte inferior do gráfico.

DICA: Usar esta tela para obter uma visualização rápida, porém bastante abrangente, sobre como tem sido a variação de temperatura ao longo do período de trabalho do equipamento.

TELA "EVENTOS"


Esta é a tela onde é possível acessar os registros gravados na memória interna do equipamento, de forma a se obter histórico de eventos em 3 tipos de formato: ALARMES, ACIONAMENTOS e ALTERAÇÕES.

DICA: Existe aqui um botão FILTRO, que permite visualizar apenas os tipos específicos que forem selecionados.

Esta tela apresenta as alterações efetuadas pelos usuários do sistema. Identifica o parâmetro alterado, valor antigo, valor novo. Identifica também qual foi o usuário que efetuou a mudança e o horário.
Cada tela exibe os dados referentes ao período de 1 dia. É possível navegar por dias anteriores, usando a barra de navegação através das setas ou edição de data. Este relatório pode ser longo, por isso temos na parte inferior uma barra de navegação por páginas.

TELA "CONFIGURAÇÕES"
Nesta tela é possível acessar os parâmetros de funcionamento do equipamento e reprogramá-los, caso seja necessário.
OBS: Somente usuários cadastrados podem acessar essa tela, após confirmação da senha. O sistema sai de fábrica com o seguinte usuário padrão cadastrado: ADMIN (Senha: INDREL).

CONFIGURAÇÕES / PARÂMETROS
Nesta tela é possível ajustar os parâmetros do equipamento tais como: temperatura de trabalho, alarmes, entre outros.
Use as setas para escolher um parâmetro e, para alterar seu valor, use a tecla EDITAR.

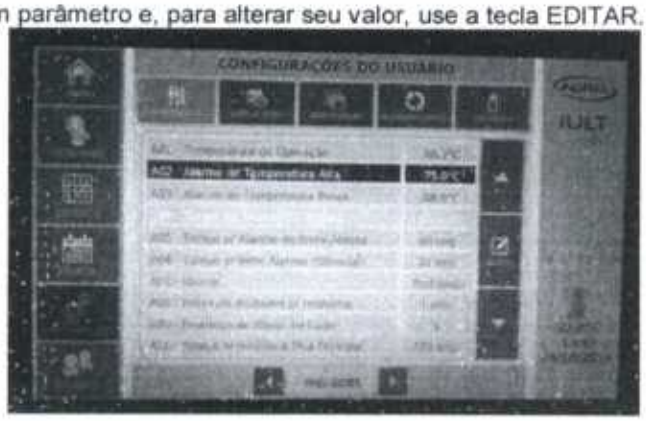

CONFIGURAÇÕES / DATA & HORA
Nesta tela é possível ajustar o calendário e relógio do equipamento.
Selecione o campo desejado e use as setas para alterar seu valor.




CONFIGURAÇÕES / MANUTENÇÃO
Nesta tela é possível visualizar informações gerais sobre o equipamento e também as datas previstas para a manutenção preventiva do equipamento.



TELA "USUÁRIOS"

Nesta tela é possível acessar a lista de usuários cadastrados. É possível criar novo usuário, editar existente e excluir usuários.

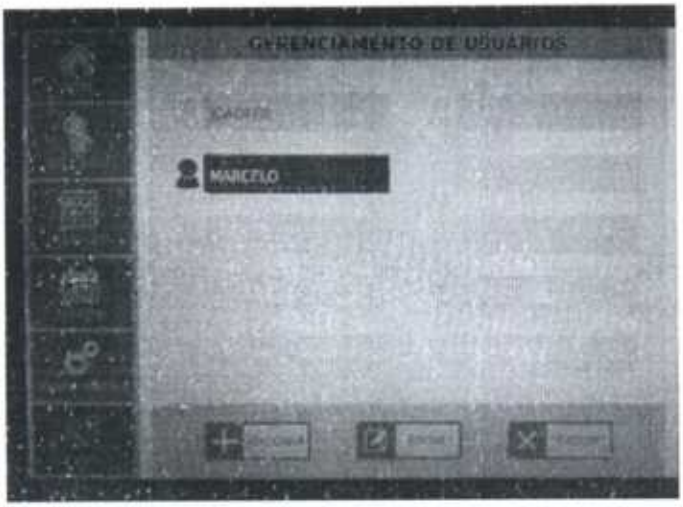

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Para inicializar o controlador INDREL TOUCH é necessário que exista energia AC. O sistema não liga somente com energia DC (baterias).
- Equipamentos montados com o opcional SAFETY SYSTEM possuem um mecanismo adicional de proteção elétrica. Ao ligar este equipamento pela primeira vez, aguarde aproximadamente 1 minuto para que o sistema possa inicializar todos os seus componentes internos. OBS: **Nunca desligue a CHAVE GERAL de um equipamento SAFETY SYSTEM durante uma eventual falta de energia elétrica.**
- O sistema de toque na tela é do tipo RESISTIVO, ou seja: só permite um toque por vez e não aceita comandos por gestos.

8 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

⚠ Obs.: Qualquer manutenção que NÃO esteja definida nessa seção deve ser realizada somente pelo serviço técnico qualificado INDREL. Desligar o equipamento e retirar o plug da tomada sempre que for começar a limpeza.
Os Equipamentos da linha **INDREL** são desenvolvidos com a mais alta tecnologia existente no mercado mundial. Com foco em segurança dos produtos armazenados e de nossos clientes, buscamos total tranquilidade em seu uso. Informações de manutenção e limpeza são essenciais para o uso e durabilidade dos equipamentos.

001263

8.1 - Manutenção Preventiva

Item de Verificação	Frequência
Verificação do Nível de Solução Diatérmica: ✓ Verificar o nível da solução diatérmica presente no frasco, localizada dentro do equipamento. A solução não pode conter menos de 50 mL.	**Semestral**
Limpeza da guarnição interna da porta: A limpeza da gaxeta interna da porta deverá ser realizada utilizando pano macio e sabão neutro somente. Verifique se estão intactas percorrendo com pano macio e seco todo seu trajeto. Após limpeza superficial das mesmas, verifique sua aderência em todas as extremidades. Após fechamento da porta para este teste, abra novamente a porta e realize nova limpeza com pano macio em toda sua superfície, passando com ainda mais cuidado na parte interna da gaxeta de vedação.	**A cada 4 meses**
Limpeza Interna: Desligar o equipamento e retirar o plug da tomada! A limpeza interna deverá ser realizada quando a verificação de algum resíduo derramado internamente. Devido ao uso de cada cliente, não existe um tempo padrão definido. O que recomendamos é a verificação contínua de usuário para não mais que 3 meses de cada limpeza. Primeiramente retire o produto armazenado colocando-o em novo equipamento com temperatura ideal já estabelecida, em seguida, retire com cuidado uma a uma as gavetas e ou prateleiras colocando-as em local seco e limpo. Utilize pano seco e limpo para uma perfeita limpeza. Não utilize nenhum produto no interior da câmara – Equipamento construído com material de alta resistência e assepsia. Comece o trabalho de limpeza pela parte superior da câmara. Com movimentos lentos, faça a limpeza interna da câmara retirando os frascos criogênicos das paredes (quando aplicados) e limpando-os separadamente. Todo o processo de limpeza não deverá se prolongar a tempo maior que 30 minutos. Após limpeza, recoloque todos os frascos e gavetas em seus devidos lugares e ligue o produto na rede elétrica. Aguarde por 30 minutos para retomada de refrigeração interna e carregue o produto novamente com material de armazenamento. **Atenção** - todo o processo de limpeza não deverá prolongar-se por mais de 30 (trinta minutos). Obs.: CUIDADO – Ao limpar o equipamento tome sempre cuidado para não deixar molhar o sistema de comando dos equipamentos.	**A cada 3 meses ou Conforme Necessidade**
Limpeza externa: Desligar o equipamento e retirar o plug da tomada! Utilize apenas solução de água com sabão neutro, aplicando com pano macio seguido de pano seco para remover a umidade. Não utilize nenhum tipo de produto químico ou solvente neste procedimento. Nota: Para limpeza das GAVETAS e PRATELEIRAS, removê-las do equipamento e proceder a limpeza da mesma forma.	**A cada 3 Meses ou Conforme Necessidade**
Desinfecção: Conforme recomendado pelo Ministério da Saúde - ANVISA, o produto de Primeira escolha indicado para desinfecção de superfícies de equipamentos em estabelecimentos de saúde é o ÁLCOOL 70%. Recomendamos realizar primeiramente o processo de Limpeza, conforme indicado acima e posteriormente, com o auxílio de um pano macio e umedecido em Álcool 70%, limpar a superfície interna e externa do equipamento. Obs1: Sempre que for realizar a Limpeza e Desinfecção, desligar a chave geral e retirar o plug da tomada. Nunca utilize objetos pontiagudos ou cortantes! Obs2: Esta seção fornece instruções de limpeza e manutenção. A manutenção que não é fornecida nessa seção deve ser executada somente pelo serviço técnico qualificado Indrel.	**A cada 3 Meses ou sempre que houver derramamento de Materiais Contaminantes no Equipamento**

✓ ⚠⚡ Nunca utilize água no interior do gabinete! Para enxaguar, use pano macio umedecido e por último, secar com pano seco;


✓ Não utilizar nenhum produto químico ou solvente nesse procedimento.

ATENÇÃO ESPECIAL:

Para limpeza do INDREL REFRIMED, é indispensável o uso de panos e materiais novos.

Remoção das gavetas deslizantes e lubrificação:

Os equipamentos Indrel são providos de um sistema exclusivo de gavetas com trilhos deslizantes, removíveis e ajustáveis, tendo um modo seguro de manusear. Para sua retirada, basta remover a gaveta em sua totalidade para fora do equipamento, localizar as travas plásticas na lateral da gaveta, pressionar simultaneamente a trava da direita para baixo e a trava da esquerda para cima, puxando assim a gaveta para fora do equipamento. Para recolocar, apenas posicione a gaveta com cuidado em frente aos trilhos fixos no gabinete e empurre a gaveta para dentro do equipamento até o seu travamento final, abra a gaveta com cuidado e verifique se esta devidamente encaixada. ATENÇÃO – a gaveta deverá correr suavemente, não force ao tentar recolocar, podendo assim danificar os trilhos. Para um perfeito uso e durabilidade, recomenda-se lubrificar os trilhos quando necessário – utilizar lubrificante neutro.

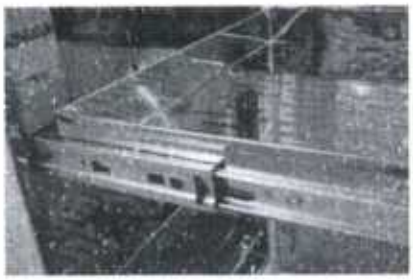

8.2 - Manutenção Corretiva

ATENÇÃO ESPECIAL:

O conserto realizado por técnico não autorizado da Indrel, invalidará sua garantia automaticamente. Contate a Indrel e seu serviço técnico autorizado pelo fone (55) (43) 3378-5500 ou pelo e-mail suporte@indrel.com.br para informação adicional. Para manutenções em geral, é fundamental para garantia da vida útil do produto, que todo trabalho seja realizado por pessoa técnica qualificada e com substituição de peças originais.

9 - EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Por se tratarem de equipamentos desenvolvidos exclusivamente para controle de pesquisa e armazenamento científicos de alta precisão, os equipamentos devem ser armazenados e desembalados de maneira profissional e correta. Para o perfeito funcionamento, recomendamos que os trabalhos de desembalagem dos produtos sejam realizados por equipe credenciada e qualificada de assistentes técnicos INDREL.

9.1 - EMBALAGEM

Os equipamentos são embalados com material de alta resistência em madeira, papel especial ou outros materiais não nocivos ao meio ambiente e recicláveis.
Todo e qualquer material desta embalagem deverá ser encaminhado para reciclagem e ou reaproveitamento posterior.
Informações adicionais com sistema de assistentes técnicos credenciados.
Antes mesmo de receberem os produtos, a rede credenciada INDREL fará contato para agendamento e instalação dos equipamentos. O mesmo ficará em total concordância com a necessidade do cliente.

Desembalagem

10 - PROBLEMAS E CAUSAS PROVÁVEIS

Falha	Causa	Solução
O equipamento não liga	Painel de controle / comando digital.	- Verifique inicialmente o plug da tomada de força para ver se está corretamente conectada e sem sinais de aquecimento excessivo. - Verifique se á tensão correta na tomada de força do equipamento (127 ou 220 volts). - Se nenhum dos procedimentos acima foi conclusivo e o defeito permanecer entre em contato com o credenciado INDREL mais próximo para solução do problema.
O equipamento está ligado, mas a temperatura está muito alta	Painel de Controle – Sistema mecânico.	- Certifique-se de que não foi carregado produto para conservação no equipamento nas últimas 2 horas. (Sempre que uma quantidade significativa de produto é colocado no equipamento, a temperatura da câmara pode variar, subindo a patamares que acionem o alarme, isso é normal e não prejudica o que já se encontra depositado). - Verifique inicialmente o plug da tomada de força para ver se está corretamente conectada e sem sinais de aquecimento excessivo. - Verifique se o sistema de compressores trabalha sem nenhum ruído ou se o sinaleiro de refrigeração (painel) está ligado. - Com o manual em mãos, verifique a temperatura setada (ajustada) no controle digital. Se estiver desajustado, proceda a regulagem conforme orientação passo a passo do manual. - Verificar qual a lâmpada de sinalização do painel de comando está ligada. - Se nenhum dos procedimentos acima foi conclusivo e o defeito permanecer entre em contato com o credenciado INDREL mais próximo para solução do problema.
O equipamento apresenta ruído elevado	Sistema Mecânico.	- Desconecte o equipamento da tomada e espere até que o equipamento esteja totalmente parado. Abra o painel de controles/ventilação situado na parte superior/inferior do equipamento (localizar base mecânica do produto). Verifique se não há nenhum objeto preso nos ventiladores, tais como papeis plásticos, ou outros. Se não estiver detectado e corrigido prossiga. Mantendo-se em segurança ligue novamente o equipamento provocando o funcionamento do mesmo e sempre sem acessar com a mão ou objetos as partes internas, verifique a causa e local dos ruídos. Se detectado, desligue o equipamento novamente e faça os devidos ajustes. Volte a fechar o equipamento conforme originalmente.
		- Se nenhum dos procedimentos acima foi conclusivo e o defeito permanecer entre em contato com o credenciado INDREL mais próximo para solução do problema.
A temperatura da câmara não Abaixa	Sistema Mecânico.	- Verificar a tensão da rede de alimentação se a tensão for baixa ou se ela oscilar frequentemente utilize um estabilizador de tensão; - Verificar se o comando digital esta com padrão e ajustes de fabrica (verificar padrões em manual). - Verificar nivel de ruído do sistema mecânico (compressores e micro ventiladores). Se acima do normal, desligar o equipamento e entrar em contato com equipe Indrel. - Verificar com o departamento de Assistência Técnica as marcas e modelos recomendados pela INDREL.
Desajuste dos valores de	Desajuste manual (pessoal não	- Verificar o manual e seus parâmetros de configuração de fábrica. - Desligar o produto e ligá-lo novamente resetando assim o

Retirar material de segurança do topo do produto, utilizando chaves de fenda e ou martelo convencional (se embalado com madeira – compensado natural). Ao retirar a tampa, verifique o mesmo procedimento para laterais do produto. Retire o involucro transparente que protege diretamente o equipamento e seus componentes, tais como cantoneiras, suportes laterais / frontais – Não utilize material cortante ou semelhantes. Assim que removido, retire os calços (04 calços – fixadores) localizados abaixo do produto, neste momento necessitam de cuidado maior com o equipamento, pois o mesmo pode vir equipado com rodizios de alinhamentos e, portanto deverá ser manuseado em base plana. O equipamento deverá ser cuidadosamente alinhado ao chão.



ATENÇÃO ESPECIAL:

Utilizem nossa rede de assistentes técnicos credenciados – Fone (43) 3378 5500.
Os serviços prestados por equipe técnica para instalação de qualquer equipamento Indrel não deverá ser paga pelo cliente.
Rede credenciada e treinada para todo território nacional.

9.2 - ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO EMBALADO

Em caso de recebimento de produto e não disponibilizado para utilização imediata dos mesmos, o armazenamento poderá ser feito seguindo as seguintes recomendações:
- Sempre em local fechado e seguro.
- Sempre em local seco e reservado.
- Sempre evitando contato direto de raios solares.
- Sempre com umidade relativa abaixo de 75%.

O bom armazenamento do produto antes de ser utilizado pelo cliente garante maior vida útil do equipamento e satisfação geral.

Temperatura Ambiente.....5ºC a 55ºC
Umidade Relativa.....30% a 75%

Obs.: Condições especificadas com o equipamento devidamente embalado.

9.3 - ARMAZENAMENTOS DE COMPONENTES NO EQUIPAMENTO

Ao armazenar adote um critério de ordenamento que proporcione a fácil e rápida identificação do produto desejado no interior do equipamento, evitando-se assim periodos prolongados de portas abertas.
Os funcionários responsáveis pelo manuseio dos produtos devem conhecer as técnicas básicas necessárias de conservação permissíveis para cada tipo de produto.
Afixar as instruções próximas ao equipamento para o conhecimento dos funcionários que manipulam os produtos é sempre uma solução recomendável.
A refrigeração ocorre normalmente conforme a temperatura programada no controlador e se estabiliza quando atingir a temperatura operacional na câmara de armazenamento.
Caso falte energia elétrica, evite abrir a porta.

⚠ A Indrel não se responsabiliza por qualquer dano ocorrido aos produtos armazenados.

9.4 - TRANSPORTE

O equipamento deve ser transportado na posição vertical, mantendo as condições de embalagem, conforme simbolos harmonizados definidos na embalagem externa. Inclinação máxima de 5º.



ATENÇÃO ESPECIAL:

Ao manusear os produtos, deve-se usar o menor tempo possível em cada abertura de porta. Verificar o fechamento da mesma ao final do uso para que não ocorra nenhum problema de mudança ou elevação de temperatura evitando assim problemas com o produto armazenado.

10 - PROBLEMAS E CAUSAS PROVÁVEIS

Falha	Causa	Solução
O equipamento não liga	Painel de controle / comando digital.	- Verifique inicialmente o plug da tomada de força para ver se está corretamente conectada e sem sinais de aquecimento excessivo. - Verifique se á tensão correta na tomada de força do equipamento (127 ou 220 volts). - Se nenhum dos procedimentos acima foi conclusivo e o defeito permanecer entre em contato com o credenciado INDREL mais próximo para solução do problema.
O equipamento está ligado, mas a temperatura está muito alta	Painel de Controle – Sistema mecânico.	- Certifique-se de que não foi carregado produto para conservação no equipamento nas últimas 2 horas. (Sempre que uma quantidade significativa de produto é colocado no equipamento, a temperatura da câmara pode variar, subindo a patamares que acionem o alarme, isso é normal e não prejudica o que já se encontra depositado). - Verifique inicialmente o plug da tomada de força para ver se está corretamente conectada e sem sinais de aquecimento excessivo. - Verifique se o sistema de compressores trabalha sem nenhum ruído ou se o sinaleiro de refrigeração (painel) está ligado. - Com o manual em mãos, verifique a temperatura setada (ajustada) no controle digital. Se estiver desajustado, proceda a regulagem conforme orientação passo a passo do manual. - Verificar qual a lâmpada de sinalização do painel de comando está ligada. - Se nenhum dos procedimentos acima foi conclusivo e o defeito permanecer entre em contato com o credenciado INDREL mais próximo para solução do problema.
O equipamento apresenta ruído elevado	Sistema Mecânico.	- Desconecte o equipamento da tomada e espere até que o equipamento esteja totalmente parado. Abra o painel de controles/ventilação situado na parte superior/inferior do equipamento (localizar base mecânica do produto). Verifique se não há nenhum objeto preso nos ventiladores, tais como papeis plásticos, ou outros. Se não estiver detectado e corrigido prossiga. Mantendo-se em segurança ligue novamente o equipamento provocando o funcionamento do mesmo e sempre sem acessar com a mão ou objetos as partes internas, verifique a causa e local dos ruídos. Se detectado, desligue o equipamento novamente e faça os devidos ajustes. Volte a fechar o equipamento conforme originalmente.
		- Se nenhum dos procedimentos acima foi conclusivo e o defeito permanecer entre em contato com o credenciado INDREL mais próximo para solução do problema.
A temperatura da câmara não Abaixa	Sistema Mecânico.	- Verificar a tensão da rede de alimentação se a tensão for baixa ou se ela oscilar frequentemente utilize um estabilizador de tensão; - Verificar se o cornando digital esta com padrão e ajustes de fabrica (verificar padrões em manual). - Verificar nível de ruído do sistema mecânico (compressores e micro ventiladores). Se acima do normal, desligar o equipamento e entrar em contato com equipe Indrel. - Verificar com o departamento de Assistência Técnica as marcas e modelos recomendados pela INDREL.
Desajuste dos valores de	Desajuste manual (pessoal não	- Verificar o manual e seus parâmetros de configuração de fábrica. - Desligar o produto e ligá-lo novamente resetando assim o

temperatura e alarmes.	autorizado) ou Ruídos provocados por rede elétrica não apropriada.	padrão de fábrica. - Efetuar o reset do equipamento no sistema de comando em "Restaurar config" (apenas em painel de comando em LCD). Se nenhum dos procedimentos der resultado, procurar por equipe técnica Indrel.
Variações de temperaturas internas da câmara	Sistema mecânico – Interno.	- Verifique se os micro-motores estão funcionando. - Verifique se não há obstrução da circulação de ar ou do micro motor interno.

11 - CERTIFICADO DE GARANTIA

001263

A garantia oferecida refere-se a defeitos de fabricação dos componentes dos equipamentos INDREL. A garantia não cobre frete e embalagens (caso tenha recebido sua embalagem danificada, relatar o mesmo junto a transportadora no verso da cópia da nota fiscal). O período coberto pela garantia é de 12 (doze) meses, a partir da data da emissão da Nota Fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor ao primeiro proprietário.

Com a Nota Fiscal de compra e o Certificado de Garantia preenchido, dará direito ao serviço gratuito de assistência técnica no período de garantia. Esta garantia perde o efeito quando o equipamento for operado indevidamente, fora das especificações técnicas fornecidas pela INDREL ou quando instalado em condições precárias em desacordo com as normas de engenharia em refrigeração científica laboratorial e hospitalar. Em caso de instalação ou manutenção por terceiros e não nossa rede de autorizados Indrel, a garantia perde sua validade em imediato. Esta garantia não cobre defeitos de rede ou fatores elétricos externos em nenhum caso (A Indrel não se responsabiliza por qualquer dano ocorrido aos produtos armazenados). Não estão inclusos nesta garantia, as peças fabricadas por terceiros, tais como itens opcionais, material de reposição e ou descartáveis. Você possui um equipamento de alta tecnologia, não permita que leigos o destruam, mesmo após o período de garantia, consulte o nosso departamento técnico para as orientações que forem necessárias, para informações use o E-MAIL: suporte@indrel.com.br ou pelo tel.: (43) 3378 –5500. Use sempre peças originais Indrel.

EQUIPAMENTO:.....

MARCA:.....**MODELO:**.....**Nº. DE SÉRIE.**.....

COMPRADOR/REVENDEDOR.....

USUÁRIO/CLIENTE FINAL.....

ENDEREÇO:.....

TEL.(.....).....**FAX.:.(.....)**.....**E-MAIL.:**.....

NOTA FISCAL INDREL Nº.:.....**DATA DA EMISSÃO DA NF DE REVENDA**...../...../.....

VENCIMENTO DA GARANTIA...../...../.....

Declaro que recebi o equipamento acima identificado em perfeitas condições de uso e funcionamento, estando também de pleno acordo com as normas de garantia do fabricante, tendo recebido inclusive o manual do proprietário, com as informações necessárias para o perfeito funcionamento e manuseio do equipamento adquirido.

...../...../.....

....

CLIENTE INDREL

ANEXO I

Sistema de Rastreabilidade de Temperatura – Padrão Indrel.

001269

Controle de Temperatura Indrel.

Os sistemas de controle de temperatura dos equipamentos INDREL atendem as exigências de todas as normas internacionais e nacionais de medição, pois controlam efetivamente a temperatura dos produtos armazenados, através de exclusivo sistema de controle de temperatura por meio de solução diatérmica no interior dos equipamentos com sistemas de duplo, triplo e até quádruplos sensores.
Com este controle, mesmo nos inevitáveis momentos de degelo do equipamento, em ciclos programáveis e automáticos, onde a elevação da temperatura do ar da câmara pode sofrer variações, o produto armazenado nunca sai da faixa pré-determinada para conservação e controle específico.

Verificação e testes se necessário:

Para verificação das condições de trabalho, de um equipamento, e/ou monitoramento externo das temperaturas para certificações, quando necessário, não devem ser utilizados "data loggers", termômetro capela ou outros diretamente no ar do gabinete, mas sim "data loggers", termômetros de memória entre outros imersos em solução de álcool (mínimo 90°GL). Este processo identifica a real temperatura do produto armazenado e não da câmara interna. Sempre que monitorado o ar da câmara, teremos diferenças de temperaturas e alto nível de variação do ar.
Para perfeito ajuste, posicione os sensores (data loggers, termômetros) no centro das prateleiras do equipamento e monitore por no mínimo 4 horas de funcionamento.
Observação: Faça o monitoramento sempre com o equipamento com no mínimo metade de sua capacidade de armazenamento utilizada, ou seja, com meia carga ou mais de produtos armazenados. É importante ressaltar que os testes jamais devem ser realizados com equipamento vazio.

Avaliação de monitoramento e temperatura ideal:

Na avaliação dos monitoramentos das temperaturas, nas condições acima estipuladas, são aceitáveis variações de temperaturas internas em função do posicionamento das prateleiras (mais baixas, temperaturas menores), posicionamento de sensores e controles, tempo mínimo de monitoramento, capacidade e carga efetiva do produto, variações nos momentos de degelo automático dos equipamentos entre outros. Porém tais variações nunca deverão sair faixa determinada de controle e segurança dos produtos armazenados. Como quadro abaixo:

Produto	Temperatura Indicada	Temperatura Limite	Termômetro indicado
Refrigerador	+4°C	± 2°C	Termômetro calibrado em solução glicosada.

A INDREL através de pesquisas constantes e desenvolvimentos de seus produtos oferecem o que há de melhor em tecnologia de equipamentos de refrigeração médico hospitalar e laboratorial no mercado mundial, com testes contínuos para oferecer segurança na conservação de produtos médico hospitalar.
Todos os equipamentos INDREL são testados em laboratório interno por período mínimo de 48/72 horas (dependendo da família de produtos) antes de ser enviado ao cliente.
Para maiores informações e segurança em sua rastreabilidade, contate nossa rede de assistentes técnicos autorizada.

001270

INDREL
SCIENTIFIC

A INDREL reserva o direito para fazer mudanças neste manual e nos equipamentos nele descritos sem prévio aviso.

INDREL – INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.

CNPJ:78.589.504 /0001-86 ICMS:601.03117-54 CMC:015099-1-C ATIV.241.104-0 CREA 4551-F.
AV. TIRADENTES,Nº4455 - CEP.:86.072-000 - Caixa.Postal .Nº423 - Londrina - Paraná - Brasil
Telefone (43) 3378-5500 - Fax (43) 3378-5501 - www.indrel.com.br - suporte@indrel.com.br – suportebr@indrel.com.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 448807051913460006S8-1; Data: 07/05/2018 13:56:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

001271

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA**, CNPJ nº 08.597.121/0001-74, com endereço na Rua Piquiri, 170, Bairro Rebouças, CEP: 80.230-140 cidade de Curitiba, Estado do Paraná, ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa, Indrel Industria de Refrigeração Londrina, ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ.:78.589.504/0001-86, com sede a Av. Tiradentes, 4455 – Jd. Rosicler, município de Londrina, Estado do Paraná, nos forneceu o material descrito abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS/OBJETOS
242/2013	84	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERV. DE SANGUE E DERIVADOS (EQUIP. INDREL RVV-22D(VSS) - 127V
366/2013	01	CAMARA AMBIENTADORA PARA PLAQUETAS COM PERMUTADOR – CDCI
226/2013	27	EQUIPAMENTO INDREL RVV-1500D (V2) - 127V (REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERV. DE SANGUE E DERIVADOS.
419/2013	01	CONGELADOR FREEZER VERTICAL 220V – CLC300DAF
177/2014	01	CÂMARA AMBIENTADORA DE PLAQUETAS -CDCI
173/2014	287	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS CONSERVAÇÃO SANGUE E IMUNODERIVADOS (RVV-22D VSS - 127V)
198/2014	11 06	CONGELADOR FREEZER VERTICAL CLC 504D 220V CONGELADOR FREEZER VERTICAL IULT 335D CRP

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO - DEMP
Av. Prefeito Lothário Meisner,350 – Jardim Botânico – 80.210-170 – Curitiba – Paraná – Brasil
Fone: (41) 3360-6780

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.470-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 448807051913460006S8-2; Data: 07/05/2018 13:50:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

	05	220V - REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS RC 330D 127V.
392/2014	15	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERV SANGUE E DERIVADOS MODELO INDREL RVV-22D VSS 127V
109/2015	03	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERV SANGUE E DERIVADOS – RVV880D
380/2014	49	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERV SANGUE E DERIVADOS – RVV 1500D/2
185/2015	26	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE – RVV1500D/2
140/2015	25	CAMARA AMBIENTADORA DE PLAQUETAS –CDCI3

Cumprindo todos os prazos contratados e demais exigências contratuais, não constando de nossos assentamentos até a presente data, nada que a desabone. Ainda declaramos que a instalação ocorreu de forma satisfatória, sendo a empresa apta a prestar tal serviço.

Curitiba, 24 DE ABRIL de 2017.

EVANDRO LUIZ WISNIEWSKI
Chefe do DEMP

EDER BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS
Chefe Divisão de Patrimônio - DAP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

001273

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/05/2019 13:50:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1239998

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até **07/05/2020 13:50:13 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 44880705191346000658-1 a 44880705191346000658-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbdb7428c309a6cdf7fbc3653e3da9060d626d5fea6943f0ecfa422544c34d747c4819d06b0ca810d38506453cfa
ae9d8c3c6b383049400f01a1c51fb2b37c0ba

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 448807051913455704661-1; Data: 07/05/2018 13:50:12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

001274

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA**, CNPJ nº 08.597.121/0001-74, com endereço na Rua Piquiri, 170, Bairro Rebouças, CEP: 80.230-140 cidade de Curitiba, Estado do Paraná, ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa, Indrel Industria de Refrigeração Londrina, ltda., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ.:78.589.504/0001-86, com sede a Av. Tiradentes, 4455 – Jd. Rosicler, município de Londrina, Estado do Paraná, nos forneceu o material descrito abaixo.

PREGÃO ELETRÔNICO	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS/OBJETOS
349/2015	02	CÂMARA AMBIENTADORA CDCI1
349/2015	03	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE RVV440D
224/2015	09	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE RVV440D
224/2015	01	CONGELADOR BLAST FREEZER VERTICAL
271/2015	08	CAMARA AMBIENTADORA DE PLAQUETAS CDCCI1
271/2015	03	CONGELADOR BF BLAST FREEZER VERTICAL
271/2015	03	REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE RVV440D
271/2015	02	CONGELADOR FREEZER VERTICAL CLC504D
271/2015	27	EQUIPAMENTO INDREL RVV-1500D (V2) - 127V (REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PRÓPRIO PARA CONSERV. DE SANGUE E DERIVADOS.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO - DEMP
Av. Prefeito Lothário Meisner,350 – Jardim Botânico – 80.210-170 – Curitiba – Paraná – Brasil
Fone: (41) 3360-6780

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-8
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 448807051913455704662; Data: 07/05/2019 13:56:12
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

Cumprindo todos os prazos contratados e demais exigências contratuais, não constando de nossos assentamentos até a presente data, nada que a desabone. Ainda declaramos que a instalação ocorreu de forma satisfatória, sendo a empresa apta a prestar tal serviço.

Curitiba, 25 DE ABRIL de 2017.

EVANDRO LUIZ WISNIEWSKI
Chefe do DEMP

EDER BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS
Chefe Divisão de Patrimônio - DAP

001276

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/05/2019 13:50:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1239999

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **07/05/2020 13:50:12 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 44880705191345570466-1 a 44880705191345570466-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbdb7428c309a6cdf7fbc3653e3da90601096b238bd5c7de06f204b60bff78c77c4819d06b0ca810d38506453cfa
ae9d8123e5d477c4d28f07627784a2d4d9839

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

84 doda

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MB TÊXTIL LTDA		
CNPJ	00.894.372/0001-09	**Autorização**	1.03.071-3
Produto	ATADURA DE CREPOM		

Modelo Produto Médico

APOLO, 09, 11, 13, 17 FIOS, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm/largura x, 1,20 m ou 1,80 m em repouso/comprimento;IMED 9, 11, 13, 17 Fios/cm2 - 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm/largura x 1,20 m ou 1,80 m em repouso/comprimento;CIRUMEX 9, 11, 13, 17 Fios/cm2 - 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm/largura x 1,20 m ou 1,80 m em repouso/comprimento;MB 9, 11, 13, 17 Fios/cm2 - 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm/largura x 1,20 m ou 1,80 m em repouso/comprimento;MB MED 9, 11, 13, 17 Fios/cm2 - 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm/largura x 1,20 m ou 1,80 m em repouso/comprimento.

NEEDS 9, 11, 13, 17, Fios/cm2 – 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm/largura x 1,20m ou 1,80m em repouso/comprimento.

Nome Técnico	Gazes e Ataduras
Registro	10307130022
Processo	25351.801548/2010-00
Origem do Produto	• FABRICANTE: MB TÊXTIL LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

00127

63

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001278

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MB TÊXTIL LTDA		
CNPJ	00.894.372/0001-09	**Autorização**	1.03.071-3
Produto	ATADURA DE CREPOM ANDREONI		

Modelo Produto Médico

RUBI, 09, 11, 13, 15,18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm; PEROLA, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,20 m em repouso; PEROLA, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,80 m em repouso; PEROLA PLUS, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,20 m em repouso; PEROLA PLUS, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,80 m em repouso; CROCHET PEROLA PLUS, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,20 m em repouso; CROCHET PEROLA PLUS, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,80 m em repouso.

Nome Técnico	Gazes e Ataduras
Registro	10307130014
Processo	25351.262373/2010-82
Origem do Produto	• FABRICANTE: MB TÊXTIL LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

82 83 dala

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MB TÊXTIL LTDA		
CNPJ	00.894.372/0001-09	**Autorização**	1.03.071-3
Produto	ATADURA DE CREPOM ANDREONI		

Modelo Produto Médico

RUBI, 09, 11, 13, 15,18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm; PEROLA, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,20 m em repouso; PEROLA, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,80 m em repouso; PEROLA PLUS, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,20 m em repouso; PEROLA PLUS, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,80 m em repouso; CROCHET PEROLA PLUS, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,20 m em repouso; CROCHET PEROLA PLUS, 9, 11, 13, 15, 18 FIOS, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 cm, 1,80 m em repouso.

Nome Técnico	Gazes e Ataduras
Registro	10307130014
Processo	25351.262373/2010-82
Origem do Produto	• FABRICANTE: MB TÊXTIL LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

atadura 13 fios conforme ata

0001273

R A Martins

001280

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ	03.155.958/0001-40	**Autorização**	8.01.278-4
Produto	COLPOSCÓPIO BINOCULAR		

Modelo Produto Médico
PE - 7000 F
PE - 7000 V
PE - 7000 Z

Nome Técnico	Colposcopio
Registro	80127840014
Processo	25351.598341/2012-90
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 78 modelo

Detalhes do Produto 001281

Nome da Empresa	SIMILAR & COMPATÍVEL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME		
CNPJ	08.877.271/0001-31	**Autorização**	8.04.454-1
Produto	CANETA AUTOCLAVÁVEL SIMILAR & COMPATÍVEL		

Modelo Produto Médico
COMANDO MANUAL; COMANDO PEDAL

Nome Técnico	Caneta Para Eletrobisturi
Registro	80445410008
Processo	25351.084971/2014-26
Origem do Produto	• FABRICANTE: SIMILAR & COMPATÍVEL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	15/12/2024

Voltar

001282

Detalhe do Produto: AGUA PARA INJEÇÃO

Nome da Empresa	EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA		
CNPJ	01.784.792/0001-03	**Autorização**	1.01.772-2
Nome Comercial	AGUA PARA INJEÇÃO		
Classe Terapêutica	DILUENTES E VEICULOS DE MEDICAMENTOS		
Registro	117720024		
Processo	25351.281920/2004-00		
Vencimento do Registro	02/2020		

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 90 FR POLIET X 125 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	25	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240250
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 48 FR POLIET X 250 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	26	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240269
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		

001283

Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 24 FR POLIET X 500 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	27	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240277
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 12 FR POLIET X 1000 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	28	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240285
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		

Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

001284

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 BOL PVC X 50 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	34	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240341
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - BOLSA PVC • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**

SOL INJ CX 90 BOL PVC X 100 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	35	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240358
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - BOLSA PVC • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 48 BOL PVC X 250 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	36	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240366
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - BOLSA PVC • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		

Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 24 BOL PVC X 500 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	37	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240374
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - BOLSA PVC • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 12 BOL PVC X 1000 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	38	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240382
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - BOLSA PVC • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		

Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 AMP POLIET X 01 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	1	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240013
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 150 AMP POLIET X 01 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	2	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240021
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		

Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 200 AMP POLIET X 01 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	3	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240031
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 300 AMP POLIET X 01 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	4	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240048
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		

Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 AMP POLIET X 02 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	5	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240056
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 150 AMP POLIET X 02 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	6	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240064
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		

Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 200 AMP POLIET X 02 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	7	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240072
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 300 AMP POLIET X 02 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	8	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240080
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		

Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 AMP POLIET X 03 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	9	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240099
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 150 AMP POLIET X 03 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	10	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240102
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		

Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 200 AMP POLIET X 03 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	11	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240110
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 300 AMP POLIET X 03 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	12	31/01/2005

Validade	24 meses	**Registro**	1177200240129
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 AMP POLIET X 04 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	13	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240137
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
SOL INJ CX 150 AMP POLIET X 04 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	14	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240145
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
SOL INJ CX 200 AMP POLIET X 04 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	15	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240153
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		

Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 300 AMP POLIET X 04 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	16	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240161
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 AMP POLIET X 05 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	17	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240171
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		

Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 150 AMP POLIET X 05 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	18	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240188
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 200 AMP POLIET X 05 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	19	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240196
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		

Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 AMP POLIET X 10 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	21	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240218
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 AMP POLIET X 20 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	23	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240234
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		

Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 200 AMP POLIET X 20 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	24	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240242
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 100 BOL PLAS TRANS FLEX X 50 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	29	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240293
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		

IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 90 BOL PLAS TRANS FLEX X 100 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	30	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240307
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - BOLSA DE PLASTICO INCOLOR FLEXIVEL • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 48 BOL PLAS TRANS FLEX X 250 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	31	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240315
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - BOLSA DE PLASTICO INCOLOR FLEXIVEL • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		

Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 24 BOL PLAS TRANS FLEX X 500 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	32	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240323
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - BOLSA DE PLASTICO INCOLOR FLEXIVEL • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 12 BOL PLAS TRANS FLEX X 1000 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	33	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240331

Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*
Embalagem	• Primária - BOLSA DE PLASTICO INCOLOR FLEXIVEL • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 48 FR PE SIST FECH X 250 ML	*******	39	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240390
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	INTRAVENOSA		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação [ATIVA]	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
SOL INJ CX 24 FR PE SIST FECH X 500 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	40	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	117200240404
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	INTRAVENOSO		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação [ATIVA]	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
SOL INJ CX 40 FR PE SIST FECH X 250 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	41	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	117200240412
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	INTRAVENOSO		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		

Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 70 FR PE SIST FECH X 100 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	42	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240420
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	INTRAVENOSO		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 12 FR PE SIST FECH X 1000 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	43	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240439
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO COM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	INTRAVENOSO		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		

Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 20 FR PE SIST FECH X 500 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	44	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240447
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	INTRAVENOSO		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 70 FR PE SIST FECH X 50 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	45	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240455
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - FRASCO DE POLIETILENO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		

Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	INTRAVENOSO
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	46	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240463
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	• Primária - AMPOLA DE POLIETILENO INCOLOR • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	INTRAVENOSA		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Apresentação ATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 300 AMP PE X 5 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	47	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240471
Princípio Ativo	ÁGUA PARA INJEÇÃO		

Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*
Embalagem	• Primária - AMPOLA DE POLIETILENO INCOLOR • Secundária - CAIXA DE PAPELAO SEM COLMEIA
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais • EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - APARECIDA DE GOIÂNIA - BRASIL Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	INTRAVENOSA
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C)
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação INATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
SOL INJ CX 300 AMP POLIET X 05 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	20	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240201

Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)
IFA único	Sim
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*
Destinação	Comercial
Restrito a hospitais	**Não Informado**
Tarja	*[sem dados cadastrados]*
Medicamento referência	**Não**
Apresentação fracionada	**Não**

Apresentação INATIVA	**Forma Farmacêutica**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**

SOL INJ CX 200 AMP POLIET X 10 ML	SOLUÇAO INJETAVEL	22	31/01/2005
Validade	24 meses	**Registro**	1177200240226
Princípio Ativo	ÁGUA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO		
Complemento Diferencial da Apresentação	*[sem dados cadastrados]*		
Embalagem	*[sem dados cadastrados]*		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais *[sem dados cadastrados]* Fabricantes Internacionais *[sem dados cadastrados]*		
Via de Administração	PARENTERAL(INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEA)		
IFA único	Sim		
Conservação	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (AMBIENTE COM TEMPERATURA ENTRE 15 E 30°C) PROTEGER DA LUZ E UMIDADE		
Restrição de prescrição	Venda sob Prescrição Médica		
Restrição de uso	*[sem dados cadastrados]*		
Destinação	Comercial		
Restrito a hospitais	**Não Informado**		
Tarja	*[sem dados cadastrados]*		
Medicamento referência	**Não**		
Apresentação fracionada	**Não**		

Voltar

60

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ANDRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA - M.E.		
CNPJ	06.150.367/0001-78	**Autorização**	8.08.993-8
Produto	VALVULA PARA GASES MEDICINAIS		

Modelo Produto Médico
VÁLVULAS BI PARA AR COMPRIMIDO ANDRAMED
VÁLVULAS BI PARA OXIGÊNIO ANDRAMED
VÁLVULAS BI PARA VÁCUO ANDRAMED
VÁLVULAS BI PARA ÓXIDO NITROSO ANDRAMED

Nome Técnico	Valvula Para Gases Medicinais
Registro	80899380005
Processo	25351.421602/2013-10
Origem do Produto	• FABRICANTE: ANDRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA - M.E. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	**Autorização**	1.03.694-6
Produto	TIRAS PARA URIANÁLISE DFI		

Apresentação/Modelo
TIRAS PARA URIANÁLISE DFI - DUS 10 - FRASCO COM 100 TIRAS - DUS 10 - Tiras reagente para a determinação rápida de Urobilinogênio, Glicose, Bilirrubina, Cetonas (Ácido Acetoacético), Densidade Específica, Sangue, pH, Proteínas, Nitrito, Leucócitos.
TIRAS PARA URIANÁLISE DFI - DUS 10M - FRASCO COM 100 TIRAS - DUS 10M Tiras reagente para a determinação rápida de Urobilinogênio, Glicose, Bilirrubina, Cetonas (Ácido Acetoacético), Densidade Específica, Sangue, pH, Proteínas, Nitrito, Leucócitos e Área Controle (Compensação).
TIRAS PARA URIANÁLISE DFI - DUS 10 - FRASCO COM 150 TIRAS - DUS 10 - Tiras reagente para a determinação rápida de Urobilinogênio, Glicose, Bilirrubina, Cetonas (Ácido Acetoacético), Densidade Específica, Sangue, pH, Proteínas, Nitrito, Leucócitos.
TIRAS PARA URIANÁLISE DFI - DUS 10M - FRASCO COM 150 TIRAS - DUS 10M Tiras reagente para a determinação rápida de Urobilinogênio, Glicose, Bilirrubina, Cetonas (Ácido Acetoacético), Densidade Específica, Sangue, pH, Proteínas, Nitrito, Leucócitos e Área Controle (Compensação).

Nome Técnico	FITA-TESTE PARA URINA
Registro	10369460110
Processo	25351.565721/2014-49
Origem do Produto	• FABRICANTE: DFI, CO., LTD - COREIA DO SUL
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
CNPJ	58.268.152/0001-50	**Autorização**	1.03.048-5
Produto	INSTRUMENTAL CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE		

Modelo Produto Médico

AGULHA REVERDIN Nº.1 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.2 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.3 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.4 23CM; ALICATE AINSWORTH; ALICATE BERNARDINHO 30CM T/C; ALICATE BERNARDINHO 47CM T/C; ALICATE BERNARDÃO 55CM T/C; ALICATE BETHUNE 34CM; ALICATE CORTA PINO INTERCAMBEÁVEL 57,5CM; ALICATE CORTA FIO 14CM ATÉ 0,8MM T/C; ALICATE CORTE DISTAL 154; ALICATE CORTE DISTAL T/C; ALICATE P/ CORTE CINTA DE ESTERNO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO T/C; ALICATE CORTE FRONTAL T/C; ALICATE CORTE FRONTAL 16CM; ALICATE CORTE LATERAL P/ OSSO; ALICATE CORTE LATERAL 12CM; ALICATE DUPLA FORÇA 15CM; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM; ALICATE Nº.141; ALICATE DUPLA FORÇA 18CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 25CM T/C; ALICATE P/ CORTE DE ANEL; ALICATE REIL T/C; ALICATE RUSKIN; ALICATE SEGURA E CORTA 16CM T/C; ALICATE SEGURA E CORTA 20CM T/C; ALICATE STEIMAN 30CM T/C; ALICATE STEIMAN 45CM T/C; ALICATE STEIMAN 60CM T/C; ALICATE TURQUESA CORTADOR T/C; ALICATE UNIVERSAL P/ GIRAR FIO C/ CORTE; ALICATE UNIVERSAL ORTODONTIA; AMIGDALOTOMO SLUDER BALENGER 3 FACAS; CIZALHA BEYER P/OSSO; CIZALHA LISTON RETA; CIZALHA LISTON CURVA;CIZALHA LISTON RETA 14CM; CIZALHA LISTON CURVA 14CM; CIZALHA LISTON RETA 17CM; CIZALHA LISTON CURVA 17CM; CIZALHA LISTON RETA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 19CM; CIZALHA LISTON ANGULADA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON MINI RETA 15CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA LISTON-KEY 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON-KEY 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LUER GOIVA CURVA; CIZALHA LUER GOIVA RETA;CIZALHA LUER GOIVA CURVA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA CURVA 17CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 17CM; CIZALHA MINI LISTON ANGULADA 15CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.CURVA 18CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.RETA 18CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM T/C; CIZALHA CURVA 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM;CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C;CIZALHA SEMB 23CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 23CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA SEUTIN 21CM; CIZALHA SEUTIN 23CM; CIZALHA STILLE 18CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 20CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA STILLE 26CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 37CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 26CM; CIZALHA STILLE 37CM;CIZALHA STILLE LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA

PINÇA CHEVALIER JACKSON TIPO JACARÉ 40CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON TIPO JACARÉ 50CM; PINÇA CITELLI; PINÇA DUCK BILL GOIVA; PINÇA DUCK BILL 3MM; PINÇA DUCK BILL 8MM;PINÇA CITELLI CAVIDADE 14CM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 1,5MM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 2,5MM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 4,0MM;PINÇA CITELLI SACA-BOCADO 20CM; PINÇA CLOWARD HAPPER ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA CLOWARD HAPPER ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA CLOWARD HAPPER RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA CLOWARD HAPPER RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE COM CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE SEM CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF VAN-BUREN; PINÇA FAURE; PINÇA FAURE 21CM; PINÇA FAURE 24CM; PINÇA FERGUSSON; PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P/ CIMA, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P/ BAIXO, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA 40°, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA P/ CIMA, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA P/ BAIXO, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA 40°,PINÇA BIOPSIA GAYLOR 24CM; PINÇA BIOPSIA GELLHORN 24CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1,0MM RETA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA CIMA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM RETA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA ANGULADA DUPLA ARTICULAÇÃO, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA CURVA PARA ESQUERDA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA CURVA PARA DIREITA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA ANGULADA 45°, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA RETA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 7MM X 2MM, ABERTURA PARA CIMA, COMPRIMENTO 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA INDIRETA CONCHA RETANGULAR DE 5MM CURVA PARA BAIXO 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA ESQUERDA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA CIMA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM, CURAVA PARA BAIXO 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM, CURVA PARA DIREITA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA PARA ESQUERDA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA DIREITA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA PARA CIMA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR GIRATÓRIA 360° 5MM X 1MM DE 25CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 2,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 4,8MM. 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA CONCHA OVAL LONGA 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2MM, DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO DELICADA 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 2,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 4,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°,

Nº1; PINÇA HARTMANN COM DENTE Nº2; PINÇA HARTMANN COM DENTE Nº3;PINÇA HARTMANN COM DENTE Nº4; PINÇA HARTMANN HOFFMANN Nº1; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 5MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 7MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 9MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 11MM; PINÇA HARTMANN SACABOCADO Nº1; PINÇA HARTMANN SACABOCADO Nº2; PINÇA HARTMANN SACABOCADO Nº3; PINÇA HARTMANN SACABOCADO Nº4; PINÇA HARTMANN SACABOCADO Nº5; PINÇA HEISS CARDIO; PINÇA HOUSE-DIETER BOCA P/ BAIXO; PINÇA HOUSE-DIETER BOCA P/ CIMA; PINÇA JANSEN RETA; PINÇA JANSEN CURVA, PINÇA JURASZ P/ DIREITA 19CM; PINÇA JURASZ P/ ESQUERDA 19CM; PINÇA JURASZ P/ CIMA 19CM; PINÇA JURASZ P/ BAIXO 19CM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 6MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 2MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 3MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130

LOVE-GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 4X10MM; PINÇA LUC CORTANTE NASAL; PINÇA LUER GOIVA CURVA 16CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 16CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 17CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 17CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 18CM SIMPLES;PINÇA LUER GOIVA RETA 18CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 20CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 20CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA LUER GOIVA CURVA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA MATHIEU 20CM; PINÇA MATHIEU 25CM; PINÇA MATHIEU 28CM; PINÇA MARTEL; PINÇA OLDBERG BOCA REDONDA; PINÇA OLIVECRONA 20CM; PINÇA P/ BIOPSIA WITTNER RETA 21CM; PINÇA P/ BIOPSIA WITTNER CURVA 21CM; PINÇA P/ BIOPSIA SCHULZ FLEXIVEL 3X510MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 1MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 2MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 3MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 4MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 5MM;PINÇA ROWE DIREITA; PINÇA ROWE ESQUERDA; PINÇA GOIVA RUSKIN RETA 23CM; PINÇA GOIVA RUSKIN CURVA 23CM; PINÇA RUSKIN DUPLA ARTICULAÇÃO RETA; PINÇA RUSKIN DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM 3MM; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM 5MM; PINÇA SACA-CALCIO P/CIMA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO P/DIREITA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO P/ESQUERDA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO RETA 20CM; PINÇA SCHUBERT P/ BIOPSIA 23,5CM ANGULADA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 21CM RETA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 23,5CM RETA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 29CM RETA; PINÇA SCHUBERT; PINÇA SCHUMACHER; PINÇA SEMB; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 18CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 18CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 18CM; PINÇA STILE-LISTON 23CM CURVA; PINÇA STILE-LISTON 23CM RETA; PINÇA STILLE-LISTON 27CM CURVA; PINÇA STILLE-LISTON 27CM RETA; PINÇA STILLE LUER 23CM ANGULADA; PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 27CM; PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 27CM; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°1; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°2; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°3; PINÇA STRUYCKEN ANGULADA; PINÇA STRUYCKEN INFANTIL ANGULADA; PINÇA STRUYCKEN INFANTIL RETA; PINÇA STRUYCKEN RETA; PINÇA TAKAHASHI BOCA RETA; PINÇA TAKAHASHI BOCA P/ CIMA; PINÇA TAKAHASHI DELICADA 12CM; PINÇA TAKAHASHI DELICADA 19CM; PINÇA THOMAS-GAYLOR; PINÇA VAN DOREN 24CM BIOPSIA; PINÇA WATSON-WILLIAN NASAL COM SERRILHA; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°6; PINÇA YEOMAN 28CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 28CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 35CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 35CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 20CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 20CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 25CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 25CM BOCA ARREDONDADA; PORTA AGULHA CRILE WOOD 15CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA GILLIES 16CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA OLSEN HEGAR 14CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA OLSEN HEGAR 16CM T/C;

DANDY 20CM; TESOURA DANDY TRIGEMINAL; TESOURA DEAN SERRILHADA; TESOURA DEAN SEM SERRILHA; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 25GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 40GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 45 GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 60GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM EM "S"; TESOURA DE RYTHIDO; TESOURA DIETRICH 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH COM GUIA 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 25GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 25GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 45GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 45GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 60GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 60GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 90GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 90GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 125GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 125GRAUS; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 25° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 25° 18CM T/C;TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 45° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 45° 18CM T/C;TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 60° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 60° 18CM T/C;TESOURA ENTERÓTOMO; TESOURA ESMARCH 17CM; TESOURA ESMARCH 20CM;TESOURA FAVALORO 18CM 130 GRAUS;TESOURA FAVAROLO 18CM; TESOURA P/ FIO DE ACO 11CM; TESOURA P/ FIO DE ACO 11CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 11CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 11CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 12CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 12CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 15CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 15CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 18CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 18CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 20CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 20CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 25CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 25CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 30CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 30CM T/C; TESOURA FOMON DORSAL ANGULAR; TESOURA FOMON DORSAL ANGULAR T/C; TESOURA FOMON ANGULADA 15CM; TESOURA FRAZIER 18CM;TESOURA FREEMAN; TESOURA FREEMAN CURVA 14CM; TESOURA FREEMAN CURVA 18CM; TESOURA FREEMAN CURVA 23CM; TESOURA FREEMAN RETA 14CM; TESOURA FREEMAN RETA 18CM; TESOURA FREEMAN RETA 23CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 15CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 20CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 23CM; TESOURA GOLDMAN FOX; TESOURA GOLDMAN FOX T/C; TESOURA GOLDMAN FOX RETA; TESOURA GOLDMAN FOX RETA T/C;TESOURA GOLDMAN FOX CURVA; TESOURA GOLDMAN FOX CURVA T/C; TESOURA HEYMAN DELICADA 10CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 13CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 16CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 19CM; TESOURA HEYMANN 10CM; TESOURA HEYMANN ANGULADA COM SERRILHA; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 8CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 8CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA CANHOTO; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA DELICADA; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA CANHOTO T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA CANHOTO; TESOURA IRIS 11,5CM RETA DELICADA; TESOURA IRIS 11,5CM RETA CANHOTO T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA DELICADA T/C; TESOURA IRIS C/FACETA CURVA FINA; TESOURA IRIS C/FACETA CURVA FINA T/C; TESOURA IRIS C/FACETA RETA FINA; TESOURA IRIS C/FACETA RETA FINA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA; TESOURA IRIS 11,5CM RETA T/C; TESOURA IRIS ANGULADA 11,5CM; TESOURA IRIS ANGULADA 14CM; TESOURA IRIS ANGULADA 16CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA CURVA 11CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA CURVA 14CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA RETA 11CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA RETA 14CM; TESOURA IRIS ROMBA CURVA 11,5CM; TESOURA IRIS ROMBA RETA 11,5CM; TESOURA JACOBSON CURVA 16CM;TESOURA JACOBSON RETA 16CM; TESOURA JACOBSON RETA 18CM; TESOURA JACOBSON 18CM CURVA; TESOURA JOSEPH 14CM RETA; TESOURA JOSEPH 14CM CURVA; TESOURA JOSEPH CURVA T/C 15CM; TESOURA JOSEPH RETA T/C 15CM; TESOURA KHAN CURVA COM SERRILHA 14CM; TESOURA KHAN RETA COM SERRILHA 14CM; TESOURA KEYE FREEMAN CURVA 14CM; TESOURA KEYE FREEMAN CURVA 18CM; TESOURA KILLIAN P/ SEPTO 20CM; TESOURA KILNER ; TESOURA KILNER 14CM; TESOURA DE LISTER 14CM; TESOURA DE LISTER 17CM; TESOURA DE LISTER 19CM;TESOURA KNIGHT; TESOURA LAGRANGE; TESOURA LAGRANGE T/C;TESOURA LEXER CURVA DELGADA 165MM T/C; TESOURA LEXER BABY 10CM CURVA; TESOURA LEXER BABY 10CM CURVA T/C; TESOURA LEXER BABY 10CM RETA; TESOURA LEXER BABY 10CM RETA T/C;TESOURA LITTAUER 13,5CM; TESOURA LOCKLIN 16CM; TESOURA MALIS 18CM CURVA;TESOURA MAYO 15CM RETA; TESOURA MAYO 15CM CURVA;TESOURA MAYO 17CM RETA; TESOURA MAYO 17CM CURVA; TESOURA MAYO 23CM RETA; TESOURA MAYO 23CM CURVA;TESOURA MAYO NOBLE 17CM CURVA;TESOURA MAYO NOBLE 17CM RETA; TESOURA MAYO NOBLE 17CM CURVA T/C; TESOURA MAYO NOBLE 17CM RETA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA COM SERRILHA; TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA;TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA C/

METZENBAUM-NELSON 28CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM RETA;TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM RETA T/C;TESOURA NELSON 24CM CURVA;TESOURA NELSON 24CM RETA;TESOURA NOYES 12CM FINA/FINA RETA;TESOURA NOYES 12CM ROMBA/FINA RETA;TESOURA NOYES 12CM ROMBA/ROMBA RETA;TESOURA NOYES IRIS RETA 12CM ;TESOURA NOYES IRIS CURVA 12CM; TESOURA OLIVECRONA; TESOURA PARA OURO RETA 10CM; TESOURA PARA OURO CURVA 10CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 14CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 18CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 14CM T/C; TESOURA COROA E OURO CURVA 18CM T/C; TESOURA COROA E OURO CURVA T/C; TESOURA COROA E OURO RETA 14CM; TESOURA COROA E OURO RETA 18CM; TESOURA COROA E OURO RETA 14CM T/C;TESOURA COROA E OURO RETA 18CM T/C; TESOURA COROA E OURO RETA T/C; TESOURA P/ BANDAGEM GROSSA;TESOURA PARA CORDÃO UMBILICAL;TESOURA P/ENUCLEACAO 14CM; TESOURA P/ENUCLEACAO 16CM;TESOURA P/ESTRABISMO CURVA;TESOURA P/ESTRABISMO RETA;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 145MM T/C;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 180MM T/C;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 230MM T/C;TESOURA P/ RUGAS 14CM;TESOURA P/ RUGAS 20CM;TESOURA P/ RUGAS 24CM; TESOURA PARAMETRIAL 23CM CURVA;TESOURA PARAMETRIAL 26CM CURVA; TESOURA PARAMETRIAL 30CM CURVA;TESOURA PARAMETRIAL 35CM CURVA; TESOURA PARAMETRIAL 23CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 26CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 30CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 35CM CURVA T/C; TESOURA P/ TUBOS SERRILHADA 20 CM; TESOURA PELICANO 17CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 25° 19CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 40° 19CM TESOURA POTTS DE MARTEL 60° 19CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 25° 19CM T/C; TESOURA POTTS DE MARTEL 40° 19CM T/C; TESOURA POTTS DE MARTEL 60° 19CM T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 25°; TESOURA POTTS SMITH 19CM 25°T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 30°; TESOURA POTTS SMITH 19CM 30°T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 40°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 40°T/C; TESOURA POTTS SMITH 45°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 60°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 60°T/C;TESOURA POTTS SMITH 25° CURVA T/C; TESOURA POTTS SMITH 45° CURVA T/C;TESOURA POTTS SMITH 60° CURVA T/C;TESOURA POTTS-YASARGIL 18CM DIREITA;TESOURA POTTS-YASARGIL 18CM ESQUERDA; TESOURA POTTS-YASARGIL 20CM DIREITA;TESOURA POTTS-YASARGIL 20CM ESQUERDA; TESOURA REYNOLDS CURVA 12CM; TESOURA REYNOLDS CURVA 15CM; TESOURA REYNOLDS CURVA 18CM; TESOURA REYNOLDS RETA 12CM; TESOURA REYNOLDS RETA 15CM; TESOURA REYNOLDS RETA 18CM; TESOURA REES P/ RUGAS 20CM;TESOURA REES P/ RUGAS 24CM;TESOURA SATINSKY 18CM CURVA; TESOURA SATINSKY 20CM CURVA;TESOURA SCHMIEDEN-TAYLOR; TESOURA SERRILHADA 15CM; TESOURA SCHUMACHER; TESOURA SIMS RETA; TESOURA SIMS CURVA; TESOURA SIMS 8CM CURVA;TESOURA SMITH; TESOURA SMITH 23CM;TESOURA SNOLDEN SERRILHADA CURVA 15CM; TESOURA SNOLDEN SERRILHADA RETA 15CM;TESOURA SNOLDEN SERRILHADA CURVA 17CM; TESOURA SNOLDEN SERRILHADA RETA 17CM;TESOURA SPENCER 9CM; TESOURA SPENCER 12CM; TESOURA SPENCER 14CM; TESOURA SPENCER CURVA 11CM; TESOURA SPENCER CURVA 14CM; TESOURA SPENCER T/C 11CM; TESOURA SPENCER T/C 14CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 14CM; TESOURA STEVENS CURVA; TESOURA STEVENS RETA;TESOURA STEVENS 11,5CM CURVA;TESOURA STEVENS 11,5CM RETA;TESOURA STRULLY RETA 18CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 18CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 18CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 18CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY RETA 20CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 20CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 20CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 20CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY RETA 22CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 22CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 22CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 22CM PONTA ROMBA;TESOURA THOREK 19CM;TESOURA TROUTMAN CASTROVIEJO DIREITA;TESOURA TROUTMAN CASTROVIEJO ESQUERDA; TESOURA UNIVERSAL P/ FIO T/C; TESOURA UNIVERSAL T/C 11CM; TESOURA UNIVERSAL; TESOURA VANNAS CURVA; TESOURA VANNAS RETA;TESOURA KLINKENBERGH-LOTH 23CM; TESOURA ZURICH RETA 13CM ;TESOURA WECKER 11CM; TESOURA WESTCOTT CURVA; TESOURA WESTCOTT RETA;

Consultas / Medicamentos / Medicamentos 54 classe

Detalhe do Produto: SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO

Nome da Empresa Detentora do Registro	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	**CNPJ**	55.972.087/0001-50	**Autorização**	1.00.491-5
Processo	25001.006192/81	**Categoria Regulatória**		**Data do registro**	12/07/1999
Nome do Produto	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO	**Registro**	104910061	**Vencimento do registro**	12/06/2021
Princípio Ativo	CLORETO DE CÁLCIO 2H2O, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, LACTATO DE SÓDIO, cloreto de cálcio diidratado			**Medicamento de referência**	-
Classe Terapêutica	REPOSICAO HIDROELETROLITICA E ALIMENTACAO PARENTERAL			**ATC**	
Parecer Público	-	**Bula Paciente**	-	**Bula Profissional**	-

Expandir Todas

Nº	Apresentação	Registro	Forma Farmacêutica	Data de Publicação	Validade
1	SOL INFUS IV CX 30 FR PLAS TRANS X 250 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610011	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
2	SOL INFUS IV CX 20 FR PLAS TRANS X 500 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610021	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
3	SOL INFUS IV CX 50 FR PLAS TRANS X 100 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610038	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses

4	SOL INFUS IV CX 50 FR PLAS TRANS X 125 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610046	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
5	SOL INFUS IV CX 10 FR PLAS TRANS X 1000 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610054	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
6	SOL INJ CX 72 BOLS PVC X 50 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610062	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
7	SOL INFUS IV CX 60 BOLS PVC X 100 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610070	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
8	SOL INFUS IV CX 30 BOLS PVC X 250 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610089	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
9	SOL INFUS IV CX 20 BOLS PVC X 500 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610097	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
10	SOL INFUS IV CX 10 BOLS PVC X 1000 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610100	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
11	SOL INJ CX 72 FR PLAS TRANS X 50 ML (EMB HOSP) CANCELADA OU CADUCA	1049100610119	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
12	SOL INFUS IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML ATIVA	1049100610127	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
13	SOL INFUS IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML ATIVA	1049100610135	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
14	SOL INFUS IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML ATIVA	1049100610143	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
15	SOL INFUS IV CX 30 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML CANCELADA OU CADUCA	1049100610151	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses

001318

16	SOL INFUS IV CX 40 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML ATIVA	1049100610161	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
17	SOL INFUS IV CX 20 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML CANCELADA OU CADUCA	1049100610178	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
18	SOL INFUS IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML ATIVA	1049100610186	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses
19	SOL INFUS IV CX 12 FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML ATIVA	1049100610194	SOLUÇAO INJETAVEL	12/07/1999	24 meses

Voltar

VW

ITENS 50 E 52 Para conferência

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
CNPJ	58.268.152/0001-50	**Autorização**	1.03.048-5
Produto	Família de Instrumental Cirúrgico Articulado não Cortante		

Modelo Produto Médico

ABRIDOR DE BOCA DENHARDT; ABRIDOR DE BOCA HEISTER 13CM CURVO; ABRIDOR DE BOCA HEISTER 13CM RETO; ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 11CM; ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 13CM; ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 15CM; ABRIDOR DE BOCA MC.IVOR SEM SUCÇÃO 3 LÂMINAS; ABRIDOR DE BOCA MOLT 10CM INFANTIL; ABRIDOR DE BOCA MOLT 14CM ADULTO; ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 11CM; ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 13CM; ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 15CM; AFASTADOR A PITANGA Nº. 1; AFASTADOR A PITANGA Nº. 2; AFASTADOR A PITANGA Nº. 3; AFASTADOR ADSON 32CM; AFASTADOR ADSON AGUDO 20CM; AFASTADOR ADSON AGUDO 32CM; AFASTADOR ADSON BABY AGUDO 16CM; AFASTADOR ADSON BABY ARTICULADO 16CM ; AFASTADOR ADSON BABY ARTICULADO 17CM; AFASTADOR ADSON BABY ROMBO 16CM; AFASTADOR ADSON ROMBO 20CM; AFASTADOR ADSON ROMBO 32CM; AFASTADOR ALM 4X4 AGUDO; AFASTADOR ALM BAIONETA; AFASTADOR ANDERSON-ADSON CURVO 19CM; AFASTADOR ANKENEY ADULTO GRANDE; AFASTADOR ANKENEY ADULTO MÉDIO; AFASTADOR ANKENEY ADULTO PEQUENO; AFASTADOR ANKENEY INFANTIL; AFASTADOR APFELBAUM; AFASTADOR ATM; AFASTADOR BAUFOUR ABDOMINAL COM VÁLVULA CURVA 45X80; AFASTADOR BAUFOUR ABDOMINAL COM VÁLVULA RETA 70X100; AFASTADOR BAUFOUR BABY ABDOMINAL COM VÁLVULA CURVA 20X25; AFASTADOR BECKMAN 30CM COLUNA/PULMAO/TORAX; AFASTADOR BECKMAN EATON 32CM; AFASTADOR BECKMAN-ADSON 32CM AGUDO; AFASTADOR BECKMAN-ADSON 32CM ROMBO; AFASTADOR BECKMAN-ADSON 4X4 31CM; AFASTADOR BECKMANN 4 DENTES AGUDO; AFASTADOR BECKMANN 4 DENTES ROMBO; AFASTADOR BECKMANN 5 DENTES AGUDO; AFASTADOR BECKMANN 5 DENTES ROMBO; AFASTADOR BECKMANN 7 DENTES AGUDO; AFASTADOR BECKMANN 7 DENTES ROMBO; AFASTADOR BENSAUDE ADULTO 22X70MM; AFASTADOR BENSAUDE INFANTIL 16X70MM; AFASTADOR BLEFAROSTATO DE COOK 4CM; AFASTADOR BLEFAROSTATO DE COOK 5CM; AFASTADOR BLEFAROSTATO DE PARK 8CM; AFASTADOR BLEFAROSTATO GUYTON PARK; AFASTADOR BLEFAROSTATO LANCASTER; AFASTADOR BLEFAROSTATO MELLINGER; AFASTADOR BLEFAROSTATO MURDOCK; AFASTADOR BURFORD ESPATULAS MOVEIS; AFASTADOR CASPAR CERVICAL LONGITUDINAL; AFASTADOR CASPAR CERVICAL TRANSVERSAL; AFASTADOR CASPAR DE CORPO VERTEBRAL; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 45MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 50MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 55MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 60MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 65MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR UNIVERSAL; AFASTADOR CASPAR; AFASTADOR CASTROVIEJO 8CM; AFASTADOR CERVICAL LONGITUDINAL COM LÂMINAS; AFASTADOR CERVICAL TRANSVERSAL COM LÂMINAS; AFASTADOR CLOWARD 23CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD 23CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD 25CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD 25CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD INTERVERTEBRAL; AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 23CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 23CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 25CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 25CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD P/ VERTEBRA C/ CREMALHEIRA; AFASTADOR COLLIN 3 VALVULAS 22CM; AFASTADOR COLLIN 3 VALVULAS Nº1; AFASTADOR COLLIN 3 VALVULAS Nº2; AFASTADOR CONTOUR 4X3 DENTES ROMBOS CURVO 14CM; AFASTADOR CONTRATOR BAILEY BABY; AFASTADOR CONTRATOR BAILEY; AFASTADOR CUSHING LANDOLT 110MM/ 70MM/ 90MM; AFASTADOR DINKHUYSEN MITRAL; AFASTADOR DINKHUYSEN P/ MAMÁRIA E

ADERER TRIDENT N.200; ALICATE ANGLE N.139; ALICATE BICO CHATO; ALICATE BOCA SERRILHADA 17CM; ALICATE BOCA SERRILHADA 19CM; ALICATE BOCA SERRILHADA PONTA FINA 2MM 19CM; ALICATE CONFORMADOR; ALICATE DE PRESSAO AÇO INOX 18CM; ALICATE DE PRESSAO AÇO INOX 20CM; ALICATE DE PRESSAO AÇO INOX 25CM; ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 22CM; ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 25CM; ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 30CM; ALICATE DE PRESSÃO MÃO DE NOIVA; ALICATE DOBRA EM V; ALICATE DOBRA EM Z; ALICATE DUPLA ARTICULAÇÃO 20CM; ALICATE DUPLA FORÇA BOCA SERRILHADA 17CM; ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 2MM; ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 3MM; ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 5MM; ALICATE FORMADOR DE AMARRILHO; ALICATE GOSLEE N.121; ALICATE HAMMERHEAD; ALICATE HOLLOW CHOP; ALICATE HOW N.110; ALICATE HOW N.111; ALICATE JARABAK; ALICATE JONHSON N.114; ALICATE MC KELLOPS N.128; ALICATE MEIA CANA; ALICATE N.1001; ALICATE N.201 TRIDENT LONGO; ALICATE N.210 WEINGART T/C; ALICATE N.210 WEINGART; ALICATE N.346 REMOVEDOR DE BRACKETS CURVO; ALICATE N.346 REMOVEDOR DE BRACKETS RETO; ALICATE N.442 PONTA CURVA; ALICATE N.442 PONTA LONGA; ALICATE NANCE N.1; ALICATE OMEGA LOOP; ALICATE ORTODONTIA N.03 PEAK; ALICATE ORTODONTIA N.04 PEAK; ALICATE ORTODONTIA N.104; ALICATE ORTODONTIA N.107; ALICATE ORTODONTIA N.109 DE LA ROSA; ALICATE ORTODONTIA N.115 REYNOLD BICO DE PAPAGAIO; ALICATE ORTODONTIA N.118; ALICATE ORTODONTIA N.120; ALICATE ORTODONTIA N.137; ALICATE ORTODONTIA N.155; ALICATE ORTODONTIA N.156; ALICATE ORTODONTIA N.157; ALICATE ORTODONTIA N.345; ALICATE ORTODONTIA N.347 LONGO; ALICATE ORTODONTIA N.347; ALICATE ORTODONTIA N.350 TWEED; ALICATE ORTODONTIA N.351; ALICATE ORTODONTIA N.442 ANGLE; ALICATE ORTODONTIA N.94 ADAMS; ALICATE P/ ARCO LINGUAL; ALICATE P/ BANDA INFERIOR; ALICATE P/ BANDA SUPERIOR; ALICATE P/ BARRA PALATINA T/C; ALICATE P/ BARRA PALATINA; ALICATE PARA PUXAR FIO PONTA FINA 14CM; ALICATE PARA PUXAR FIOS 17CM; ALICATE PARA PUXAR FIOS BICO CHATO 17CM; ALICATE PARA REBITAR MATRIZ N.141; ALICATE PLANO PARALELO 18CM; ALICATE SACA RESINA COM PONTA REAJUSTÁVEL; ALICATE SACA RESINA; ALICATE SCHWARZ N.53; ALICATE UNIVERSAL N.325; ALICATE UNIVERSAL ORTOPEDIA; ALICATE YONG N.74; APROXIMADOR CONTRATOR BAILEY; APROXIMADOR CONTRATOR BAILEY-BABY; APROXIMADOR GERSTER; APROXIMADOR LEMMON; APROXIMADOR SELLORS 20CM P/ COSTELA; BLEFAROSTATO MELLINGER 5CM INFANTIL; BLEFAROSTATO MELLINGER 7CM ADULTO; BOTICÃO FÓRCEPS 22 PAPAGAIO; BOTICÃO FÓRCEPS 33 PAPAGAIO; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 1; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 101; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 103; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 10H; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 10S; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 121; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 15; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 150; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 151; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 16; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 17; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 18L CABO RETO; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 18L; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 18R CABO RETO; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 18R; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 203; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 210; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 210H; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 210S; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 213; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 22; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 222; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 23; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 24; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 27; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 286; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 32; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 32A; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 33; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 44; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 53L; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 53R; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 62; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 65; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 68; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 69; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 76; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 88L; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 88R; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 99A; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 99C; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 1; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 101; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 106; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 150-S; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 151-S; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 16; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 16-S; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 17; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 18D; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 18L; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 18R; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 201; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 21; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 23-S; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 27; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 44; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 46; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 65; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 68; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 69; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 01; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 02; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 03; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 04; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 05; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 06; BOTICAO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 150-S; BOTICAO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 18-D; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 21; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 27; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 44; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 46; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 65; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 68; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 69;

PONTA 180 GRAUS LONGA; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 45 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA CURVA; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA PEDÍCULO LONGO; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA RETA; PINÇA COOLEY CABO RETO PEDÍCULO CURTO; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 15 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 180 GRAUS CURTA; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 180 GRAUS LONGA; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 30 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 45 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA CURVA; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA PEDÍCULO LONGO; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA RETA; PINÇA COOLEY CURVO PONTA 30 GRAUS; PINÇA COSGROVE; PINÇA COTTLE WALSHAM DIREITA 23CM; PINÇA COTTLE WALSHAM ESQUERDA 23CM; PINÇA COTTLE WALSHAM RETA 23CM; PINÇA CRAFOORD 18CM; PINÇA CRAFOORD 24CM CURVA; PINÇA CRAFOORD 24CM RETA; PINÇA CRILE 14CM CURVA DELICADA; PINÇA CRILE 14CM CURVA; PINÇA CRILE 14CM RETA DELICADA; PINÇA CRILE 14CM RETA; PINÇA CRILE 16CM CURVA DELICADA; PINÇA CRILE 16CM CURVA; PINÇA CRILE 16CM RETA DELICADA; PINÇA CRILE 16CM RETA; PINÇA CRILE 18CM CURVA DELICADA; PINÇA CRILE 18CM CURVA; PINÇA CRILE 18CM RETA DELICADA; PINÇA CRILE 18CM RETA; PINÇA CRILE 20CM CURVA DELICADA; PINÇA CRILE 20CM CURVA; PINÇA CRILE 20CM RETA DELICADA; PINÇA CRILE 20CM RETA; PINÇA CRILE-RANKIN 16CM CURVA 1X2 DENTES; PINÇA CRILE-RANKIN 16CM CURVA; PINÇA CRILE-RANKIN 16CM RETA 1X2 DENTES; PINÇA CRILE-RANKIN 16CM RETA; PINÇA DANDY C/ DENTE; PINÇA DANDY; PINCA DARTIGUES 24CM; PINÇA DARTIGUES 26CM; PINÇA DARTIGUES 27CM; PINÇA DARTIGUES; PINÇA DE APREENSÃO P/ VASECTOMIA PONTA CRUZADA; PINÇA DE APREENSÃO P/ VASECTOMIA PONTA ENCAIXE; PINÇA DE BAKEY 11CM CURVA; PINÇA DE BAKEY 12CM ANGULADA; PINÇA DE BAKEY 12CM CURVA "S" PONTA ATIVA 4,5CM; PINÇA DE BAKEY 12CM RETA PONTA ATIVA 4,5CM; PINÇA DE BAKEY 13CM ANGULADA 45°; PINÇA DE BAKEY 17CM ANGULADA NO CABO; PINÇA DE BAKEY 18CM ANGULADA 60°; PINÇA DE BAKEY 18CM ANGULADA 90° PONTA ATIVA 5CM; PINÇA DE BAKEY 18CM ANGULADA 90° PONTA ATIVA 6,5CM; PINÇA DE BAKEY 18CM EM FORMA "S"; PINÇA DE BAKEY 19CM; PINÇA DE BAKEY 20CM ANGULADA 45° PONTA ATIVA 5,5CM; PINÇA DE BAKEY 20CM EM FORMA "S"; PINÇA DE BAKEY 21CM ANGULADA 45° PONTA ATIVA 7CM; PINÇA DE BAKEY 21CM CURVA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 21CM RETA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 23CM ANGULADA 90° PONTA ATIVA 8CM; PINÇA DE BAKEY 23CM CURVA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 23CM RETA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 23CM; PINÇA DE BAKEY 25CM 60° P/ AORTA; PINÇA DE BAKEY 25CM ANGULADA 45° PONTA ATIVA 9CM; PINÇA DE BAKEY 26CM P/ ANEURISMA; PINÇA DE BAKEY 27CM CURVA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 27CM RETA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 27CM; PINÇA DE BAKEY 31CM CURVA; PINÇA DE BAKEY 31CM P/ ANEURISMA; PINÇA DE BAKEY 31CM RETA; PINÇA DE BAKEY 32CM 60° P/ AORTA; PINÇA DE BAKEY 33CM P/ ANEURISMA; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 20CM; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 21CM; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 25CM; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 27CM; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 29CM; PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 18CM; PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 19CM; PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 23CM; PINÇA DE BAKEY ANGULADA AORTA 60° 32CM C/ CREMALHEIRA LONGA; PINÇA DE BAKEY ANGULADA NO CABO 23CM P/ COARTAÇÃO; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 10CM CURVA 90GRAUS; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 11CM CURVA "S"; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 12CM CURVA "S"; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 12CM CURVA; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 12CM RETA; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 13CM CURVA "S"; PINÇA DE BAKEY CLAMP DE AORTA 25CM; PINÇA DE BAKEY CLAMP DE AORTA 29CM; PINÇA DE BAKEY CLAMP DE AORTA 32CM; PINÇA DE BAKEY CURVA AORTA 29CM; PINÇA DE BAKEY VASCULAR PERIFÉRICA ANGULADA 20CM; PINÇA DE BAKEY VASCULAR PERIFÉRICA CURVA 18,5CM; PINÇA DE DISSEC.E LIGADURA LAHEY (SWEET) 19CM; PINÇA DE DISSEC.E LIGADURA LAHEY (SWEET) 23CM; PINÇA DE DISSECCAO E LIGADURA ZENKER 30CM; PINÇA DE INSERÇÃO PLATÔ TIBIAL; PINÇA DE REMOÇÃO PLATÔ TIBIAL; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 13MM Nº 10 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 13MM Nº 10 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 13MM Nº 10 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 13MM Nº 10; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 23MM Nº 11 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 23MM Nº 11 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 23MM Nº 11 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 23MM Nº 11; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 25° 12,5CM Nº 2; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 45° 12,5CM Nº 3; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 60° 12,5CM Nº 4; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 90° 12,5CM Nº 5 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 90° 12,5CM Nº 5 - CABO ANGULADO; PINÇA

ESPANHOLA 20CM; PINÇA ESPANHOLA 22CM; PINÇA ESPANHOLA 24CM; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 18CM C/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 18CM S/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 22CM C/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 22CM S/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 26CM C/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 26CM S/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 28CM C/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 28CM S/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF ROTULA/OSSOS; PINÇA FARABEUF VAN BUREN 23CM; PINÇA FAURE 21CM CURVA ART.UTER; PINÇA FAURE 21CM RETA ART.UTER; PINÇA FAURE 22CM CURVA ART.UTER;. PINÇA FAURE 22CM RETA ART.UTER.; PINÇA FAURE; PINÇA FAUWEL P/LARINGE; PINÇA FINOCCHIETTO 24CM PARA VESICULA; PINÇA FOERSTER 16CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 16CM CURVA; PINÇA FOERSTER 16CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 16CM RETA; PINÇA FOERSTER 18CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 18CM CURVA; PINÇA FOERSTER 18CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 18CM RETA; PINÇA FOERSTER 20CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 20CM CURVA; PINÇA FOERSTER 20CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 20CM RETA; PINÇA FOERSTER 24CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 24CM CURVA; PINÇA FOERSTER 24CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 24CM RETA; PINÇA FOERSTER 35CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 35CM CURVA; PINÇA FOERSTER 35CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 35CM RETA; PINÇA FOERSTER BALLENGER 18CM CURVA; PINÇA FOERSTER BALLENGER 18CM RETA; PINÇA FOERSTER BALLENGER 24CM CURVA; PINÇA FOERSTER BALLENGER 24CM RETA; PINÇA FRAENKEL; PINÇA FRYKHOLM 23CM; PINÇA GELLHORN; PINÇA GEMINI 13CM CURVA; PINÇA GEMINI 13CM RETA; PINÇA GEMINI 16CM CURVA; PINÇA GEMINI 16CM RETA; PINÇA GEMINI 18CM CURVA; PINÇA GEMINI 18CM RETA; PINÇA GEMINI 20CM CURVA; PINÇA GEMINI 20CM RETA; PINÇA GEMINI 22CM CURVA; PINÇA GEMINI 22CM RETA; PINÇA GEMINI 23CM CURVA; PINÇA GEMINI 23CM RETA; PINÇA GEMINI 25CM CURVA; PINÇA GEMINI 25CM RETA; PINÇA GEMINI 28CM CURVA; PINÇA GEMINI 28CM RETA; PINÇA GLOVER 11CM CURVA; PINÇA GLOVER 11CM RETA; PINÇA GLOVER 6CM CURVA; PINÇA GLOVER 6CM RETA; PINÇA GLOVER 7CM CURVA; PINÇA GLOVER 7CM RETA; PINÇA GLOVER 9CM CURVA; PINÇA GLOVER 9CM RETA; PINÇA GLOVER BULLDOG 10CM CURVA; PINÇA GLOVER BULLDOG 10CM RETA; PINÇA GLOVER BULLDOG 12CM CURVA; PINÇA GLOVER BULLDOG 12CM RETA; PINÇA GLOVER BULLDOG 7CM CURVA; PINÇA GLOVER BULLDOG 7CM RETA; PINÇA GLOVER BULLDOG 8CM CURVA; PINÇA GLOVER BULLDOG 8CM RETA; PINÇA GLOVER DE BAKEY 17CM CURVA BOCA 5CM; PINÇA GLOVER DE BAKEY 17CM CURVA; PINÇA GRAY 22CM PEDICULO; PINÇA GRAY 24CM PEDICULO; PINÇA GRAY 26CM PEDICULO; PINÇA GUYON 16CM; PINÇA GUYON 20CM; PINÇA GUYON 22CM; PINÇA GUYON 24CM; PINÇA GUYON 26CM; PINÇA HALSTEAD MOSQ. MICRO 10CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQ. MICRO 10CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQ. MICRO 14CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQ. MICRO 14CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQ.12CM C/DENTE CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQ.12CM C/DENTE RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQ.MICRO 12CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQ.MICRO 12CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 18CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 18CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 21CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 21CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO PARA ELASTIC; PINÇA HALSTED MOSQUITO 14CM CURVA; PINÇA HALSTED MOSQUITO 14CM RETA; PINÇA HALSTED MOSQUITO 16CM CURVA; PINÇA HALSTED MOSQUITO 16CM RETA; PINÇA HARTMANN CLAMP INTESTINAL 20CM CURVA; PINÇA HARTMANN CLAMP INTESTINAL 20CM RETA; PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA CIMA; PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA ESQUERDA; PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA/ DIREITA; PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM RETA; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO 09CM COM DENTE; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM C/DENTE 25CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM DENTE 20CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 09CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 14CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 15CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 16,5CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 20CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 25CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 28CM; PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR 15CM; PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR 19CM; PINÇA HEANEY 20CM CURVA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 20CM CURVA 2 DENTES; PINÇA HEANEY 20CM RETA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 20CM; PINÇA HEANEY 24CM CURVA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 24CM CURVA 2 DENTES; PINÇA HEANEY 24CM RETA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 26CM; PINÇA HEANEY 35CM CURVA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 35CM CURVA 2 DENTES; PINÇA HEANEY 35CM RETA 1 DENTE; PINÇA HEANEY-BALLANTINE 21CM; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM ANGULADA; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM CURVA FORTE; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM CURVA LEVE; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM RETA; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM ANGULADA; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM CURVA FORTE;

MENKEN 24CM S/CREMALHEIRA; PINÇA MENKEN 27CM C/ CREMALHEIRA; PINÇA MENKEN 27CM S/CREMALHEIRA; PINÇA MENKEN OU KOGAN; PINÇA MICHEL PARA COLOCAR/RETIRAR AGRAFES; PINÇA MIKULICZ 20CM 1X2 DENTES; PINÇA MINI FRIEDMAN ANGULADA; PINÇA MINI FRIEDMAN DELICADA RETA; PINÇA MINI FRIEDMAN RETA; PINÇA MINI GEMINI 18CM; PINÇA MINI GEMINI 22CM; PINÇA MINI GEMINI 25CM; PINÇA MINI GEMINI 28CM; PINÇA MIXTER 17CM DELICADA; PINÇA MIXTER 17CM; PINÇA MIXTER 18CM DELICADA; PINÇA MIXTER 18CM; PINÇA MIXTER 20CM DELICADA; PINÇA MIXTER 20CM; PINÇA MIXTER 22CM DELICADA; PINÇA MIXTER 22CM; PINÇA MIXTER 24CM DELICADA; PINÇA MIXTER 24CM; PINÇA MIXTER 30CM DELICADA; PINÇA MIXTER 30CM; PINÇA MIXTER 35CM; PINÇA MIXTER BABY 14CM; PINÇA MIXTER BABY 16CM; PINÇA MIXTER BABY CURVA 19CM; PINÇA MIXTER BABY CURVA FORTE 14CM; PINÇA MIXTER CURVA 23CM; PINÇA MIXTER CURVA DELICADA 23CM; PINÇA MIXTER CURVA EXTRA DELICADA 23CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 12CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 14CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 17CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 20CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 23CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 24CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 25CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 27CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 28CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 30CM; PINÇA MIXTER O´SHAUGNESSY 19CM; PINÇA MIXTER SEM CREMALHEIRA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 10CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 10CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 12CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 12CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 13CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 13CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 16CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 16CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 18CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 18CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 21CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 21CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 23CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 23CM RETA; PINÇA MOSQUITO P/VASECTOMIA LISA CURVA 12CM; PINÇA MOYNIHAM 21CM; PINÇA MOYNIHAM 23CM; PINÇA MOYNIHAM 24CM; PINÇA MUSEAUX CURVA; PINÇA MUSEAUX RETA; PINÇA NEGUS 20CM; PINÇA OSSEA AUTO RETENTOR 16CM; PINÇA OSSEA LEWIN 18CM; PINÇA OSSEA STEINHAUSER CURVA 13CM; PINÇA OSSEA STEINHAUSER RETA 13CM; PINÇA OSSEA ULRICH 22CM; PINÇA OSSEA ULRICH 23CM; PINÇA OSSEA ULRICH 25CM; PINÇA OSSEA ULRICH 27CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 25CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 26CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 27CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 25CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 26CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 27CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 25CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 26CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 27CM; PINÇA OVERHOLT 18,5CM; PINÇA OVERHOLT-GEISSENDOERFER 21CM CURVA; PINÇA OVERHOLT-GEISSENDOERFER 27CM CURVA; PINÇA P/ EXTRAÇÃO DE PREGO; PINÇA P/ ORDENHA SECREÇÃO TUBO 25CM; PINÇA P/ TORACTOMIA CURVA P/ BAIXO; PINÇA P/ TORACTOMIA CURVA P/ CIMA; PINÇA P/ANASTOMOSE COOLEY PEDIATRICA 24X160MM; PINÇA P/COARTACAO DE DUTOS PEDIATRICA 52X67X170MM; PINÇA P/TRANSPLANTE DE FIGADO 27CM; PINÇA P/TRANSPLANTE DE FIGADO 30CM; PINÇA PALMER; PINÇA PARA AGARRE MILLIN 235MM; PINÇA PARA AGARRE MILLIN 245MM; PINÇA PARA ANASTOMOSE COOLEY 44X260MM; PINÇA PARA ANASTOMOSE COOLEY 50X265MM; PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 110X300MM; PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 130X315MM; PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 60X111X270MM; PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 93X240MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANG.15GRAUS 50X165MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 17CM 40MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 17CM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 23CM 55MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 23CM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY RETA 17CM 40MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY RETA 17CM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY RETA 23CM 55MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY RETA 23CM; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM SEMICURVA; PINÇA PATELAR; PINÇA PAYR 20CM; PINÇA PAYR 29CM; PINÇA PAYR 35CM; PINÇA PEAN 14CM; PINÇA PEAN 16CM; PINÇA PEAN 20CM; PINÇA PEAN 28CM; PINÇA PEAN MURPHY 14CM; PINÇA PEAN MURPHY 16CM; PINÇA PEAN MURPHY 20CM; PINÇA PEET; PINÇA PELKMANN

CLAMP PARAMETRIAL 16CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 16CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 16CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 21CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 21CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 21CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 21CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 30CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 30CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 30CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 30CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 35CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 35CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 35CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 35CM SEMICURVA; PINÇA ZENKER 29,5CM CURVA; PINÇA ZENKER 29,5CM RETA; PINÇA ZENKER 29,5CM SEMI CURVA; PORTA AGULHA ADSON 17CM T/C; PORTA AGULHA ADSON 17CM; PORTA AGULHA ADSON 24CM T/C; PORTA AGULHA ADSON 24CM; PORTA AGULHA ARRUGA 16CM CURVO T/C; PORTA AGULHA ARRUGA 16CM RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM C/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM C/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM C/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM C/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM S/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM S/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM S/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM S/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM C/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM C/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM C/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM C/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM S/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM S/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM S/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM S/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM C/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM C/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM C/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM C/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM S/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM S/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM S/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM S/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BAUMGARTENER 14CM T/C; PORTA AGULHA BAUMGARTENER 14CM; PORTA AGULHA BAUMGARTENER 20CM T/C; PORTA AGULHA BAUMGARTENER 20CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY 35CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 15CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 18CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 20CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 23CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 26CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 30CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 35CM; PORTA AGULHA CARDIO HEGAR T/C 14CM DELICADO; PORTA AGULHA CARDIO HEGAR T/C 18CM DELICADO; PORTA AGULHA CARDIO HEGAR T/C 20CM DELICADO; PORTA AGULHA CARDIO HEGAR T/C 23CM DELICADO; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 14CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 18CM PONTA 1MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 18CM PONTA 2MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 18CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 20CM PONTA 1MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 20CM PONTA 2MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 20CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 23CM PONTA 1MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 23CM PONTA 2MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 23CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 25CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 26CM PONTA 1MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 26CM PONTA 2MM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA

AGULHA PARA FIO DE AÇO 19CM; PORTA AGULHA PARA FIO DE ACO 20CM T/C; PORTA AGULHA PARA FIO DE ACO 20CM; PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO BERRY 20CM; PORTA AGULHA REHBEIN-BABY 11,5CM; PORTA AGULHA REHBEIN-BABY 14CM; PORTA AGULHA SAROT 17CM T/C; PORTA AGULHA SAROT 20CM T/C; PORTA AGULHA STERNAL PARA FIO DE AÇO 18CM; PORTA AGULHA STRATTE 23CM T/C; PORTA AGULHA VASCULAR 18CM CURVO; PORTA AGULHA VASCULAR 18CM RETO; PORTA AGULHA WANGENSTEEN 27CM T/C; PORTA AGULHA WANGENSTEEN 27CM; PORTA AGULHA WEBSTER WRIGHT 12,5CM; PORTA AGULHA WEBSTER; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM CURVO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM CURVO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM RETO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM RETO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM CURVO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM CURVO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM RETO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM RETO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM CURVO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM CURVO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM RETO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM RETO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM CURVO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM CURVO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM RETO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM RETO S/ TRAVA; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL; SACA PRÓTESES COM 5 PONTAS 19CM; SEPARADOR DE PALATO TURVEY; SUPORTE MAYFIELD; VÁLVULA GINECOLÓGICA AUVARD COM PESO;

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	10304850055
Processo	25351.471805/2006-89
Origem do Produto	• FABRICANTE: ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

49 Cópia Valor

001327

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos LTDA		
CNPJ	14.365.637/0001-96	**Autorização**	8.09.146-9
Produto	Desfibrilador externo automático		

Modelo Produto Médico
AED-3100

Nome Técnico	DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO / SEMI-AUTOMÁTICO EXTERNO
Registro	80914690027
Processo	25351.724548/2015-13
Origem do Produto	• FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	15/08/2026

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos LTDA		
CNPJ	14.365.637/0001-96	**Autorização**	8.09.146-9
Produto	TRANSMISSOR		

Modelo Produto Médico
ZS-630P

Nome Técnico	Registrador de Sinais Vitais
Registro	80914690010
Processo	25351.386787/2014-36
Origem do Produto	• FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	15/12/2024

Voltar

NIHON KOHDEN

NIHON KOHDEN DO BRASIL LTDA.
Rua Diadema, 89 - 1º andar
CEP: 09580-670, São Caetano do Sul, SP, Brasil
Tel. +55 11 3044-1700

001328

São Caetano do Sul, 11 de abril de 2019

CARTA DE AUTORIZAÇÃO

A quem possa interessar.

A NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., CNPJ Nº 14.365.637/0001-96, sediada na Rua Diadema, Nº 89, Mauá, CEP. 09.580-670, São Caetano do Sul/SP, declara para os devidos fins de direito que a empresa CASA HOSPITALAR IBIPORÃ LTDA, CNPJ Nº 10.769.989/0001-56, sediada na Rua 19 de Dezembro, Nº 1687, Centro, CEP. 86.200-000, Ibiporã/PR é Distribuidora exclusiva de nossos equipamentos de Cardiologia e seus acessórios, podendo comercializar e participar dos processos licitatórios nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

Ainda, sendo apta a prestar toda a assistência técnica preventiva e corretiva, manutenções e treinamentos referentes aos produtos distribuidos pela Nihon Kohden.

Os termos desta declaração são válidos até 31 de março de 2020.

Atenciosamente,

K. Ichikawa

3º Tabelião de Notas e Protesto - SCS

NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Kotaro Ichikawa
RNE: G212893-0
CPF: 238.490.798-05

3º Tabelião de Notas e de Protesto de São Caetano do Sul
Oliveiro Pires de Camargo Filho - Tabelião / R. Visconde de Inhaúma, nº 233 - CEP 09.715-070
São Caetano do Sul - SP - Fone/(11) 4233-8088 - www.3cartorioscaetano.com.br

Reconheço Por Semelhança Firma Sem Valor econômico de:
(EIQQVO) - KOTARO ICHIKAWA
São Caetano do Sul-SP, 16 de Maio de 2019
Em test.
JESSICA DE FIGUEIREDO-ESCREVENTE AUT
Selo(s): 0970AA0525682 Valor: R$6,28
OPERADOR: TANARA SANTOS DE OLIVEIRA

COLÉGIO NOTARIADO DO BRASIL
113365
FIRMA 1
S10970AA0525682

TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO
IBIPORÃ - PR

DUOMED → medef (Jicaú)

001329

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	**Autorização**	8.00.702-1
Produto	OTOSCÓPIO MD		

Modelo Produto Médico

OTOSCOPIO MARK II

OTOSCOPIO OMNI 3000

OTOSCOPIO VISIO 2000

Nome Técnico	Otoscopio
Registro	80070210012
Processo	25351.742530/2009-66
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Macrosul

avaliar • salvar • cuidar

001330

Otoscópio Mark II



- Lâmpada de Halogênio Xenon
- Conexão para otoscopia pneumática
- Lente giratória com aumento de 4 vezes
- Controle da intensidade da luz e liga/desliga
- Espéculos de ouvido autoclaváveis ou descartáveis
- Cabo recartilhado com acabamento acetinado
- Acompanha prático estojo com compartimentos
- Transmissão da luz de forma direta

Especulo Reutilizável

Especulo Nº. 1 2.5mm
Especulo Nº. 2 3.5mm
Especulo Nº. 3 4.5mm
Especulo Nº. 4 5.5mm
Especulo Nº. 5 9.0mm

Fabricante
Medical Devices (Pvt) Ltd.
Wazirabad Road
Ugoki, Sialkot
Paquistão

Importador
Macrosul Ltda
macrosul@macrosul.com
Curitiba – Paraná
Brasil

Distribuidor autorizado

MD Healthcare

ANVISA 80070210012

EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não são de SUPORTE À VIDA.			
Guia e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética O Otoscópio Mark-II MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Otoscópio Mark-II MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Guia
IEC 61000-4-6 RF Conduzida IEC 61000-4-3 RF Radiada	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 Vrms 3 V/m	Equipamentos RF portátil e móveis de comunicação não devem ser utilizados próximos a qualquer parte do Otoscópio Mark-II MD, incluindo cabos, menor que o afastamento recomendado calculado a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Afastamento recomendado: d = 1,2 √P d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz d = 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz Onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). Intensidades de campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado por uma análise local eletromagnética,a deve ser menor do que o nível de conformidade em cada faixa de frequência b. Pode ocorrer interferência na proximidade de equipamento marcado com o seguinte símbolo:
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a maior gama de frequência. NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
a. A intensidade de campos de transmissores fixos, tais como estações de base para rádio (celular / sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, uma pesquisa eletromagnética local deve ser considerada. Se a intensidade de campo medida no local em que o Otoscópio Mark-II MD é usado excede o nível de conformidade de RF aplicável acima, o Otoscópio Mark-II MD deve ser observado para verificar a operação normal. Se for observado desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientação ou reposicionamento do Otoscópio Mark-II MD. b. Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade do campo deverá ser inferior a 3 V/m.			

Tabela 6 – Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA – para EQUIPAMENTO e SISTEMA que não são de SUPORTE À VIDA

Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis e o Otoscópio			
O Otoscópio Mark-II MD é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do Otoscópio Mark-II MD pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Otoscópio Mark-II MD como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.			
Potência de saída nominal máxima do transmissor / W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor / m		
	150 kHz to 80 MHz d=1,2√P	80 MHz to 800 MHz d=1,2√P	800 MHz to 2,5 GHz d=2,3√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30
Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância d de separação recomendada em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a maior gama de frequência. NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			

NOTA

Interferência Eletromagnética
Aparelhos de Diatermia, Raio-X, bem como equipamentos contendo motores de funcionamento intermitente produzem campos eletromagnéticos de grande intensidade.
Portanto, esses aparelhos podem produzir interferências em circuitos eletrônicos que estejam nas vizinhanças, podendo fazê-los operar de modo errôneo.

Minimizando os riscos de interferências eletromagnéticas
Coloque seu aparelho o mais distante possível de outros aparelhos eletrônicos, bem como de objetos metálicos oblongos (clarick, esquadrias metálicas), pois esses objetos podem atuar como antenas secundárias.

Simbologia na embalagem	
Símbolo	**Descrição**
	Equipamento Energizado internamente, parte aplicada Tipo B.
	Siga as instruções de uso.
	Fabricante
BR IMP	Importador e Distribuidor Autorizado no Brasil
	Este símbolo indica que lixo eletrônico não deve ser descartado em lixo comum doméstico. Procure um ponto de coleta de lixo eletrônico em sua região.
CE	Marca CE para dispositivos médicos.
LOT	Número de lote do dispositivo.
	Data de fabricação
REF	Referência do produto

Símbolo	Descrição
	Equipamento Energizado internamente, parte aplicada Tipo B.
CE	Marca CE para dispositivos médicos
LOT	Número de lote do dispositivo
Registro	Marca de Certificação INMETRO

Garantia: 001331
O Otoscópio Mark-II MD possui garantia de um (1) ano após a data de entrega do aparelho ao usuário.
A garantia cobre defeitos de materiais construtivos e de fabricação.

A garantia será perdida caso ocorram: uso indevido ou em desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro dano.

Estão excluídas da garantia lâmpadas, lentes e pilhas. Durante o período de garantia serão efetuadas todos reparos e/ou trocas necessários sem nenhum custo adicional ao usuário.

Assistência Técnica:
Consulte a Assistência sobre quaisquer dúvidas sobre o funcionamento ou operação do instrumento, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários.

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 – Atuba
CEP 82600-070 – Curitiba - Paraná
(41) 2102-8344
suporte@macrosul.com

Atenção: Este produto não deve ser utilizado na presença de gases inflamáveis.

Aviso: Este produto não deve ser imerso em líquidos.

Descarte o equipamento e pilhas de forma segura. Procure o ponto de coleta de resíduos eletrônicos mais próximo da sua região

A marcação CE atesta que o produto foi fabricado em conformidade com as exigências das Diretrizes da União Européia, cumprindo os requisitos de segurança indicados nas normas em vigor.

Medical Devices (Pvt) Ltd.
Paquistão

BR IMP Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
ANVISA 80070210012

MO.OTO MARK-II.2015/V.1/REV.1/AGO.15

OTOSCÓPIO MARK II – MD



Agradecemos por adquirir o Otoscópio Mark II - MD. Este produto é fabricado de acordo com os mais exigentes padrões de seleção dos materiais de fabricação e controle de qualidade total a fim de garantir qualidade insuperável e assegurar um aparelho de excelente desempenho e confiabilidade.
O operador deve ler com atenção e entender minuciosamente as instruções deste manual a fim de manter o desempenho durável e confiável do produto por período prolongado.
Após abrir a embalagem, primeiramente verifique todos os componentes em relação aos padrões especificados. Certifique de que a configuração do produto está completa e em perfeitas condições.

Indicação de Uso

O Otoscópio Mark II - MD somente deve ser utilizado por profissionais treinados e familiarizados com as técnicas implicadas e após serem lidas as instruções de uso.
O otoscópio é um instrumento de uso médico, fundamental para exames do canal auditivo externo e da membrana timpânica.
O Otoscópio Mark II - MD é um otoscópio clássico com iluminação direta de alta qualidade. Possui um reostato no cabo para ajustar a intensidade da luz e uma lente de vidro removível na cabeça que permite uma ampliação da imagem em 4 vezes. Ainda, permite realizar o teste pneumático para avaliar a mobilidade da membrana timpânica.
Um instrumento leve fabricado com cabo em metal com revestimento cromado resistente à corrosão e impactos, combinado com partes plásticas.

Características

- Iluminação direta de 2.5V proporciona qualidade de iluminação
- Cabeça inteiramente metálica com lente removível
- Campo de visão com aumento de 4 vezes
- Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem
- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional)
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos
- Fácil substituição da lâmpada
- Cabo em metal com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança
- Reostato para controle de intensidade da luz
- Alimentação através de duas pilhas alcalinas tipo C
- Modo de operação: contínuo
- Grau de proteção contra penetração de água: IPX0.

Instruções de uso

Cuidadosamente verifique se o equipamento não tem nenhum dano e se as partes e acessórios estão íntegros. Se encontrar algum dano, contate imediatamente o distribuidor local autorizado.
Na parte inferior do cabo, desrosqueie a tampa e coloque 2 (duas) pilhas alcalinas tipo C na cavidade do cabo respeitando as polaridades corretas. O polo positivo (+) deve ser posicionado para a parte superior do cabo. Para fechar, rosqueie a tampa no sentido horário.
Conecte a cabeça do otoscópio no cabo, rosqueando no sentido horário até que esteja firmemente fixada. A lâmpada de xênon halógena já é integrada à cabeça. Encaixe o espéculo na ponta da cabeça. O Otoscópio Mark II está pronto para uso.
Para ligar/desligar e controlar a intensidade da luz gire o reostato localizado na parte superior do cabo.
A lente giratória conectada à cabeça do Otoscópio Mark II proporciona um aumento de até 4 vezes.
Ao fazer o teste pneumático, conecte uma pera de insuflação (opcional) na lateral da cabeça do otoscópio. Aplique pressão com muito cuidado para não injuriar a membrana timpânica.

001332

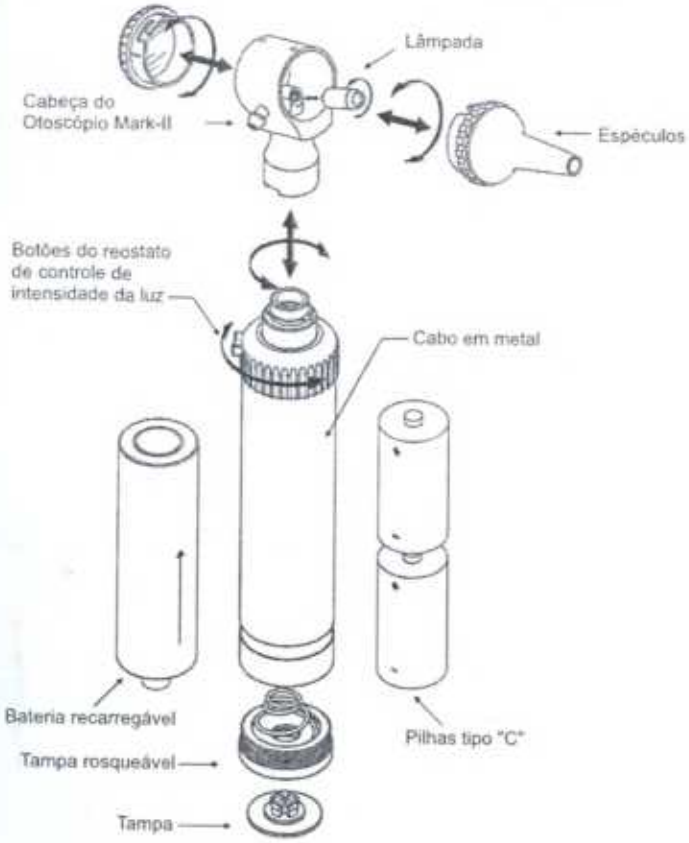


Fig. 1

Substituição das Pilhas

Para colocar as pilhas é necessário desrosquear a tampa na parte inferior do cabo do Otoscópio Mark II, no sentido anti-horário.

Introduza duas (2) pilhas alcalinas tipo C (2 x 1,5V) na cavidade do cabo. Certifique que o polo positivo (+) da pilha fique posicionado para parte superior do cabo. Rosqueie a tampa no sentido horário.

Para ligar/desligar e controlar a intensidade da luz gire o reostato que está localizado na parte superior do cabo.

Substituição da Lâmpada

A lâmpada está posicionada cabeça do Otoscópio conforme Fig. 1.
Retire a lâmpada usando o dedo indicador e o polegar, ou com uma pinça.

Insira a nova lâmpada no mesmo local.

Descarte a lâmpada e pilhas de acordo com as regulamentos locais. Procure um ponto de coleta na sua região.

O Otoscópio Mark II - MD e seus acessórios não requerem nenhuma manutenção especifica. Caso seja necessária a verificação do aparelho, por qualquer razão, entre em contato com a assistência técnica autorizada.

Limpeza e Desinfecção

O cabo do Otoscópio Mark II - MD deve ser limpo externamente com um pano macio umedecido. Recomenda-se limpar a cabeça do Otoscópio Mark II - MD com um pano macio limpo e seco.
As lentes podem ser limpas com pano macio e seco. Não utilize nenhum produto abrasivo, solvente químico ou álcool.
Não permita que a solução escorra para dentro do produto, pois a umidade pode danificar os componentes internos do equipamento.
Após cada utilização, sempre higienize o espéculo reutilizável com água morna e sabão antes de qualquer procedimento. Para desinfecção, pode-se enxaguar em água destilada fervente. Alternativamente, pode-se utilizar imersão em soluções frias na mesma concentração para esterilizar instrumentais médicos ou submeter à lavadoras de termo desinfecção até 65°C (somente espéculos). Após desinfecção, enxágue abundantemente os espéculos com água estéril e seque com um pano macio.
Apenas o espéculo reutilizável do otoscópio pode ser colocado na autoclave a 134°C por um período de até 10 minutos, mas este procedimento irá reduzir a vida útil do produto.

Armazenamento e Conservação

Não deixe que o aparelho entre em contato com líquidos ou receba choques mecânicos, isso pode prejudicar a funcionalidade do aparelho. Armazene-o em local limpo e seco e em condições de temperatura adequadas (ambiente).
Condições de operação: 10°C a 40°C; umidade entre 30% a 75%; 700hPa - 1060hPa.
Condições de armazenamento e transporte: -20°C a 60°C; umidade entre 10% a 90% (sem condensação); 500hPa - 1060hPa.

⚠ Precauções, Cuidados e Advertências

- Se o aparelho não for utilizado por um período de tempo prolongado, ou durante viagens, retire as pilhas do cabo. Substitua as pilhas quando a intensidade da luz ficar reduzida, pois o exame será prejudicado.
- Para obter o máximo de iluminação é recomendável colocar sempre pilhas novas de alta qualidade.
- Certifique que nenhum fluído ou condensação penetre no aparelho. Nunca coloque o aparelho em imersão em fluídos de qualquer natureza.
- Verifique periodicamente as condições das pilhas e baterias, certifique de que não há sinais de corrosão ou oxidação. Quando necessário, substitua-as por novas.
- Antes do uso, assegure de que a conexão entre o cabo e a cabeça do dispositivo está correta e que o botão liga/desliga opera adequadamente.
- Se a iluminação ficar intermitente ou a luz não acender, verifique as condições e posição da lâmpada, das pilhas ou bateria e os contatos elétricos.
- Manuseie as pilhas e baterias com cuidado. O líquido que eventualmente possa vazar é extremamente irritante para a pele e olhos.
- Descarte as pilhas em local apropriado.
- Todas as partes integradas do Otoscópio Mark-II são extremamente delicadas, precisam de cuidados especiais, não devem ser lançadas sobre qualquer superfície rígida.

Normas Aplicáveis e Conformidades Técnicas

- IEC 60601-1
- IEC 60601-1-2

Acessórios que acompanham

- Cabeça do Otoscópio Mark II
- Estojo macio com ziper
- Lâmpada a vácuo 2.5V
- Cabo metal tipo C
- Espéculos reutilizáveis (2,5mm / 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 9,0mm)

Acessórios opcionais e peças sobressalentes

- Pêra de insuflação
- Conector para pêra de insuflação
- Lâmpada a vácuo 2.5V
- Lâmpada Halógena 2.5V
- Lâmpada LED 2.5V
- Estojo macio com Ziper
- Estojo rígido plástico
- Espéculos descartáveis 2,50mm/ 2,75mm/ 4,00mm/ 4,25mm
- Espéculos reutilizáveis 2,4mm/ 3,0mm/ 4,0mm/ 5,0mm/ 10mm para Adaptador em Metal para Espéculo
- Espéculos reutilizáveis de metal 4,0mm/ 5,0mm/ 6,0mm/ 7,5mm/ 9,0mm
- Espéculos reutilizáveis para uso veterinário 4,0mm/ 5,0mm/ 7,0mm
- Adaptador em Metal para Espéculo
- Cabeça do Otoscópio Cirúrgico Mark II
- Porta abaixador de língua
- Abaixador de Lingua Inox
- Adaptador para Abaixador de Lingua Descartável
- Espelho laríngeo 3,0mm/ 4,00mm
- Espéculo nasal expansível
- Lente de Aumento Removível do Otoscópio
- Iluminador Curvo Inox de Garganta Mark II Lâmpada a Vácuo 2.5V
- Iluminador Curvo Inox de Garganta Mark II Lâmpada Halógena 2.5V
- Iluminador Curvo Inox de Garganta Mark II LED 2.5V
- Iluminador Nasal Mark II Lâmpada a Vácuo 2.5V
- Iluminador Nasal Mark II Lâmpada Halógena 2.5V
- Iluminador Nasal Mark II LED 2.5V
- Iluminador com Abaixador de Lingua Mark II Lâmpada a Vácuo 2.5V
- Iluminador com Abaixador de Lingua Mark II Lâmpada Halógena 2.5V
- Iluminador com Abaixador de Lingua Mark II LED 2.5V

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas Tabela 1 – Diretrizes e declaração do fabricante Emissões Eletromagnéticas – para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS		
O Otoscópio Mark-II MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Otoscópio Mark-II MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.		
Teste de emissão	Conformidade	Ambiente Eletromagnético – Orientação
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF)	Grupo 1	O Otoscópio Mark-II MD utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e é improvável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF)	Classe B	O Otoscópio Mark-II MD é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo ambientes domésticos e locais conectados diretamente à rede elétrica de baixa tensão que fornece energia a edifícios usados para fins domésticos.
IEC 61000-3-2 - Emissões Harmônicas	Classe B	
IEC 61000-3-3 - Flutuações de tensão/ Emissões com tremulação	Conforme	

Tabela 2 – Diretrizes e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética - para todos os EQUIPAMANETO e SISTEMAS - **Ensaios de Imunidade Conformidade Ambiente Eletromagnético**			
Guia e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética O Otoscópio Mark-II MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Otoscópio Mark-II MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de Teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético-Guia
IEC 61000-4-2 Descarga Eletrostática (ESD)	± 6 kV contato ± 8 kV ar	Conforme Conforme	O piso deve ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso for coberto com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
IEC 61000-4-4 Transiente Elétrico Rápido/Explosão	± 2 kV para linhas de corrente elétrica ± 1 kV para linhas de entrada / saída	Conforme Conforme	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-5 Surtos de Tensão	± 1 kV linha(s) a linha (s) ± 2 kV Linha (s) para a terra	Conforme Conforme	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-11 Quedas, Curtas Interrupções e Variações de Tensão nas linhas de alimentação	<5% UT (> 95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT (60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT (30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT (> 95% de queda em UT) por 5 s	<5% UT (> 95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT (60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT (30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT (> 95% de queda em UT) por 5 s	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do Otoscópio Mark-II MD necessitar do funcionamento contínuo durante as interrupções de energia, recomenda-se que o Otoscópio Mark-II MD seja alimentado por uma fonte de alimentação contínua ou por bateria.
IEC 61000-4-8 Campo Magnético de Frequência de Corrente (50/60 Hz)	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos de frequência de alimentação devem estar em níveis característicos de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
NOTA: UT é a tensão CA da rede elétrica antes da aplicação do nível de teste.			

47 media

001333

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	M. SÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
CNPJ	72.819.980/0001-60	**Autorização**	8.01.280-0
Produto	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA		

Modelo Produto Médico
04 x 15 , 06x15 , 08x15, 10x15, 12x15, 15x15, 20x15, 25x15, 30x15;
04x10, 06x10, 08x10, 10x10, 12x10, 15x10, 20x10, 25x10, 30x10;
04x20, 06x20, 08x20, 10x20, 12x20, 15x20, 20x20, 25x20, 30x20;
1,5x25, 04x25, 06x25, 08x25, 10x25, 12x25, 15x25, 20x25, 25x25, 30x25;
5,0x22,8 / 7,5x22,8 / 10,0x22,8 / 12,5x22,8 / 15,0x22,8 / 20,0x22,8

Nome Técnico	Imobilizador Ortopedico
Registro	80128000012
Processo	25351.488400/2013-93
Origem do Produto	• FABRICANTE: M. SÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

41, 42, 43, 45, 46 Marfe

00133

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	**Autorização**	8.00.702-1
Produto	LARINGOSCÓPIOS MD		

Modelo Produto Médico

Laringoscópio Macintosh Convencional; Laringoscópio Macintosh Fibra Óptica; Laringoscópio Miller Convencional; Laringoscópio Miller Fibra Óptica; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Convencional; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Fibra Óptica; Laringoscópio Macintosh German Fibra Óptica.

Nome Técnico	Laringoscopio
Registro	80070210014
Processo	25351.742491/2009-91
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

DUOMED

Detalhes do Produto

001335

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	**Autorização**	8.00.702-1
Produto	LARINGOSCÓPIOS MD		

Modelo Produto Médico

Laringoscópio Macintosh Convencional; Laringoscópio Macintosh Fibra Óptica; Laringoscópio Miller Convencional; Laringoscópio Miller Fibra Óptica; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Convencional; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Fibra Óptica; Laringoscópio Macintosh German Fibra Óptica.

Nome Técnico	Laringoscopio
Registro	80070210014
Processo	25351.742491/2009-91
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

40 Medfe

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001333

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ANDRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA - M.E.		
CNPJ	06.150.367/0001-78	**Autorização**	8.08.993-8
Produto	FLUXÔMETRO		

Modelo Produto Médico
FLUXÔMETRO DE 0-15 LTS/MIN. PARA AR.
FLUXÔMETRO DE 0-15 LTS/MIN. PARA N2O.
FLUXÔMETRO DE 0-15 LTS/MIN. PARA O2.
FLUXÔMETRO DE 0-3 LTS/MIN. PARA AR.
FLUXÔMETRO DE 0-3 LTS/MIN. PARA O2.
FLUXÔMETRO DE 0-5 LTS/MIN. PARA AR.
FLUXÔMETRO DE 0-5 LTS/MIN. PARA O2.

Nome Técnico	Fluxometro
Registro	80899380001
Processo	25351.421545/2013-60
Origem do Produto	• FABRICANTE: ANDRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA - M.E. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

41, 42, 43, 45, 46 Marfe

00133

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	**Autorização**	8.00.702-1
Produto	LARINGOSCÓPIOS MD		

Modelo Produto Médico

Laringoscópio Macintosh Convencional; Laringoscópio Macintosh Fibra Óptica; Laringoscópio Miller Convencional; Laringoscópio Miller Fibra Óptica; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Convencional; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Fibra Óptica; Laringoscópio Macintosh German Fibra Óptica.

Nome Técnico	Laringoscopio
Registro	80070210014
Processo	25351.742491/2009-91
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

DUONED

Detalhes do Produto

001335

Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	**Autorização**	8.00.702-1
Produto	LARINGOSCÓPIOS MD		

Modelo Produto Médico

Laringoscópio Macintosh Convencional; Laringoscópio Macintosh Fibra Óptica; Laringoscópio Miller Convencional; Laringoscópio Miller Fibra Óptica; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Convencional; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Fibra Óptica; Laringoscópio Macintosh German Fibra Óptica.

Nome Técnico	Laringoscopio
Registro	80070210014
Processo	25351.742491/2009-91
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Tabela 3 – Diretrizes e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética – para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS – Ensaios de Imunidade Conformidade Ambiente Eletromagnético

Guia e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética
O Laringoscópio MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou o usuário do Laringoscópio MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.

Teste de Imunidade	Nível de Teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético-Guia
IEC 61000-4-2 Descarga Eletrostática (ESD)	± 6 kV contato ± 8 kV ar	Conforme Conforme	O piso deve ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso for coberto com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
IEC 61000-4-4 Transiente Elétrico Rápido/Explosão	± 2 kV para linhas de corrente elétrica ± 1 kV para linhas de entrada / saída	Conforme Conforme	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-5 Surtos de Tensão	± 1 kV linha(s) a linha (s) ± 2 kV Linha (s) para a terra	Conforme Conforme	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-11 Quedas, Curtas Interrupções e Variações de Tensão nas linhas de alimentação	<5% UT (> 95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT (60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT (30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT (> 95% de queda em UT) por 5 s	<5% UT (> 95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT (60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT (30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT (> 95% de queda em UT) por 5 s	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do Laringoscópio MD necessitar de funcionamento contínuo durante as interrupções de energia, recomendamos que o Laringoscópio MD seja alimentado por uma fonte de alimentação contínua ou por bateria.
IEC 61000-4-8 Campo Magnético da Frequência da Corrente (50/60 Hz)	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos de frequência da alimentação devem estar em níveis característicos de um ambiente hospitalar ou comercial típicos.

NOTA: UT é a tensão CA da rede elétrica antes da aplicação do nível de teste.

Tabela 4 – Diretrizes e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética – para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não são de SUPORTE À VIDA.

Guia e Declaração do Fabricante - Imunidade Eletromagnética
O Laringoscópio MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou o usuário do Laringoscópio MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.

Teste de Imunidade	Nível de Teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Guia
IEC 61000-4-6 RF Conduzida IEC 61000-4-3 RF Radiada	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 Vrms 3 V/m	Equipamentos RF portáteis e móveis de comunicação não devem ser utilizados próximos a qualquer parte do Laringoscópio MD, incluindo cabos, menor que o afastamento recomendado calculado a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Afastamento recomendado: d = 1,2 √P d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz d = 2,3 √P 800MHz a 2,5 GHz Onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). Intensidades de campo de transmissores de RF fixo, conforme determinado por uma análise local eletromagnética,a deve ser menor do que o nível de conformidade em cada faixa de frequência.b Pode ocorrer interferência na proximidade do equipamento marcado com o seguinte símbolo:

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a maior gama de frequência.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a: A intensidade de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para rádio (celular / sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, uma pesquisa eletromagnética local deve ser considerada. Se a intensidade de campo medida no local em que o Laringoscópio MD é usado exceda o nível de conformidade de RF aplicável acima, o Laringoscópio MD deve ser observado para verificar a operação normal. Se for observado desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientação ou reposicionamento do Laringoscópio MD.
b: Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deverá ser inferior a 3 V/m.

Tabela 6 – Distância de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA - para EQUIPAMENTO e SISTEMA que não são de SUPORTE À VIDA

Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis e o Laringoscópio

O Laringoscópio MD é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do Laringoscópio MD pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Laringoscópio MD como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência de saída nominal máxima do transmissor / W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor / m		
	150 kHz to 80 MHz d=1,2√P	80 MHz to 800 MHz d=1,2√P	800 MHz to 2,5 GHz d=2,3√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30

Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância d de separação recomendada em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a maior gama de frequência.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Interferência Eletromagnética
Aparelhos de Diatermia, Bisturi, bem como equipamentos operando mediante do funcionamento intermitente produzem campos eletromagnéticos de grande intensidade.
Portanto, esses aparelhos podem produzir interferências em circuitos elétricos que estejam nas vizinhanças, podendo fazê-los operar de modo errôneo.

Minimizando os riscos de interferências eletromagnéticas
Coloque seu aparelho o mais distante possível de outros aparelhos elétricos, bem como de objetos metálicos (talheres, panos, esquadrias metálicas), pois estes objetos podem atuar como antenas secundárias.

Simbologia na embalagem	
Símbolo	Descrição
	Equipamento Energizado internamente, parte aplicada Tipo B.
	Siga as instruções de uso.
	Fabricante
	Importador e Distribuidor Autorizado no Brasil
	Este símbolo indica que lixo eletrônico não deve ser descartado em lixo comum doméstico. Procure um ponto de coleta de lixo eletrônico em sua região.
CE	Marca CE para dispositivos médicos.
LOT	Número de lote do dispositivo.
	Data de fabricação
REF	Referência do produto

Simbologia no equipamento	
Símbolo	Descrição
	Equipamento Energizado internamente, parte aplicada Tipo B.
CE	Marca CE para dispositivos médicos
LOT	Número de lote do dispositivo
Registro	Marca de Certificação INMETRO

Garantia:
O Laringoscópio Convencional - MD possui garantia de um (1) ano após a data de entrega do aparelho ao usuário.
A garantia cobre defeitos de materiais construtivos e de fabricação.

A garantia será perdida caso ocorram: uso indevido ou em desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro dano.

Estão excluídas da garantia lâmpadas e pilhas. Durante o período de garantia serão efetuadas todos reparos e/ou trocas necessários sem nenhum custo adicional ao usuário.

Assistência Técnica:
Consulte a Assistência sobre quaisquer dúvidas sobre o funcionamento ou operação do instrumento, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessários.

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
Rua João Bartolomeu Taborda Luiz, 270 – Atuba
CEP 82600-070 – Curitiba - Paraná
(41) 2102-8344
suporte@macrosul.com

Atenção: Este produto não deve ser utilizado na presença de gases inflamáveis.

Aviso: Este produto não deve ser imerso em líquidos.

Descarte o equipamento e pilhas de forma segura. Procure o ponto de coleta de resíduos eletrônicos mais próximo da sua região.

A marcação CE atesta que o produto foi fabricado em conformidade com as exigências das Diretrizes da União Europeia, cumprindo os requisitos de segurança indicados nas normas em vigor.

001336

Medical Devices (Pvt) Ltd.
Paquistão

BR IMP

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.387/0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
ANVISA 80070210014

Laringoscópio Convencional - MD



Agradecemos por adquirir o Laringoscópio Convencional - MD. Este produto é fabricado de acordo com os mais exigentes padrões de seleção dos materiais de fabricação e controle de qualidade total a fim de garantir qualidade insuperável e assegurar um aparelho de excelente desempenho e confiabilidade.

O operador deve ler com atenção e entender minuciosamente as instruções deste manual a fim de manter o desempenho durável e confiável do produto por período prolongado.

Após abrir a embalagem, primeiramente verifique todos os componentes em relação aos padrões especificados. Certifique de que a configuração do produto está completa e em perfeitas condições.

Indicação de Uso
O Laringoscópio Convencional - MD é um equipamento portátil utilizado por profissionais capacitados da área médica a fim de facilitar procedimentos de laringoscopia e a intubação endotraqueal e exames cuidadosos da garganta, através da iluminação e abertura da epiglote, utilizando lâminas (retas e curvas) de diferentes tamanhos que se adaptam às características anatômicas de cada paciente.
A configuração do produto é caracterizada por um cabo recartilhado para maior ergonomia e segurança, lâminas acetinadas para reduzir brilho e reflexão, alimentação por pilhas alcalinas ou bateria recarregável e iluminação por uma lâmpada que pode ser Xenon/Halógena ou LED.

Características
Oferecemos uma ampla linha de laringoscópios desde os modelos convencionais até os de fibra óptica. As mais famosas lâminas estão configuradas em diversos tamanhos e são feitas de aço inoxidável com acabamento acetinado (fosco) para redução de brilho e reflexão, aperfeiçoando ainda mais o seu desempenho e durabilidade. Os cabos são de aço inoxidável e estão disponíveis em 5 configurações.

As lâminas também podem ser de uso único, nos modelos Macintosh, Miller e McCoy, embaladas individualmente.

As lâminas do Laringoscópio Convencional - MD são fabricadas a partir de aço inoxidável austenítico antimagnético 18/8, qualidade AISI 303/304, com baixíssima porcentagem de carbono o que lhe confere altíssima resistência à corrosão e superior comparada à dos demais aços inoxidáveis.


Os cabos MARK III Standard são fabricados e embalados em áreas ambientalmente controladas de partículas presente no ar, minimizando a possibilidade de contaminação e assegurando o desempenho pretendido. São fabricados a partir de materiais padronizados por diretivas internacionais para instrumentos médicos e cirúrgicos. Possuem superfície com acabamento seguro, livre de arestas e rebarbas. Possuem sistema de travamento de acordo com os padrões internacionais de intercambialidade com as lâminas, assegurando um engate preciso e seguro.

Em conformidade com a norma ISO 7376, que dispõe os requisitos gerais para laringoscópios utilizados para intubação e especifica as dimensões críticas dos cabos e da lâmpada do encaixe do cabo à lâmina. A norma aborda ainda as especificações para a intercambialidade de lâminas e cabos.

Como usar as Lâminas Flexi-tip
Não force a alavanca da lâmina ao desengatá-la do cabo. Não aplique pressão nas direções mostradas na (Fig. 1), pois pode forçar a lâmina e alavancá-la para fora.
Ao engatar a lâmina no cabo, tenha cuidado para não ocorrer nenhum dano, pois caso contrário, pode resultar em ação incorreta ou rigidez à ponta flexível. A lâmina Flex-tip deve ser engatada no cabo de modo usual. A alavanca que movimenta a ponta da lâmina pode então ser acionada com a palma da mão em direção ao cabo.
Nenhum contato com a alavanca deve ser feito durante o estágio inicial de uso, ou seja, até que a ponta do laringoscópio tenha sido inserida na valécula epiglótica.
Uma vez que este estágio tenha sido alcançado, o movimento da alavanca em direção ao cabo elevará a ponta da lâmina e, portanto, elevará a epiglote, sem a necessidade de aumentar a força exercida pela parte principal da lâmina. Libere a alavanca antes de retirar a lâmina da laringe do paciente.

Instruções de Uso

1. Coloque pilhas (consulte a tabela de acessórios para certificar o tamanho das pilhas) no interior do cabo e rosqueie a tampa da extremidade do cabo no sentido horário.
2. Engate a lâmina através do alinhamento da ranhura da sua base sobre o eixo na parte superior do cabo, aplique uma força suficiente e puxe até a posição horizontal, obtendo o encaixe sob pressão (Fig.2). Neste momento a lâmpada acende, proporcionando uma iluminação em feixe necessária para a realização do procedimento por profissional capacitado.
3. Verifique sempre se a intensidade luz fornecida é satisfatória para a realização do procedimento, caso contrário troque as pilhas.
4. Para trazer a lâmina à posição de repouso, sem iluminação, aplique força para baixo.
5. Para retirar a lâmina do cabo, aplique força para baixo e empurre a base da lâmina para cima com o seu dedo polegar. Encaminhe para higienização e assepsia.

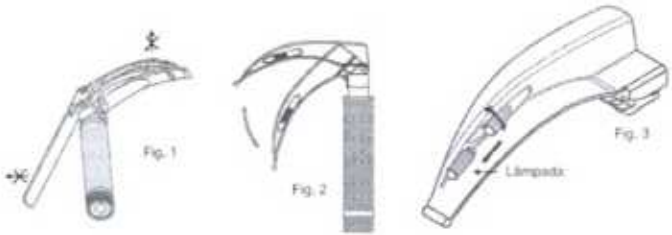

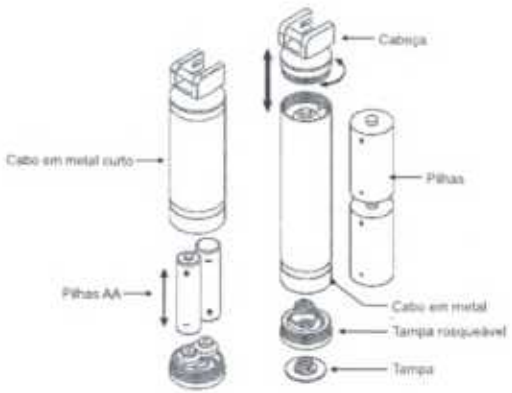


Fig. 4

Substituição da lâmpada

1. Desrosqueie a lâmpada girando-a no sentido anti-horário até soltá-la (Fig. 3).
2. Substitua por uma nova e rosqueie no sentido horário até ficar bem firme.
3. Certifique de que a lâmpada está adequadamente rosqueada.

Substituição das pilhas

1. Desrosqueie a tampa inferior do cabo e remova as pilhas (Fig. 4).
2. Para maior longevidade, recomenda-se o uso de pilhas alcalinas. Pilhas de carbono comum também podem ser usadas.
3. Substitua com pilhas de tamanho apropriado e certifique-se de que os polos + e – estejam posicionados corretamente.
4. No cabo Curto, insira uma pilha com o polo (+) para baixo e a outra pilha com o polo (+) para cima. Se a iluminação falhar, verifique se as polaridades das pilhas estão inseridas corretamente.
5. Reinstale a tampa inferior do cabo.

Pilhas são resíduos tóxicos ao meio ambiente e devem ser descartadas de acordo com os regulamentos locais. Procure o ponto de coleta mais próximo de sua região.

Armazenamento e Conservação

Não permita que o equipamento receba choques mecânicos, pois pode prejudicar a funcionalidade do mesmo. Armazene-o em local limpo e seco.
Condições de Operação: 10°C a 40°C; umidade entre 30% a 75%; 700hPa – 1060hPa.
Condições de Armazenamento e Transporte: -20°C a 60°C; umidade entre 10% a 90% (sem condensação); 500hPa – 1060hPa.

...dados e Manutenção

Remova as pilhas e baterias antes do procedimento de limpeza.

LÂMINAS

1. Limpeza

Imediatamente após o uso, o laringoscópio deve ser lavado em água corrente fria até que toda sujeira visível seja removida. Assegure-se que todas as áreas de difícil alcance sejam lavadas com água corrente. Mergulhe o conjunto do laringoscópio selado em uma solução enzimática de limpeza preparada de acordo com as recomendações do fabricante, por no mínimo dois minutos. Retire o dispositivo da solução e enxágue com água corrente morna por no mínimo 1 minuto para remover todos os resíduos e sujeiras visíveis. Em seguida mergulhe o dispositivo em detergente enzimático. Remova a tampa inferior e escove minuciosamente utilizando uma escova macia de nylon, assegure-se de que todas as áreas de difícil acesso sejam alcançadas e os resíduos sejam removidos. Seque com um tecido limpo e livre de fiapos ou tecido estéril. A limpeza adequada dos instrumentos é um processo crítico e necessário antes da desinfecção e esterilização. Prossiga com a desinfecção de alto nível ou procedimento de esterilização.

⚠ **A limpeza por equipamento de ultrassom é estritamente proibida.**

2. Desinfecção

A imersão em solução termoquímica em um esterilizador até o máximo de 55°C pode promover a desinfecção. Neste caso, as recomendações do fabricante quanto à duração e concentração da solução, devem ser rigorosamente respeitadas. Após a desinfecção, enxágue abundantemente em água estéril e seque com um tecido seco, limpo e livre de fiapos.

3. Imersão em Soluções Frias

Para obter alto nível de desinfecção, soluções de Cidex® OPA ou glutaraldeído a 2,4% podem ser usadas de acordo com as instruções do fabricante. Seque com um tecido limpo e livre de fiapos ou tecido estéril. Monte todas as partes, coloque as pilhas no cabo e teste se o sistema está funcionando adequadamente. Caso não funcione, verifique abaixo as instruções de teste da pilha/lâmpada.

⚠ **NÃO imergir as lâminas em soluções com água sanitária, produtos a base de iodo (PVPI – polivinilpirrolidona) ou hidróxido de potássio.** Essas soluções danificam gravemente o instrumento. Também evite o contato metal com metal após a imersão, as lâminas devem ser enxaguadas com água estéril para remover resíduos químicos e secas com um tecido limpo, livre de fiapos ou tecido estéril.

4. Esterilização

Antes de realizar qualquer procedimento a seguir, as lâminas devem ser limpas como descrito no procedimento de limpeza.

4.1. Esterilização a gás

A esterilização a gás por óxido de etileno a temperatura máxima de 65°C e pressão de 8 psi pode ser realizada. Este método de esterilização é preferivelmente recomendável quando a esterilização é realizada com frequência.

4.2 Esterilização a vapor

A esterilização a vapor também pode ser realizada. Insira o dispositivo em um envelope de autoclave apropriado.

Deslocamento De Vapor Por Gravidade		
Temperatura	121°C (250°F)	132°C (270°F)
Tempo do ciclo	30 min	4min
Tempo de secagem	15 min	20 min

Nota: não exceder a temperatura de 135°C e a pressão de 28 psi.

Os métodos de esterilização flash (ou "ciclo flash") de autoclaves e esterilização através do calor seco por ar quente (estufa) devem ser evitados, pois esses processos danificam o instrumento.

⚠

4.3 Sistema de Esterilização Steris Amsco V-Pro

Lâminas e cabos do Laringoscópio Convencional - MD são compatíveis com:
Sistema de esterilização por temperatura Amsco V-Pro 1 Low
Sistema de esterilização por temperatura Amsco V-Pro 1 Plus Low
Sistema de esterilização por temperatura Amsco V-Pro 1 Pro Max

4.4 Esterilização por Plasma de Peróxido de Hidrogênio Sterrad

Lâminas e cabos do laringoscópio Convencional MD são compatíveis com:
Sistema Sterrad 100NX (Ciclo Padrão e Expresso)
Sistema Sterrad NX (Ciclo Padrão)
Sistema Sterrad 1005 e 200 (Ciclo Curto fora US)
Sistema Sterrad 50

001337

CABOS

1.Limpeza e Esterilização

A esterilização dos cabos por imersão em soluções frias ou em autoclave deve seguir as mesmas recomendações descritas para a lâmina. Entretanto, as pilhas e a lâmpada devem ser removidas antes da desinfecção e esterilização. O cabo pode ser exposto ao óxido de etileno (ETO). A lâmpada pode ser limpa com algodão embebido em álcool isopropílico. O cabo principal e a tampa inferior também podem ser expostos ao óxido de etileno.

⚠ **Não permita que nenhum excesso de fluido infiltre-se nos contatos elétricos. As pilhas devem ser removidas antes da limpeza e esterilização.**

Teste de Manutenção Periódica do Cabo e Lâmina

As lâminas e o cabo do laringoscópio devem sempre ser testados após os procedimentos de limpeza, desinfecção, esterilização e antes do uso. Para testar conecte a lâmina ao cabo e gire a lâmina para cima, na posição LIGA, como na (Fig.2). Se a luz falhar ou piscar, verifique a lâmpada, pilhas e os contatos elétricos. Certifique-se da instalação adequada das peças de reposição como lâmpadas e pilhas. Se o problema persistir, por favor entre em contato com o Suporte Técnico.

Aviso:

As instruções de esterilização listadas acima, fornecidas por Medical Devices Ltd, destinam-se a procedimentos compatíveis com materiais específicos. A esterilização deve ser realizada conforme o protocolo hospitalar ou institucional aprovado. A Medical Devices Ltd não pode garantir a esterilização. A validação da esterilização é de responsabilidade do hospital, instituição e/ou pelo fabricante do equipamento de esterilização.

Acessórios e peças sobressalentes

- Estojo macio para 5 lâminas e 1 cabo MARK III Standard - MD
- Estojo rígido para laringoscópio - MD
- Lâmpada Vacuum 2.5V Rosca Pequena para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada Vacuum 2.5V Rosca Grande para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada LED 2.5V Rosca Pequena para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada LED 2.5V Rosca Grande para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada Xenon/Halógena 2.5V Rosca Pequena para Laringoscópio Convencional - MD
- Lâmpada Xenon/Halógena 2.5V Rosca Grande para Laringoscópio Convencional - MD

Especificações Elétricas

Tensão de Alimentação	- Cabo Médio: 2 Pilhas tipo C 2,5 V - Cabo Pequeno e Cabo Curto: 2 Pilhas tipo AA 2,5 V
Tipo de proteção contra choque elétrico	Energizado internamente
Grau de proteção contra choque elétrico	Tipo B
Grau de proteção contra penetração de líquidos	IPX0
Modo de operação	Contínuo
Não adequado na presença de mistura anestésica inflamável.	

Lâminas Convencional - MD Disponíveis		
Modelo	**Tamanho**	**Característica**
Macintosh	0; 1/ 2; 3; 4/ 5	• Lâmina curva • Autoclavável até 134°C por até 4.000 ciclos
Miller	00; 1/ 2; 3/ 4	• Lâmina reta • Autoclavável até 134°C por até 4.000 ciclos
McCoy Flexi-Tip	2; 3; 4	• Lâmina curva com ponta articulável • Autoclavável até 134°C por até 4.000 ciclos • Ponta articulável protegida contra bafejo • Canal da lâmina desenvolvido para melhor visualização da epiglote

Cabos Convencional Mark III Standard - MD Disponíveis	
Modelo	**Alimentação**
Cabo médio Standard Mark III tipo C 2,5V	2 pilhas Tipo C
Cabo pequeno Standard Mark III tipo AA 2,5V	2 pilhas Tipo AA
Cabo curto Standard Mark III tipo AA 2,5V	2 pilhas Tipo AA

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões Eletromagnéticas Tabela 1 – Diretrizes e declaração do fabricante Emissões Eletromagnéticas – para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS		
O Laringoscópio MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Laringoscópio MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.		
Teste de emissão	**Conformidade**	**Ambiente Eletromagnético – Orientação**
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF)	Grupo 1	O Laringoscópio MD utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e é improvável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF)	Classe B	O Laringoscópio MD é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo ambientes domésticos e locais conectados diretamente à rede elétrica de baixa tensão que fornece energia a edifícios usados para fins domésticos.
IEC 61000-3-2 - Emissões Harmônicas	Classe B	
IEC 61000-3-3 - Flutuações de tensão/ Emissões com cintilação	Conforme	

40 Medfe

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001333

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ANDRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA - M.E.		
CNPJ	06.150.367/0001-78	**Autorização**	8.08.993-8
Produto	FLUXÔMETRO		

Modelo Produto Médico
FLUXÔMETRO DE 0-15 LTS/MIN. PARA AR.
FLUXÔMETRO DE 0-15 LTS/MIN. PARA N2O.
FLUXÔMETRO DE 0-15 LTS/MIN. PARA O2.
FLUXÔMETRO DE 0-3 LTS/MIN. PARA AR.
FLUXÔMETRO DE 0-3 LTS/MIN. PARA O2.
FLUXÔMETRO DE 0-5 LTS/MIN. PARA AR.
FLUXÔMETRO DE 0-5 LTS/MIN. PARA O2.

Nome Técnico	Fluxometro
Registro	80899380001
Processo	25351.421545/2013-60
Origem do Produto	• FABRICANTE: ANDRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA USO MÉDICO LTDA - M.E. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001339

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MISSNER & MISSNER LTDA		
CNPJ	03.225.411/0001-73	**Autorização**	8.00.033-0
Produto	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA M-TEC		

Modelo Produto Médico
10cm x 10cm
10cm x 12cm
15cm x 15cm
2,7cm x 32cm
20cm x 30cm
5cm x 5cm

Nome Técnico	Curativo
Registro	80003300015
Processo	25351.046421/2018-65
Origem do Produto	• FABRICANTE: ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED - REINO UNIDO
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	30/07/2028

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 001340

36 rosa dental

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ANDREONI TÊXTIL LTDA		
CNPJ	02.520.218/0001-00	**Autorização**	1.03.681-0
Produto	GAZE HIDROFILA EM ROLO ANDREONI		

Modelo Produto Médico
PÉROLA, 11 FIOS, 91mm x 91m
PÉROLA, 13 FIOS, 91mm x 91m
PÉROLA, 9 FIOS, 91mm x 91m
RUBI, 9 FIOS, 91mm x 50m

Nome Técnico	Compressas
Registro	10368109006
Processo	25351.691509/2009-22
Origem do Produto	• FABRICANTE: ANDREONI TÊXTIL LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

25-27-34

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

001341

Nome da Empresa	CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		
CNPJ	43.512.870/0001-52	**Autorização**	1.00.141-6
Produto	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA		

Modelo Produto Médico

4,0; 4,5 ; 5,0; 5,5 ; 6,0 ; 6,5; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0; 10

Nome Técnico	Canulas
Registro	10014160051
Processo	25351.395243/2013-34
Origem do Produto	• FABRICANTE: CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001342

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		
CNPJ	43.512.870/0001-52	**Autorização**	1.00.1-1-6
Produto	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA		

Modelo Produto Médico

STANDARD, CURTA E LONGA.

Nome Técnico	Canulas
Registro	10014160039
Processo	25351.177872/2007-91
Origem do Produto	• FABRICANTE: CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Medfe

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		
CNPJ	43.512.870/0001-52	**Autorização**	1.00.141-6
Produto	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA (ACO INOX)		

Modelo Produto Médico
STANDARD, CURTA, LONGA.

Nome Técnico	Canulas
Registro	10014160040
Processo	25351.479033/2007-12
Origem do Produto	• FABRICANTE: CPL MEDICAL´S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Reimprimir
25-27-34

001343

24 Medye 001344

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA		
CNPJ	78.742.491/0001-33	**Autorização**	1.02.969-0
Produto	CANULA DE GUEDEL ADVANTIVE		

Modelo Produto Médico
Branco leitoso - 000;00;0;1;2;3;4;5;6Transparente - 000;00;0;1;2;3;4;5;6

Nome Técnico	Canulas
Registro	10296900068
Processo	25351.409913/2012-44
Origem do Produto	• FABRICANTE: Foremount Enterprise CO., Ltd - TAIWAN
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

30/05/19

Voltar

001346

19,20,21

Classmed

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	02.881.877/0001-64	Autorização	8.00.340
Produto	ATADURA GESSADA POLAR FIX		

Modelo Produto Médico

10cm x 3m; 10cm x 4m; 10cm x 4,5m; 10cm x 5m; 12cm x 3m; 12cm x 4,5m; 12cm x 5m; 15cm x 3m; 15cm x 4m; 15cm x 4,5m; 15cm x 5m; 20cm x 3m; 20cm x 4m; 20cm x 4,5m; 20cm x 5m; 6cm x 2m; 6cmx 3m; 6cm x 4m; 8cm x 2m; 8cmx 3m; 8cm x 4m.

Nome Técnico	Ataduras
Registro	8003400048
Processo	25351.634460/2011-84
Origem do Produto	• FABRICANTE: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

30/05/19

Voltar

DUOMED 18

001347

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	01.005.728/0001-79	**Autorização**	1.03.694-6
Produto	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ESPINHAL PROCARE		

Modelo Produto Médico

18G 1.29 X 90 MM QUINCKE ROSA; 19G 1.10 X 90 MM QUINCKE CREME; 20G 0.90 X 90 MM QUINCKE AMARELO; 21G 0.80 X 90 MM QUINCKE VERDE; 22G 0.70 X 90 MM QUINCKE PRETO; 23G 0.65 X 90 MM QUINCKE AZUL MARINHO; 24G 0.55 X 90 MM QUINCKE ROXO; 25G 0.50 X 90 MM QUINCKE LARANJA; 26G 0.45 X 90 MM QUINCKE MARROM; 27G 0.40 X 90 MM QUINCKE CINZA;

22 G 0.70 X 50 MM PRETO; 22 G 0.70 X 90 MM PRETO; 22 G 0.70 X 124 MM PRETO; 22 G 0.70 X 150 MM PRETO; 24 G 0.55 X 50 MM ROXO; 24 G 0.55 X 90 MM ROXO;24 G 0.55 X 101 MM ROXO; 24 G 0.55 X 124 MM ROXO;

24 G 0.55 X 150 MM ROXO; 25 G 0.50 X 50 MM LARANJA; 25 G 0.50 X 90 MM LARANJA; 25 G 0.50 X 124 MM LARANJA; 25 G 0.50 X 150 MM LARANJA; 25 G 0.50 X 160 MM LARANJA; 26 G 0.45 X 50 MM MARROM; 26 G 0.45 X 90 MM MARROM; 26 G 0.45 X 101 MM MARROM; 26 G 0.45 X 124 MM MARROM; 27 G 0.40 X 50 MM CINZA; 27 G 0.40 X 90 MM CINZA; 27 G 0.40 X 124 MM CINZA.

Nome Técnico	Agulhas
Registro	10369460118
Processo	25351.492271/2016-06
Origem do Produto	• FABRICANTE: SHANGHAI SA MEDICAL PLASTIC INSTRUMENTS CO LTDA - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	22/02/2026

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

001348

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CNPJ

01.005.728/0001-79

Endereço Completo

RUA PADRE DAMASO, Nº 173 - CENTRO CEP: 06.016-010 - OSASCO/SP

Telefone

(11) -3652-2525

Responsável Técnico

ARIANI COLOMBO DOS SANTOS

Responsável Legal

RICARDO AUGUSTO GUIDORIZZI SANCHEZ

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.03.694-6

Data do Cadastro

06/11/1998

Situação

Ativa

Nº do Processo

25000.009638/9841

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Exportar

- Correlato

Importar

- Correlato

Transportar

- Correlato

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	50.328.590/0001-54	**Autorização**	1.04.323-0
Produto	CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO		

Modelo Produto Médico

REF.: 064 CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO COM FRASCO DE PVC 250ML E PORCA EM NYLON

REF.: 064A CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO COM FRASCO DE PVC 250ML E PORCA EM METAL

REF.: 064N CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO COM COPO DE POLICARBONATO 400ML E PORCA EM NYLON

REF.: 065 CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO COM COPO DE POLICARBONATO 400ML E PORCA EM METAL

Nome Técnico	Umidificador para Terapia Intensiva
Registro	10432300011
Processo	25351.130930/2006-31
Origem do Produto	• FABRICANTE: UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE 30/05/19

Voltar

fls. 16

001350

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
CNPJ	04.890.798/0001-45	**Autorização**	8.02.052-9
Produto	ATADURA DE ALGODAO		

Modelo Produto Médico
ATADURA DE ALGODÃO BRIZA
ATADURA DE ALGODÃO ORTOFEN;ATADURA DE ALGODÃO ORTOM;ATADURA DE ALGODÃO ORTOFLEX;
ATADURA DE ALGODÃO ORTOFINO;ATADURA DE ALGODÃO DUBOM;ATADURA DE ALGODÃO ORTOFIO;
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPLAST;ATADURA DE ALGODÃO POPULAR;ATADURA DE ALGODÃO ORTOSOFT;

Nome Técnico	Ataduras
Registro	80205290002
Processo	25351.058831/2005-34
Origem do Produto	• FABRICANTE: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

14 clg Solmed

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001351

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SOLUMED MATERIAIS MÉDICOS LTDA		
CNPJ	01.000.823/0001-80	**Autorização**	8.00.191-6
Produto	SONDA PARA NUTRIÇÃO		

Modelo Produto Médico

Sonda para nutrição em poliuretano SOLUMED modelo descompressão gástrical 6FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 7FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 8FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 9FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 10FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 11FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 12FR(50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 13FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 14FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm).

Sonda para nutrição em poliuretano SOLUMED modelo enteral 6FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 7FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 8FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 9FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 10FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 11FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 12FR(50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 13FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm), 14FR (50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm).

Sonda para nutrição em poliuretano SOLUMED modelo nível da pele 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR, 24FR.

Nome Técnico	Sondas
Registro	80019160013
Processo	25351.555627/2010-56
Origem do Produto	• FABRICANTE: SOLUMED MATERIAIS MÉDICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

30/05/19

Voltar

medef. 11213

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001352

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SALDANHA RODRIGUES LTDA		
CNPJ	03.426.484/0001-23	**Autorização**	8.00.261-8
Produto	SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO E DE USO MANUAL SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SR32		

Modelo Produto Médico

MODELOS: 1. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - BICO SLIP 1ML; 2. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – BICO LOCK 1ML; 3. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - BICO SLIP 3ML; 4. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – BICO LOCK 3ML; 5. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - BICO SLIP 5 ML; 6. SERINGA SR32- SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - BICO SLIP 10ML; 7. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – BICO LOCK10ML; 8. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - BICO SLIP 20ML; 9. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – BICO LOCK20ML; 10. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - BICO SLIP 60ML; 11. SERINGA SR32 - SEM AGULHA E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA – BICO LOCK60ML;

Nome Técnico	Seringas Descartaveis
Registro	80026180052
Processo	25351.492028/2014-66
Origem do Produto	• FABRICANTE: SALDANHA RODRIGUES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE 30/05/19

Voltar

Item :12 maringá Hospitalar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001353

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SALDANHA RODRIGUES LTDA		
CNPJ	03.426.484/0001-23	**Autorização**	8.00.261-8
Produto	SERINGA DE USO ÚNICO SEM AGULHA SR		

Modelo **Produto Médico**

Seringa de uso único sem agulha SR: 0,5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml, 60ml.

Tipos de bicos das seringas: Luer slip e Luer lock para todos e ainda o modelo bico cateter para os volumes 50ml e 60ml.

Nome Técnico	Seringas Descartaveis
Registro	80026180029
Processo	25351.039209/2010-48
Origem do Produto	• FABRICANTE: SR PRODUCTOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA - PARAGUAI
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

30/05/19

Voltar

Item 10

Anvisa

001354

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SALDANHA RODRIGUES LTDA		
CNPJ	03.426.484/0001-23	**Autorização**	8.00.261-8
Produto	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA PARA INSULINA SR		

Modelo Produto Médico

Embalagem estéril contendo 01 Seringa Descartável com Agulha para Insulina, nas apresentacoes: 0,5mL (Caixa com 100 unidades) e 1mL i(Caixa com 100 unidades)

Nome Técnico	Seringas Descartaveis
Registro	80026180015
Processo	25351.010054/00-06
Origem do Produto	• FABRICANTE: SALDANHA RODRIGUES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

30/05/19 Ok

8 medej

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001355

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CONTROLES GRAFICOS DARU S.A		
CNPJ	61.793.691/0001-12	**Autorização**	1.02.932-1
Produto	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO DARU - AR COMPRIMIDO		

Modelo Produto Médico
- Cod. Daru 19.030.0310-7 - Conjunto Ar Comprimido Adulto (Conector amarelo 3/4") - extensão de 1,60m
- Cod. Daru 19.030.0320-0 - Conjunto Ar Comprimido Infantil (Conector amarelo 3/4") - extensão de 1,60m
- Cod. Daru 19.030.0370-3 - Conjunto Ar Comprimido Adulto (Conector amarela 3/4") - extensão de 2,80m
- Cod. Daru 19.030.0380-6 - Conjunto Ar Comprimido Infantil (Conector amarela 3/4") - extensão de 2,80m
PEÇAS INDIVIDUAIS: - Cod. Daru 19.030.0290-5 - Máscara Adulto - Cod. Daru 19.030.0280-2 - Máscara Infantil - Cod. Daru 19.030.0170-6 - Bocal para inalação oral - Cod. Daru 19.030.0160-3 - Micronebulizador (copinho) - Cod. Daru 19.031.0650-4 - Mangueira/extensão p/ Ar Comprimido Hospitalar – Conector Amarelo 3/4" - extensão de 1,60m - Mangueira/extensão p/ Ar Comprimido Hospitalar – Conector Amarelo 3/4" - extensão de 2,80m - Cod. Daru 19.031.0630-9 - Mangueira/extensão p/ Nebular Plus - extensão de 1,60m.

Nome Técnico	Nebulizador
Registro	10293210017
Processo	25351.743563/2013-78
Origem do Produto	• FABRICANTE: CONTROLES GRAFICOS DARU S.A - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Item: 5, 6 e 7

Mgc Hospitalar

00135

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	MED SHARP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
CNPJ	06.940.329/0001-19	**Autorização**	8.02.671-7
Produto	DRENO TORACICO MED SHARP		

Modelo Produto Médico

10FR-1,8mm-3,2mm-0,70mm/12FR-2,5mm-4,0mm-0,75mm/14FR-3,0mm-4,7mm-0,85mm/16FR-3,5mm-5,3mm-0,90mm/18FR-4,0mm-6,0mm-1,00mm/20FR-4,5mm-6, 7mm-1,10mm/22FR-5,0mm-7,3mm-1,15mm/24FR-5,5mm-8,0mm-1,25mm/26FR-6, 0mm-8, 7mm-1,35mm/28 FR-6, 5mm-9, 3mm-1,40mm/30FR-7,0mm-10,0mm-1,50mm/32 FR-7,5mm-10,7mm-1,60mm/34FR-8,0mm-11,3mm-1,65mm/36FR-8,5mm-12,0mm-1,75mm/38FR-9,0mm-12,7mm-1,85mm/40FR-9,5mm-13,3mm-1,90mm/42FR-10,0mm-14,0mm-2,00mm

Nome Técnico	Drenos
Registro	80267170002
Processo	25351.464311/2005-67
Origem do Produto	• FABRICANTE: MED SHARP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE 25/05/19.

Voltar

4 medef

00135

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME		
CNPJ	19.973.704/0001-79	**Autorização**	8.10.948-0
Produto	COLETE DORSAL TIPO KED RESGATE SP ONJ 30/05/19.		

Modelo Produto Médico
ADULTO - Comprimento 82cm e Largura 82cm INFANTIL - Comprimento 66cm e Largura 60cm Apresentado nas cores ver e azul.

Nome Técnico	Imobilizador Ortopedico
Registro	81094800003
Processo	25351.670096/2014-11
Origem do Produto	• FABRICANTE: ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

28

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001358

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	CIRUVET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		
CNPJ	54.741.095/0001-23	**Autorização**	8.05.741-8
Produto	BANDAGEM TRIANGULAR RESGATE SP		

30/05/19.

Modelo Produto Médico
BANDAGEM TRIANGULAR RESGATE SP
G - Grande
M ◆◆◆ M◆◆dio
P ◆◆◆ Pequeno

Nome Técnico	Bandagem
Registro	80574180004
Processo	25351.582733/2012-45
Origem do Produto	• FABRICANTE: CIRUVET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001359

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
CNPJ	58.268.152/0001-50	**Autorização**	1.03.048-5
Produto	Família de Instrumental Cirúrgico ABC Articulado não Cortante		

Modelo Produto Médico

ABRIDOR DE BOCA HEISTER 13CM CURVO, ABRIDOR DE BOCA HEISTER 13CM RETO, ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 11CM, ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 13CM, ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 15CM, ABRIDOR DE BOCA MC.IVOR COM SUCÇÃO 3 LÂMINAS, ABRIDOR DE BOCA MC.IVOR SEM SUCÇÃO 3 LÂMINAS, ABRE BOCA MOLT 10CM INFANTIL, ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 11CM, ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 13CM, ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 15CM; AFASTADOR ADSON 32CM, AFASTADOR ADSON BABY ARTICULADO 16CM , AFASTADOR ADSON BABY ARTICULADO 17CM, AFASTADOR ALM 4X4 AGUDO, AFASTADOR ANDERSON-ADSON CURVO 19CM, AFASTADOR ANKENEY INFANTIL, AFASTADOR ANKENEY ADULTO PEQUENO, AFASTADOR ANKENEY ADULTO MÉDIO. AFASTADOR ANKENEY ADULTO GRANDE, AFASTADOR APFELBAUM, AFASTADOR BAUFOUR ABDOMINAL COM VÁLVULA RETA 70X100, AFASTADOR BAUFOUR ABDOMINAL COM VÁLVULA CURVA 45X80, AFASTADOR BAUFOUR BABY ABDOMINAL COM VÁLVULA CURVA 20X25, AFASTADOR BECKMAN 30CM COLUNA/PULMAO/TORAX, AFASTADOR BECKMAN EATON 32CM, AFASTADOR BECKMAN-ADSON 4X4 31CM, AFASTADOR BENSAUDE ADULTO 22X70MM, AFASTADOR BENSAUDE INFANTIL 16X70MM, AFASTADOR A PITANGA Nº. 1, AFASTADOR A PITANGA Nº. 2, AFASTADOR A PITANGA Nº. 3, AFASTADOR R PITANGA Nº. 1, AFASTADOR R PITANGA Nº. 2, AFASTADOR R PITANGA Nº. 3, AFASTADOR BURFORD ESPATULAS MOVEIS, AFASTADOR CASPAR, AFASTADOR CASPAR DE CORPO VERTEBRAL, AFASTADOR CASPAR CERVICAL LONGITUDINAL, AFASTADOR CASPAR CERVICAL TRANSVERSAL, AFASTADOR CASPAR LOMBAR UNIVERSAL, AFASTADOR CASPAR LOMBAR 45MM, AFASTADOR CASPAR LOMBAR 50MM, AFASTADOR CASPAR LOMBAR 55MM, AFASTADOR CASPAR LOMBAR 60MM, AFASTADOR CASPAR LOMBAR 65MM, AFASTADOR CASTROVIEJO 8CM, AFASTADOR CLOWARD 23CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM, AFASTADOR CLOWARD 23CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM, AFASTADOR CLOWARD 25CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM, AFASTADOR CLOWARD 25CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM AFASTADOR CLOWARD INTERVERTEBRAL, AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 23CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM, AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 23CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM, AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 25CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM, AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 25CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM, AFASTADOR CLOWARD P/ VERTEBRA C/ CREMALHEIRA, AFASTADOR COLLIN 3 VALVULAS 22CM, AFASTADOR COLLIN-HARTMANN 16CM, AFASTADOR CONTRATOR BAILEY, AFASTADOR CONTRATOR BAILEY BABY, AFASTADOR CONTOUR 4X3 DENTES ROMBO CURVO 14CM, AFASTADOR P/ ESTERNO 51X76MM, AFASTADOR P/ ESTERNO 76X76MM, AFASTADOR P/ MAMÁRIA E ESTERNO COMPLETO, AFASTADOR FINOCHIETTO BABY 18X22 C/ 8CM, AFASTADOR FINOCHIETTO 40X 65 C/ 18CM, AFASTADOR FINOCHIETTO INFANTIL 12CM, AFASTADOR FINOCHIETTO MED.ESPECIAL, AFASTADOR FINOCHIETTO 25X40 C/ 13CM , AFASTADOR FINOCHIETTO 38X45 C/ 16CM, AFASTADOR FINOCHIETTO PEQ.ESPECIAL, AFASTADOR GELPI 17CM, AFASTADOR GELPI 18CM, AFASTADOR GELPI 29CM, AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 14CM, AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 16CM, AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 24CM, AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 30CM, AFASTADOR GOSSET BABY COM DUPLO BARRAMENTO 12CM, AFASTADOR HENNING 27CM, AFASTADOR HENLEY 16,5CM 3X4 DENTES, AFASTADOR HRYNTSCHAK LÂMINAS LATERAL 40X85MM E CENTRAL 35X100MM, AFASTADOR INGE 16CM

PONTA 6MM, AFASTADOR INGE 24CM PONTA 12MM, AFASTADOR JANSEN AGUDO 11CM, AFASTADOR JANSEN ROMBO 11CM, AFASTADOR LOMBAR, AFASTADOR LOMBAR TRANSVERSAL COM LÂMINAS 50,55 E 60MM, AFASTADOR LEYLA DUPLO C/ 02 BRACOS E 04 ESPÁTULAS, AFASTADOR LEYLA SIMPLES C/ 2 ESPÁTULAS, AFASTADOR DINKHUYSEN P/ MAMÁRIA E MITRAL, AFASTADOR MARKAN MEYERDING DIREITO, AFASTADOR MARKAN MEYERDING ESQUERDO, AFASTADOR MEYERDING, AFASTADOR MILLIN C/ 5 LÂMINAS ABDOMINAL E VESICAL, AFASTADOR MILLIN-BACON 24CM P/ PROSTATA, AFASTADOR MISKIMON AGUDO 35X32MM 18CM, AFASTADOR MISKIMON ROMBO 18CM, AFASTADOR OLSEN, AFASTADOR O'''''''SULLIVAN O'''''''CONOR, AFASTADOR RIGBY 18CM AGUDO, AFASTADOR RIGBY 18CM ROMBO, AFASTADOR SMITH-BUIE 15CM 23X75MM, AFASTADOR SCOVILLE COM ABERTURA 15CM C/ LÂMINAS 41X38MM E 67X44MM, AFASTADOR SCOVILLE HAVERFIELD COM ABERTURA 15CM LÂMINAS 64X25MM, 64X51MM, 67X32MM E 89X25MM, AFASTADOR SELETZ GELPI ANG. RETO, AFASTADOR VALIN, AFASTADOR WEITLANER 14CM, , AFASTADOR WEITLANER 17CM, AFASTADOR WEITLANER 21CM, AFASTADOR WEITLANER 24CM 5X6 DENTES, AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 10,5CM, AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM, AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 13,0CM, AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 16,5CM, AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM, AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 20CM, AFASTADOR WILLIANS 50X20MM, AFASTADOR WILLIANS 70X20MM, AFASTADOR WOLFF 23CM, AFASTADOR WULLSTEIN; ALICATE BOCA SERRILHADA 17CM, ALICATE BOCA SERRILHADA 19CM, , ALICATE DUPLA FORÇA BOCA SERRILHADA 17CM, ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 2MM, ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 3MM, ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 5MM,ALICATE DE PRESSAO AÇO INOX 18CM, ALICATE DE PRESSAO AÇO INOX 20CM, ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 22CM, ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 25CM, ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 30CM, ALICATE NANCE 1, ALICATE ORTODONTIA 03 PEAK, ALICATE ORTODONTIA 04 PEAK, ALICATE ORTODONTIA 104, ALICATE ORTODONTIA 107, ALICATE ORTODONTIA 109 DE LA ROSA, ALICATE 110 HOW, ALICATE 111 HOW, ALICATE JONHSON 114, ALICATE ORTODONTIA 115, ALICATE ORTODONTIA 118, ALICATE ORTODONTIA 120, ALICATE GOSLEE 121, ALICATE MC KELLOPS 128, ALICATE ORTODONTIA 137, ALICATE ANGLE 139,

ALICATE ORTODONTIA 155, ALICATE ORTODONTIA 156, ALICATE ORTODONTIA 157, ALICATE ADERER TRIDENT 200, ALICATE UNIVERSAL 325, ALICATE ORTODONTIA 345, ALICATE ORTODONTIA 347, ALICATE ORTODONTIA 350 TWEED, ALICATE ORTODONTIA 351, ALICATE ORTODONTIA 442 ANGLE, ALICATE SCHWARZ 53, ALICATE YONG 74, ALICATE ORTODONTIA 94 ADAMS, ALICATE PLANO PARALELO 18CM, ALICATE PARA REBITAR MATRIZ 141, ALICATE PARA PUXAR FIO PONTA FINA 14CM, ALICATE PARA PUXAR FIOS CHATO 17CM, ALICATE UNIVERSAL ORTOPEDIA; APROXIMADOR CONTRATOR BAILEY, APROXIMADOR CONTRATOR BAILEY-BABY, APROXIMADOR GERSTER, APROXIMADOR LEMMON; AFASTADOR BLEFAROSTATO DE COOK 4CM, AFASTADOR BLEFAROSTATO DE COOK 5CM, AFASTADOR BLEFAROSTATO GUYTON PARK, AFASTADOR BLEFAROSTATO LANCASTER, AFASTADOR BLEFAROSTATO MELLINGER, AFASTADOR BLEFAROSTATO MURDOCK, AFASTADOR BLEFAROSTATO DE PARK 8CM; BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 1, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 101, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 10H, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 10S, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 150, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 151, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 16, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 17, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 18L, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 18R, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 203, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 210, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 213, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 222, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 23, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 24, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 27, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 286, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 32, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 32A, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 44, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 53L, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 53R, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 62, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 65, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 68, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 69, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 88L, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 88R, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 99C, BOTIÇÃO FÓRCEPS ADULTO 99A, BOTIÇÃO FÓRCEPS MODELO INGLÊS INFANTIL 01, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 02, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 03, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 04, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 05, BOTIÇÃO FÓRCEPS MODELO INGLÊS INFANTIL 06, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 1, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 101, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 150-S, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 151-S, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 16-S, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 17, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 18L, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 18D, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 18R, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 21, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 23-S, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 27,

001361

BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 44, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 46, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 65, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 68, BOTIÇÃO FÓRCEPS INFANTIL 69, BOTIÇÃO FÓRCEPS 22 PAPAGAIO, BOTIÇÃO FÓRCEPS 33 PAPAGAIO, BOTIÇAO FÓRCEPS WITZEL SUPERIOR, BOTIÇAO FÓRCEPS WITZEL INFERIOR; CLAMP DE LAHEY LONGA 25CM, CLAMP NEONATAL ANGULADO 13,5CM, CLAMP NEONATAL RETO 13,5CM, DILATADOR LA-BORDE COM 3 RAMOS, DILATADOR SIMS COM 3 RAMOS, DILATADOR TROUSSEAUX COM 2 RAMOS, DILATADOR WYLIE COM 2 RAMOS UTERINO. ESPÉCULO BENSAUDE ADULTO 22X70MM, ESPÉCULO BENSAUDE INFANTIL 16X70MM, ESPÉCULO BARR RETAL 13,5CM C/ 2 PARES DE LAMINA, ESPÉCULO BIVALVE 8,5CM RETAL, ESPÉCULO ANAL DE PITANGA Nº. 1, ESPÉCULO ANAL DE PITANGA Nº. 2, ESPÉCULO ANAL DE PITANGA Nº. 3, ESPÉCULO RETAL DE PITANGA Nº. 1, ESPÉCULO RETAL DE PITANGA Nº. 2, ESPÉCULO RETAL DE PITANGA Nº. 3, ESPÉCULO COLLIN 01 C/ASPIRACAO S/CAPA, ESPÉCULO COLLIN 01 C/FIBRA OTICA, ESPÉCULO COLLIN 02 C/ASPIRACAO S/CAPA, ESPÉCULO COLLIN 02 C/FIBRA OTICA, ESPÉCULO COLLIN 03 C/ASPIRACAO S/CAPA, ESPÉCULO COLLIN 03 C/FIBRA OTICA, ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.3 GRANDE, ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.2 MEDIO, ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.1 PEQUENO, ESPÉCULO COLLIN VIRGEM C/ASPIRACAO S/CAPA, ESPÉCULO COLLIN PARA VIRGEM, ESPÉCULO CUSCO "MODELO SUÍÇO" 1 75X32MM, ESPÉCULO CUSCO "MODELO SUÍÇO" 2 85X35MM, ESPÉCULO CUSCO "MODELO SUÍÇO" 3 100X35MM, ESPÉCULO CUSCO "MODELO SUÍÇO" P/ VIRGEM 75X17MM, ESPÉCULO CUSHING CERVICAL, ESPÉCULO GRAVES, ESPÉCULO HARDY HIPÓFISE, ESPÉCULO HARTMANN 01 C/FIBRA OTICA, ESPÉCULO HARTMANN 02 C/FIBRA OTICA, ESPÉCULO HARTMANN 03 C/FIBRA OTICA, ESPÉCULO HARTMANN-HALLE 15CM Nº1, Nº2 E Nº3, ESPÉCULO KELLY RETAL, ESPÉCULO KILLIAN NASAL N.1 35MM, ESPÉCULO KILLIAN NASAL N.2 50MM, ESPÉCULO KILLIAN NASAL N.3 75MM, ESPÉCULO KILLIAN NASAL N.4 90MM, ESPÉCULO KILLIAN NASAL C/ FIBRA OPTICA Nº. 1 35MM, ESPÉCULO KILLIAN NASAL C/ FIBRA OPTICA Nº. 2 50MM, ESPÉCULO KILLIAN NASAL C/ FIBRA OPTICA Nº. 3 75MM, ESPÉCULO KILLIAN NASAL C/ FIBRA OPTICA Nº. 4 90MM, ESPÉCULO KIRSCHNER, ESPÉCULO MATHIEU RETAL TRIVALVE, ESPÉCULO PITANGA SANTOS RETAL, ESPÉCULO PRATT, ESPÉCULO RICORD RETAL 14CM, ESPÉCULO SIMS RETAL, ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº. 0 NASAL, ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº.1, ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº.2, ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº. 3, ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº. 0 NASAL, ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº.1, ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº.2, ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº.3, ESPÉCULO IVES-FRANSLER RETAL 14,5CM; ESTRIBO KIRSCHNER; FÓRCEPS LEE, FÓRCEPS KIELAND, FÓRCEPS PIPER, FÓRCEPS SIMPSON 30CM, FÓRCEPS SIMPSON 35CM; FÓRCEPS MARELLI; MICRO PORTA AGULHA BARRAQUER C/ TRAVA RETO 12CM, MICRO PORTA AGULHA BARRAQUER S/ TRAVA RETO 12CM, MICRO PORTA AGULHA BARRAQUER C/ TRAVA CURVO 12CM, MICRO PORTA AGULHA BARRAQUER S/ TRAVA CURVO 12CM, MICRO PORTA AGULHA YASARGIL CURVO BAIONETA 18CM, MICRO PORTA AGULHA YASARGIL RETO BAIONETA 18CM, MICRO PORTA AGULHA YASARGIL CURVO BAIONETA 20CM, MICRO PORTA AGULHA YASARGIL RETO BAIONETA 20CM, MICRO PORTA AGULHA YASARGYL CURVO BAIONETA 16CM, MICRO PORTA AGULHA YASARGYL RETO BAIONETA 16CM; PELVIMETRO COLLIN 35CM COM ABERTURA 50CM, PELVÍMETRO MARTIN 35CM COM ABERTURA 50CM; PINÇA ABADIE 27CM, PINÇA ABADIE/LANE 27CM, PINÇA ABADIE/LANE 30CM, PINÇA ADSON (PROTETORA DE DURA), PINÇA ALLIS BABY 12CM, PINÇA ALLIS 15CM, PINÇA ALLIS 16CM, PINÇA ALLIS 18CM, PINÇA ALLIS 20CM, PINÇA ALLIS 25CM, PINÇA ALLIS ADAIR 15CM 10X12 DENTES, PINÇA ALLIS 22CM, PINÇA AORTA CURVA 32CM, PINÇA APLICADOR TIPO SUGITA, PINÇA APLICADOR YASARGIL 18CM, PINÇA APLICADOR YASARGIL 21CM, PINÇA APLICADORA P/RETIRAR AGRAFES, PINÇA APLICADORA P/CLIPS DE RANEY, PINÇA APROXIMACAO P/SUTURA, PINÇA ASCH 23CM, PINÇA AUTO-CENTRANTE 150MM, PINÇA AUTO-CENTRANTE 160MM, PINÇA AUTO-CENTRANTE 190MM, PINÇA AUTO-CENTRANTE 240MM, PINÇA AUTO-CENTRANTE 260MM,

PINÇA AUTO-CENTRANTE 280MM, PINÇA BABCOCK 16CM, PINÇA BABCOCK 16CM T/C, PINÇA BABCOCK 20CM, PINÇA BABCOCK 20CM T/C, PINÇA BABCOCK 22CM, PINÇA BABCOCK 22CM T/C, PINÇA BABCOCK 23CM, PINÇA BABCOCK 23CM T/C, PINÇA BABCOCK 24CM, PINÇA BABCOCK 24CM T/C, PINÇA BABCOCK 26CM, PINÇA BABCOCK 26CM T/C, PINÇA BABCOCK 30CM, PINÇA BABCOCK 30CM T/C, PINÇA BABCOCK 35CM, PINÇA BABCOCK 35CM T/C, PINÇA BABY-OVERHOLT 13,5CM, PINÇA OVERHOLT 18,5CM, PINÇA BACKHAUS 08CM, PINÇA BACKHAUS 10CM, PINÇA BACKHAUS 13CM, PINÇA BACKHAUS 15CM, PINÇA BACKHAUS NAO PERFURANTE 13CM, PINÇA BAINBRIDGE 18CM CURVA, PINÇA BAINBRIDGE 18CM RETA, PINÇA BALLANTINE 21CM, PINÇA BARRETT 16CM, PINÇA BARRETT 18CM, PINÇA BECK 17CM, PINÇA BECK

001362

DE BAKEY 17CM CURVA, PINÇA BENGOLEA 22CM CURVA C/ DENTES, PINÇA BENGOLEA 22CM CURVA S/ DENTE, PINÇA BENGOLEA 22CM RETA C/ DENTES, PINÇA BENGOLEA 22CM RETA S/ DENTES, PINÇA BENGOLEA 24CM CURVA C/ DENTES, PINÇA BENGOLEA 24CM CURVA S/ DENTE, PINÇA BENGOLEA 24CM RETA C/ DENTES, PINÇA BENGOLEA 24CM RETA S/ DENTES, PINÇA BERNHARD, PINÇA BIRKETT 19CM CURVA, PINÇA BIRKETT 19CM RETA, PINÇA BIRKETT 20CM CURVA, PINÇA BIRKETT 20CM RETA, PINÇA HEMOSTÁTICA ATRAUMÁTICA BLALOCK 15CM 14MM P/ CARDIO, PINÇA HEMOSTÁTICA ATRAUMÁTICA BLALOCK 20CM 18MM P/ CARDIO, PINÇA HEMOSTÁTICA ATRAUMÁTICA BLALOCK 20CM 23MM P/ CARDIO, PINÇA BLUMENTHAL 29CM, PINÇA BOZEMANN 26CM, PINÇA BREWER 17CM, PINÇA BRUNSCHWIG 22CM CURVA, PINÇA BRUNSCHWIG 22CM RETA, PINÇA CARANGUEJO, PINÇA CARREL (REINOLDS) 11CM CURVA, PINÇA CARREL (REINOLDS) 11CM RETA, PINÇA CASTANEDA 12,5CM RETA, PINÇA CASTANEDA 12CM ANGULADA 30 GRAUS, PINÇA CASTANEDA 12CM ANGULADA 45 GRAUS, PINÇA CASTANEDA 12CM ANGULADA 90 GRAUS, PINÇA ATRAUMA CASTANEDA GRADUADA 15CM Nº. 1, PINÇA ATRAUMA CASTANEDA GRADUADA 15CM Nº. 02, PINÇA ATRAUMA CASTANEDA GRADUADA 15CM Nº. 03, PINÇA ATRAUMA CASTANEDA GRADUADA 15CM Nº. 04, PINÇA CHAPUT 14CM 2X3 DENTES, PINÇA CHEATLE, PINÇA CHERON 24CM, PINÇA CHERON 30CM, PINÇA CLAMP JOHNS HOPKINS 24,5CM, PINÇA CLAMP MIXTER 13CM, PINÇA CLAMP MULTIPURPOSE 13CM 30 GRAUS, PINÇA CLAMP MULTIPURPOSE 13CM 50 GRAUS, PINÇA CLAMP P/VEIA CAVA DE BAKEY-BECK, PINÇA CLAMP PARA ANASTOMOSE 15CM 15MM, PINÇA CLAMP PARA ANASTOMOSE 15CM 18MM, PINÇA CLAMP PARA ANASTOMOSE 15CM 22MM, PINÇA CLAMP TIPO COLHER 13CM, PINÇA CLAMP VASCULAR 35MM CURVO, PINÇA CLAMP VASCULAR 35MM RETO, PINÇA COLLER-CRILE 14CM CURVA, PINÇA COLLER-CRILE 14CM RETA, PINÇA COLLER-CRILE 16CM ANGULADA, PINÇA COLLER-CRILE 16CM CURVA, PINÇA COLLER-CRILE 16CM RETA, PINÇA COOLEY 16CM, PINÇA COLLIN 20CM PARA INSTRUMENTOS, PINÇA COLLIN 25CM PARA INSTRUMENTOS,PINÇA COLLIN 27CM P/INSTRUMENTO, PINÇA COLLIN ANEL 17CM, PINÇA COLLIN ANEL 19CM, PINÇA COLLIN ANEL 22CM, PINÇA COLLIN CORAÇÃO, PINÇA COLLIN CORACAO 16CM, PINÇA COLLIN CORACAO 18CM, PINÇA COLLIN PARA CURATIVO 25CM, PINÇA COLLIN OVAL, PINÇA COLLIN OVAL 16CM, PINÇA COLLIN OVAL 19CM, PINÇA COLLIN OVAL 22CM, PINÇA COLLIN TIRA BALA 22CM, PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA RETA, PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 15 GRAUS, PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 30 GRAUS, PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 45 GRAUS, PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA CURVA, PINÇA COOLEY CABO RETO PEDÍCULO CURTO, PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA PEDÍCULO LONGO, PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 180 GRAUS LONGA, PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 180 GRAUS CURTA, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA RETA, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 15 GRAUS, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 30 GRAUS, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 45 GRAUS, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA CURVA, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PEDÍCULO CURTO, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA PEDÍCULO LONGO, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 180 GRAUS LONGA, PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 180 GRAUS CURTA, PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA RETA, PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 15 GRAUS, PINÇA COOLEY CURVO PONTA 30 GRAUS, PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 45 GRAUS, PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA CURVA, PINÇA COOLEY CABO CURVO PEDÍCULO CURTO, PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA PEDÍCULO LONGO, PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 180 GRAUS LONGA, PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 180 GRAUS CURTA, PINÇA CRAFOORD 24CM CURVA, PINÇA CRAFOORD 24CM RETA, PINÇA CRILE 14CM CURVA, PINÇA CRILE 14CM CURVA DELICADA, PINÇA CRILE 14CM RETA, PINÇA CRILE 14CM RETA DELICADA, PINÇA CRILE 16CM CURVA, PINÇA CRILE 16CM RETA, PINÇA CRILE 18CM CURVA, PINÇA CRILE 18CM RETA, PINÇA CRILE 20CM CURVA, PINÇA CRILE 20CM RETA, PINÇA CRILE-RANKIN 16CM CURVA, PINÇA CRILE-RANKIN 16CM CURVA 1X2 DENTES, PINÇA CRILE-RANKIN 16CM RETA, PINÇA CRILE-RANKIN 16CM RETA 1X2 DENTES, PINÇA DANDY , PINÇA DARTIGUES, PINÇA DE AGARRE MILLIN 235MM, PINÇA DE AGARRE MILLIN 245MM, PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 18CM, PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 19CM, PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 23CM, PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 20CM, PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 21CM, PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 25CM, PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 27CM, PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 29CM. PINÇA DE BAKEY 21CM CURVA P/COARTACAO, PINÇA DE BAKEY 21CM RETA P/COARTACAO, PINÇA DE BAKEY 23CM CURVA P/COARTACAO, PINÇA DE BAKEY 23CM RETA P/COARTACAO, PINÇA DE BAKEY 27CM CURVA P/COARTACAO, PINÇA DE BAKEY 27CM RETA P/COARTACAO, PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 10CM CURVA 90GRAUS, PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 11CM CURVA "S", PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 12CM CURVA

PINÇA DOYEN ATRAUMA 16CM CURVA, PINÇA DOYEN ATRAUMA 18CM CURVA, PINÇA DOYEN ATRAUMA

20CM CURVA, PINÇA DOYEN ATRAUMA 21CM CURVA, PINÇA DOYEN ATRAUMA 23CM CURVA, PINÇA DOYEN ATRAUMA 16CM RETA. PINÇA DOYEN ATRAUMA 18CM RETA, PINÇA DOYEN ATRAUMA 20 RETA, PINÇA DOYEN ATRAUMA 21CM RETA, PINÇA DOYEN ATRAUMA 23CM RETA, PINÇA DOYEN-BABY 17CM CURVA, PINÇA DOYEN-BABY 17CM RETA. , PINÇA DOYEN-BABY 18CM CURVA, PINÇA DOYEN-BABY 18CM RETA, PINÇA DOYEN-BABY CURVA, PINÇA DOYEN-BABY RETA, PINÇA DUPLAY 25,5CM, PINÇA DUVAL COLLIN, PINÇA DUVAL COLLIN 22 CM T/C, PINÇA DUVAL COLLIN Nº. 1 1,2MM 22CM, PINÇA DUVAL COLLIN Nº. 2 1,8MM 22CM, PINÇA ESPANHOLA 16CM, PINÇA ESPANHOLA 22CM, PINÇA FARABEUF ROTULA/OSSOS, PINÇA FARABEUF LAMBOTTE S/CREMALHEIRA 18CM, PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 22CM C/CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 22CM S/CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 26CM C/CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 26CM S/CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 28CM C/CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 28CM S/CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF VAN BUREN 23CM, PINÇA FAURE, PINÇA FAURE 22CM CURVA ART.UTER., PINÇA FAURE 22CM RETA ART.UTER. , PINÇA FAURE 21CM CURVA ART.UTER., PINÇA FAURE 21CM RETA ART.UTER, PINÇA FAUWEL P/LARINGE, PINÇA FINOCCHIETTO 24CM PARA VESICULA, PINÇA FOERSTER 16CM CURVA, PINÇA FOERSTER 16CM CURVA LISA, PINÇA FOERSTER 16CM RETA, PINÇA FOERSTER 16CM RETA LISA, PINÇA FOERSTER 18CM CURVA, PINÇA FOERSTER 18CM CURVA LISA, PINÇA FOERSTER 18CM RETA, PINÇA FOERSTER 18CM RETA LISA, PINÇA FOERSTER 20CM CURVA, PINÇA FOERSTER 20CM CURVA LISA, PINÇA FOERSTER 20CM RETA, PINÇA FOERSTER 20CM RETA LISA, PINÇA FOERSTER 24CM CURVA, PINÇA FOERSTER 24CM CURVA LISA, PINÇA FOERSTER 24CM RETA, PINÇA FOERSTER 24CM RETA LISA, PINÇA FOERSTER 35CM RETA, PINÇA FOERSTER 35CM CURVA ,PINÇA FOERSTER BALLENGER 18CM RETA, PINÇA FOERSTER BALLENGER 24CM RETA, PINÇA FOERSTER BALLENGER 18CM CURVA, PINÇA FOERSTER BALLENGER 24CM CURVA, PINÇA FRYKHOLM 23CM, PINÇA GEMINI 13CM CURVA, PINÇA GEMINI 13CM RETA, PINÇA GEMINI 16CM CURVA, PINÇA GEMINI 16CM RETA, PINÇA GEMINI 18CM CURVA, PINÇA GEMINI 18CM RETA, PINÇA GEMINI 20CM CURVA, PINÇA GEMINI 20CM RETA, PINÇA GEMINI 22CM RETA, PINÇA GEMINI 22CM CURVA, PINÇA GEMINI 23CM RETA, PINÇA GEMINI 23CM CURVA, PINÇA GEMINI 25CM RETA, PINÇA GEMINI 25CM CURVA, PINÇA GEMINI 28CM RETA, PINÇA GEMINI 28CM CURVA,PINÇA GLOVER 6CM RETA, PINÇA GLOVER 6CM CURVA, PINÇA GLOVER 7CM RETA, PINÇA GLOVER 7CM CURVA, PINÇA GLOVER 9CM RETA, PINÇA GLOVER 9CM CURVA, PINÇA GLOVER 11CM RETA, PINÇA GLOVER 11CM CURVA, PINÇA GLOVER DE BAKEY 17CM CURVA, PINÇA GRAY 22CM PEDICULO, PINÇA GRAY 24CM PEDICULO, PINÇA GRAY 26CM PEDICULO, PINÇA GUYON 16CM, PINÇA GUYON 22CM, PINÇA GUYON 24CM, PINÇA GUYON 26CM, PINÇA HALSTEAD MOSQ.12CM C/DENTE CURVA, PINÇA HALSTEAD MOSQ.12CM C/DENTE RETA, PINÇA HALSTEAD MOSQ.MICRO 12CM CURVA, PINÇA HALSTEAD MOSQ.MICRO 12CM RETA, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM CURVA, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM RETA, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM RETA, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 18CM CURVA, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 18CM RETA, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 21CM CURVA, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 21CM RETA, PINÇA HENNING, PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO 09CM COM DENTE, PINÇA HARTMANN C/DENTE 20CM, PINÇA HARTMANN C/DENTE 25CM, PINÇA HARTMANN CLAMP INTESTINAL 20CM RETA, PINÇA HARTMANN CLAMP INTESTINAL 20CM CURVA, PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR 15CM, PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR 19CM, PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 09CM, PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 14CM, PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 15CM, PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 16,5CM, PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 20CM, PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 25CM, PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 28CM, PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM RETA, PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA CIMA, PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA/ DIREITA, PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA ESQUERDA, PINÇA HEANEY 20CM, PINÇA HEANEY 26CM, PINÇA HEANEY-BALLANTINE 21CM, PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM ANGULADA, PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM CURVA FORTE, PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM CURVA LEVE, PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM RETA PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM ANGULADA, PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM CURVA FORTE, PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM CURVA LEVE, PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM RETA, PINÇA HEISS 20CM C/DENTE CURVA, PINÇA HEISS 20CM C/DENTE RETA, PINÇA HEMOSTATICA PEAN CURVA 28CM, PINÇA HEMOSTATICA PEAN RETA 28CM, PINÇA JACARE DELICADA P/TIMPANO, PINÇA JACOBS 24CMCURVA COLO-UTERINO, PINÇA JACOBS 24CM RETA COLO-UTERINO,

00136

PINÇA JAVID 18CM P/ CARÓTIDA RETA, PINÇA JAVID 18CM P/ CAROTIDA CURVA , PINÇA JAVID 19CM P/ CARÓTIDA RETA, PINÇA JAVID 19CM P/ CAROTIDA CURVA, PINÇA JOHNS-HOPKINS 20CM, PINÇA JOHNS-HOPKINS 23CM, PINÇA JOHNS-HOPKINS 25CM, PINÇA JONES 9CM, PINÇA JONES (SPENCER-WELLS) 12,5CM CURVA, PINÇA JONES (SPENCER-WELLS) 12,5CM RETA, PINÇA JONES (SPENCER-WELLS) 15CM CURVA, PINÇA JONES (SPENCER-WELLS) 15CM RETA, PINÇA KAPP BECK RETA/ANGULADA/CURVA, PINÇA KELLY 12CM CURVA, PINÇA KELLY 12CM RETA, PINÇA KELLY 14CM CURVA, PINÇA KELLY 14CM CURVA DELICADA, PINÇA KELLY 14CM RETA,PINÇA KELLY 14CM RETA DELICADA, PINÇA KELLY 16CM CURVA, PINÇA KELLY 16CM RETA, PINÇA KELLY 18CM CURVA, PINÇA KELLY 18CM RETA, PINÇA KELLY 20CM CURVA, PINÇA KELLY 20CM RETA, PINÇA KELLY 32CM CURVA, PINÇA KELLY 32CM RETA, PINÇA KELLY-RANKIN 16CM CURVA, PINÇA KELLY-RANKIN 16CM RETA, PINÇA KOCHER 14CM CURVA, PINÇA KOCHER 14CM RETA, PINÇA KOCHER 16CM CURVA, PINÇA KOCHER 16CM RETA, PINÇA KOCHER 18CM CURVA, PINÇA KOCHER 18CM RETA, PINÇA KOCHER 20CM CURVA, PINÇA KOCHER 20CM RETA, PINÇA KOCHER 22CM CURVA, PINÇA KOCHER 22CM RETA, PINÇA KOCHER 24CM CURVA, PINÇA KOCHER 24CM RETA, PINÇA KOCHER 25CM CURVA, PINÇA KOCHER 25CM RETA, PINÇA KOCHER 26CM CURVA, PINÇA KOCHER 26CM RETA, PINÇA KOCHER 30CM CURVA, PINÇA KOCHER 30CM RETA,PINÇA KOCHER ATRAUMA 25CM CURVA, PINÇA KOCHER ATRAUMA 25CM RETA, PINÇA KOCHER ATRAUMA 28CM CURVA, PINÇA KOCHER ATRAUMA 28CM RETA, PINÇA KOCHER INTESTINAL 25CM CURVA, PINÇA KOCHER INTESTINAL 25CM RETA, PINÇA KOGAN 26CM, PINÇA CLAMP DE LAHEY 24CM 2X2, PINÇA LAHEY 16CM RETA 2X2 P/BOCIO, PINÇA LAHEY 24CM RETA 2X2 P/BOCIO PINÇA LAHEY 18CM RETA 2X2, PINÇA LAHEY 23CM RETA 2X2, PINÇA LAHEY 16CM RETA 3X3 P/BOCIO, PINÇA LAHEY 24CM RETA 3X3 P/BOCIO, PINÇA LAHEY 19CM P/ DUCTO BILIAR, PINÇA LAHEY 24CM P/ DUCTO BILIAR, PINÇA LAMBERT-KAY 21CM CORPO EM

00131

PINÇA LANE PORTA-PLACAS, PINÇA LAWRENCE 27,5CM, PINÇA LELAND JONES ANGULADA 19CM, PINÇA LERICHE 15CM CURVA, PINÇA LERICHE 15CM CURVA C/DENTE, PINÇA LERICHE 15CM RETA, PINÇA LERICHE 15CM RETA C/DENTE, PINÇA LORNA 10CM P/CAMPO, PINÇA LORNA 13CM P/CAMPO, PINÇA LOVELACE 20CM, PINÇA LOWER 18CM, PINÇA LOWMANN 12CM, PINÇA LOWMANN 13CM, PINÇA LOWMANN 15CM, PINÇA LOWMANN 17CM, PINÇA LOWMANN 18,5CM, PINÇA LOWMANN 20CM, PINÇA LUC, PINÇA MACKENZIE 15CM CURVA P/CLIPS, PINÇA MACKENZIE 18CM CURVA P/CLIPS, PINÇA MAGILL 15CM, PINÇA MAGILL 16CM, PINÇA MAGILL 18CM, PINÇA MAGILL 20CM, PINÇA MAGILL 25CM, PINÇA MAIER 26CM C/CREMALHEIRA, PINÇA MAINGOT 20CM 1X2 DENTES, PINÇA MAINGOT 25CM 1X2 DENTES,PINÇA MCGEE 0,8X3,5MM, PINÇA MCGEE 0,8X0,6MM, PINÇA MARTEL, PINÇA MARTIN 19CM, PINÇA MARTIN 21CM, PINÇA MATHIEU P/ CORPO ESTRANHO 20CM, PINÇA MATHIEU P/ CORPO ESTRANHO 25CM, PINÇA MATHIEU P/ CORPO ESTRANHO 28CM, PINÇA MAYO ROBSON 25CM CURVA, PINÇA MAYO ROBSON 25CM RETA, PINÇA MAYO-BLAKE 20CM, PINÇA MCKENZIE CURVA PARA CLIPS 18CM, PINÇA MENKEN OU KOGAN, PINÇA MENKEN 24CM C/CREMALHEIRA,PINÇA MENKEN 24CM S/CREMALHEIRA, PINÇA MENKEN 27CM C/CREMALHEIRA,PINÇA MENKEN 27CM S/CREMALHEIRA, PINÇA MICHEL PARA COLOCAR/RETIRAR AGRAFES, PINÇA MIKULICZ 20CM 1X2 DENTES, PINÇA MINI GEMINI 18CM, PINÇA MINI GEMINI 22CM, PINÇA MINI GEMINI 25CM, PINÇA MINI GEMINI 28CM, PINÇA MIXTER 17CM, PINÇA MIXTER 17CM DELICADA, PINÇA MIXTER 18CM DELICADA, PINÇA MIXTER 18CM, PINÇA MIXTER 20CM, PINÇA MIXTER 20CM DELICADA, PINÇA MIXTER 22CM, PINÇA MIXTER 22CM DELICADA, PINÇA MIXTER 24CM, PINÇA MIXTER 24CM DELICADA, PINÇA MIXTER 30CM, PINÇA MIXTER 35CM, PINÇA MIXTER BABY 14CM, PINÇA MIXTER BABY 16CM, PINÇA MIXTER O ' SHAUGNESSY 19CM, PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 10CM CURVA, PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 10CM RETA,PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 12CM CURVA, PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 12CM RETA,PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 13CM CURVA PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 13CM RETA,PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 16CM CURVA PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 16CM RETA,PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 18CM CURVA PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 18CM RETA, PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 21CM CURVA PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 21CM RETA,PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 23CM CURVA PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 23CM RETA, PINÇA MOYNIHAM 21CM, PINÇA MOYNIHAM 23CM, PINÇA MOYNIHAM 24CM, PINÇA MUSEAX CURVA, PINÇA MUSEAUX RETA, PINÇA NEGUS 20CM, PINÇA OSSEA AUTO RETENTOR 16CM, PINÇA OSSEA LEWIN 18CM, PINÇA OSSEA STEINHAUSER CURVA 13CM, PINÇA OSSEA STEINHAUSER RETA 13CM, PINÇA OSSEA ULRICH 22CM, PINÇA OSSEA ULRICH 23CM, PINÇA OSSEA ULRICH 25CM, PINÇA OSSEA ULRICH 27CM, PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 25CM, PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 26CM, PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 27CM, PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 25CM, PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 26CM, PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 27CM,

PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 25CM, PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 26CM, PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 27CM, PINÇA OVERHOLT-GEISSENDOERFER 21CM CURVA, PINÇA OVERHOLT-GEISSENDOERFER 27CM CURVA, PINÇA PALMER, PINÇA PAYR 20CM, PINÇA PAYR 29CM, PINÇA PAYR 35CM, PINÇA P/ EXTRAÇÃO DE PREGO, PINÇA DE REMOÇÃO PLATÔ TIBIAL, PINÇA DE INSERÇÃO PLATÔ TIBIAL, PINÇA PATELAR, PINÇA CLAMP PAPELAR, PINÇA P/ANASTOMOSE COOLEY PEDIATRICA 24X160MM, PINÇA P/COARTACAO DE DUTOS PEDIATRICA 52X67X170MM, PINÇA P/ ORDENHA SECREÇÃO TUBO 25CM, PINÇA P/TRANSPLANTE DE FIGADO 27CM, PINÇA P/TRANSPLANTE DE FIGADO 30CM PINÇA MOSQUITO P/VASECTOMIA LISA CURVA 12CM, PINÇA DE APREENSÃO P/ VASECTOMIA PONTA CRUZADA, PINÇA DE APREENSÃO P/ VASECTOMIA PONTA ENCAIXE, PINÇA PARA ANASTOMOSE COOLEY 44X260MM, PINÇA PARA ANASTOMOSE COOLEY 50X265MM, PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 110X300MM, PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 60X111X270MM, PINÇA PARA AORTA DE BAKEY 93X240MM, PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 130X315MM, PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANG.15GRAUS 50X165MM,PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 17CM, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM ANGULADA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM CURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM RETA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM SEMICURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM ANGULADA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM CURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM RETA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM SEMICURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM ANGULADA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM CURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM RETA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM SEMICURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM ANGULADA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM CURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM RETA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM SEMICURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM ANGULADA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM RETA, PARAMETRIAL CLAMP 30CM SEMICURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM CURVA ,PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM ANGULADA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM RETA, PARAMETRIAL CLAMP 35CM SEMICURVA, PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM CURVA, PINÇA PEAN 14CM, PINÇA PEAN 16CM, PINÇA PEAN 20CM, PINÇA PEAN 28CM, PINÇA PEAN MURPHY 14CM, PINÇA PEAN MURPHY 16CM, PINÇA PEAN MURPHY 20CM, PINÇA PELKMANN 24CM, PINÇA PENNINGTON RETA TRIANGULAR 15CM, PINÇA PENNINGTON RETA TRIANGULAR 19CM, PINÇA PENNINGTON RETA TRIANGULAR 20CM, PINÇA PHANEUF 21CM UTERINA RETA, PINÇA PHANEUF 21CM UTERINA CURVA, PINÇA PORTA CLIP DE YASARGIL,PINÇA POTTS ATRAUMA RETA 21CM, PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA P/CIMA 21CM, PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA P/BAIXO 21CM, PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA 21CM, PINÇA POTTS ATRAUMA ONDULADA 21CM, PINÇA POTTS ATRAUMA RETA 22CM, PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA P/CIMA 22CM, PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA P/BAIXO 22CM, PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA 22CM, PINÇA POTTS ATRAUMA ONDULADA 22CM, PINÇA POTTS DE BAKEY 21CM CABO ANGULADO PONTA RETA, PINÇA POTTS DE BAKEY 21CM CABO RETO PONTA ANGULADA, PINÇA POTTS DE BAKEY 22CM CABO ANGULADO PONTA RETA, PINÇA POTTS DE BAKEY 22CM CABO RETO PONTA ANGULADA, PINÇA POTTS DE BAKEY 22CM CURVA, PINÇA POTTS DE BAKEY 22CM CURVA GUYON, PINÇA POTTS SATINSKY 22CM, PINÇA POZZI 18CM, PINÇA POZZI 24CM, PINÇA PRICE THOMAS 23CM, PINÇA PROVIDENCE-HOSPITAL 13CM CURVA, PINÇA PROVIDENCE-HOSPITAL 13CM RETA, PINÇA RAMPLEY 18CM, PINÇA RAMPLEY 25CM, PINÇA RANDALL Nº.1 , PINÇA RANDALL Nº.2, PINÇA RANDALL Nº.3, PINÇA RANDALL Nº.4, PINÇA REDUCAO 13CM, PINÇA REDUCAO 20CM, PINÇA REDUTORA 16CM, PINÇA REINOLD 18CM, PINÇA REINOLD 20CM (TUBOS), PINÇA ROCHESTER CARMALT 16CM CURVA, PINÇA ROCHESTER CARMALT 16CM RETA, PINÇA ROCHESTER CARMALT 18CM CURVA, PINÇA ROCHESTER CARMALT 18CM RETA, PINÇA ROCHESTER CARMALT 20CM CURVA, PINCA ROCHESTER CARMALT 20CM RETA, PINCA ROCHESTER CARMALT 22CM CURVA, PINCA ROCHESTER CARMALT 22CM RETA, PINCA ROCHESTER CARMALT 24CM CURVA, PINCA ROCHESTER CARMALT 24CM RETA,

0013

001366

PINÇA ROCHESTER PEAN 16CM CURVA, PINÇA ROCHESTER PEAN 16CM RETA, PINÇA ROCHESTER PEAN 18CM CURVA, PINÇA ROCHESTER PEAN 18CM RETA, PINÇA ROCHESTER PEAN 20CM CURVA, PINÇA ROCHESTER PEAN 20CM RETA, PINÇA ROCHESTER PEAN 22CM CURVA, PINÇA ROCHESTER PEAN 22CM RETA, PINÇA ROCHESTER PEAN 24CM CURVA, PINÇA ROCHESTER PEAN 24CM RETA, PINÇA ROCHESTER PEAN 30CM CURVA, PINÇA ROCHESTER PEAN 30CM RETA, PINÇA ROCHESTER PEAN 26CM CURVA, PINÇA ROCHESTER PEAN 26CM RETA, PINÇA ROGGE 25CM, PINÇA ROWE DIREITA 23CM, PINÇA ROWE ESQUERDA 23CM,PINÇA SACA TROMBO 28CM, PINÇA SATINSKY BABY SERRA CRUZADA 12CM, PINÇA SATINSKY BABY SERRA CRUZADA 15CM, PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 18CM, PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 20CM, PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 22CM, PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 24CM, PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 26CM PINÇA ATRAUMATICA SATINSKY 12CM, PINÇA ATRAUMATICA SATINSKY 16CM, PINÇA SATINSKY ATRAUMATICA 20CM, PINÇA SATINSKY ATRAUMATICA 24CM, PINÇA ATRAUMATICA SATINSKY 26CM, PINÇA SATINSKY DE BAKEY 16CM, PINÇA SATINSKY DE BAKEY 20CM, PINÇA SATINSKY DE BAKEY 24CM, PINÇA SATINSKY DE BAKEY 27CM PINÇA SCHLESINGER 15,2CM PONTA 2X10MM, PINÇA SCHLESINGER 15,2CM PONTA 3X10MM, PINÇA SCHLESINGER 15,2CM PONTA 4X10MM, PINÇA SCHIMIDT 18CM CURVA, PINÇA SCHIMIDT 18CM RETA, PINÇA SCHROEDER RETA 2X2 25CM, PINÇA SCOOB-ALLIS 20CM, PINÇA SEMB CARDIO 23CM Nº1 E Nº2, PINÇA SNELLEN 9CM DIREITA, PINÇA SNELLEN 9CM ESQUERDA, PINÇA SKILLMAN 12CM CURVA, PINÇA SKILLMAN 12CM RETA, PINÇA SPENCER-WELLS 13CM RETA, PINÇA SPENCER-WELLS 17CM RETA, PINÇA SPENCER-WELLS 13CM CURVA, PINÇA SPENCER-WELLS 17CM CURVA, PINÇA STIEGLITZ 15CM RETA, PINÇA STIEGLITZ 15CM 45 GRAUS, PINÇA STIEGLITZ 15CM 90 GRAUS,PINÇA STIEGLITZ 20CM RETA, PINÇA STIEGLITZ 20CM 45 GRAUS, PINÇA STIEGLITZ 20CM 90 GRAUS, PINÇA STIEGLITZ 23CM RETA, PINÇA STIEGLITZ 23CM 45 GRAUS, PINÇA STIEGLITZ 23CM 90 GRAUS, PINÇA SUBRAMANIAN-MINIATURA

PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO SEM TRAVA, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO COM TRAVA, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO SEM TRAVA, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO COM TRAVA, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO SEM TRAVA, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO COM TRAVA, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO SEM TRAVA, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO COM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO SEM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO COM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO SEM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO COM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO SEM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO COM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO SEM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO COM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO SEM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO COM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO SEM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO COM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO SEM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO COM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO SEM TRAVA T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO BIARTICULADO CABO REDONDO COM TRAVA 22CM, PORTA AGULHA CASTROVIEJO BIARTICULADO CABO REDONDO SEM TRAVA 22CM, PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 14CM, PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 14CM T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 18CM, PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 18CM T/C, PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 21CM, PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 21CM T/C, PORTA AGULHA CONVERSE 15CM, PORTA AGULHA CONVERSE 16CM, PORTA AGULHA CRILE MURRAY 15CM, PORTA AGULHA CRILE WOOD 15CM, PORTA AGULHA CRILE WOOD 16CM, PORTA AGULHA CRILE WOOD 18CM, PORTA AGULHA DERF 12CM, PORTA AGULHA DERF 12CM T/C, PORTA AGULHA ERMOLD 18CM, PORTA AGULHA ERMOLD 20CM, PORTA AGULHA FINOCHIETTO 22CM CURVO T/C, PORTA AGULHA GILETTE CASTROVIEJO FINO, PORTA AGULHA GILETTE CASTROVIEJO GROSSO, PORTA AGULHA GILLIES T/C, PORTA AGULHA HALSEY 13CM, PORTA AGULHA HEANEY 20CM CURVO, PORTA AGULHA HEANEY 23CM CURVO, PORTA AGULHA HEANEY 25CM CURVO, PORTA AGULHA HEANEY 26CM CURVO, PORTA AGULHA HEANEY 20CM CURVO T/C , PORTA AGULHA HEANEY 23CM CURVO T/C, PORTA AGULHA HEANEY 25CM CURVO T/C, PORTA AGULHA HEANEY 26CM CURVO T/C, PORTA AGULHA HELLBERG T/C, PORTA AGULHA HODLICK 18CM, PORTA AGULHA KILNER 13CM, PORTA AGULHA KILNER 13CM T/C, PORTA AGULHA KILNER 15CM, PORTA AGULHA KILNER 15CM T/C, PORTA AGULHA KILNER 18CM, PORTA AGULHA KILNER 18CM T/C, PORTA AGULHA MC

PHERSON CURVO, PORTA AGULHA MC PHERSON RETO, PORTA AGULHA MASSON 26CM, PORTA AGULHA MASSON 26CM T/C, PORTA AGULHA MASSON 28CM, PORTA AGULHA MASSON 28CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 11CM, PORTA AGULHA MATHIEU 11CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, PORTA AGULHA MATHIEU 14CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 15CM, PORTA AGULHA MATHIEU 15CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 16CM, PORTA AGULHA MATHIEU 16CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 17CM, PORTA AGULHA MATHIEU 17CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 18CM, PORTA AGULHA MATHIEU 18CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 20CM, PORTA AGULHA MATHIEU 20CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 25CM, PORTA AGULHA MATHIEU 25CM T/C, PORTA AGULHA MATHIEU 30CM, PORTA AGULHA MATHIEU 30CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 30CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 30CM T/C, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 35CM, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 35CM T/C, PORTA AGULHA NEIVERT 13CM, PORTA AGULHA OLSEN HEGAR T/C 14CM, PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 16CM, PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 19CM, PORTA AGULHA FIO DE ACO 20CM, PORTA AGULHA FIO DE ACO 16CM T/C, PORTA AGULHA FIO DE ACO 19CM T/C, PORTA AGULHA FIO DE ACO 20CM T/C, PORTA AGULHA REHBEIN-BABY 11,5CM, PORTA AGULHA REHBEIN-BABY 14CM, PORTA AGULHA SAROT 17CM T/C, PORTA AGULHA SAROT 20CM T/C PORTA AGULHA STERNAL PARA FIO DE AÇO 18CM, PORTA AGULHA STRATTE 23CM T/C, PORTA AGULHA VASCULAR 18CM CURVO, PORTA AGULHA VASCULAR 18CM RETO, PORTA AGULHA WANGENSTEEN 27CM, PORTA AGULHA WEBSTER WRIGHT 12,5CM, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM CURVO C/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM CURVO S/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM RETO C/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM RETO S/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM CURVO C/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM CURVO S/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL JACOBSON) 18CM RETO C/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL JACOBSON) 18CM RETO S/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM CURVO C/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM CURVO S/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM RETO C/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM RETO S/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM CURVO C/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM CURVO S/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL JACOBSON) 22,5CM RETO C/ TRAVA, PORTA AGULHA YASARGIL JACOBSON) 22,5CM RETO S/ TRAVA, PORTA AGULHA P/ CORONÁRIA 17CM T/C, PORTA AGULHA P/ CORONÁRIA 20CM T/C, PORTA AGULHA MICRO VASCULAR DELICADO 18CM T/C, PORTA AGULHA MICRO VASCULAR DELICADO 20CM T/C, PORTA AGULHA MICRO VASCULAR DELICADO 23CM T/C, PORTA AGULHA WEBSTER, PORTA AMÁLGAMA ADULTO, PORTA AMÁLGAMA INFANTIL; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO, PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL; SACA PRÓTESES COM 5 PONTAS 19CM; VÁLVULA GINECOLÓGICA AUVARD COM PESO;

00136

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	10304850070
Processo	25351.414765/2011-04
Origem do Produto	• FABRICANTE: SURGIVET INSTRUMENTS CO - PAQUISTÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

001368

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda

Estrada Boa Esperança, 2320
Fundo Canoas - CEP: 89.163-554

RIO DO SUL - SC

001363

Registros ANVISA

FONE: +55 (47) 3520-9000
Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas
RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.163-554
CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.899-5
Fax: +55 (47) 3520 9004

www.altermed.com.br /Altermed

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 2

001370

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME		
CNPJ	19.973.704/0001-79	**Autorização**	8.10.948-0
Produto	BANDAGEM TRIANGULAR RESGATE SP		

Modelo Produto Médico
P - pequeno - 0,70m x 0,70m x 1,00m M - médio - 1,00m x 1,00m x 1,40m G - grande - 1,40m x 1,40m x 2,00m

Nome Técnico	Bandagem
Registro	81094800001
Processo	25351.668885/2014-55
Origem do Produto	• FABRICANTE: ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 4

001371

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME		
CNPJ	19.973.704/0001-79	**Autorização**	8.10.948-0
Produto	COLETE DORSAL TIPO KED RESGATE SP		

Modelo Produto Médico
ADULTO - Comprimento 82cm e Largura 82cm INFANTIL - Comprimento 66cm e Largura 60cm Apresentado nas cores ver e azul.

Nome Técnico	Imobilizador Ortopedico
Registro	81094800003
Processo	25351.670096/2014-11
Origem do Produto	• FABRICANTE: ORTOFEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA.-ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

6,7

001372

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		
CNPJ	47.193.115/0001-03	**Autorização**	1.02.296-5
Produto	DRENO TORACICO LAC MEDICAL		

Modelo Produto Médico
Embalagem contendo 01 Dreno Toracico Lac Medical, esterilizado a Oxido de Etileno, com Diametro de 06 a 40, Comprimento de 35cm a 1,00m

Nome Técnico	Drenos
Registro	10229650022
Processo	25351.001822/0087
Origem do Produto	• FABRICANTE: CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

001373

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 8

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	CONTROLES GRAFICOS DARU S.A		
CNPJ	61.793.691/0001-12	**Autorização**	1.02.932-1
Produto	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO DARU - AR COMPRIMIDO		

Modelo Produto Médico
- Cod. Daru 19.030.0310-7 - Conjunto Ar Comprimido Adulto (Conector amarelo 3/4") - extensão de 1,60m
- Cod. Daru 19.030.0320-0 - Conjunto Ar Comprimido Infantil (Conector amarelo 3/4") - extensão de 1,60m
- Cod. Daru 19.030.0370-3 - Conjunto Ar Comprimido Adulto (Conector amarela 3/4") - extensão de 2,80m
- Cod. Daru 19.030.0380-6 - Conjunto Ar Comprimido Infantil (Conector amarela 3/4") - extensão de 2,80m
PEÇAS INDIVIDUAIS: - Cod. Daru 19.030.0290-5 - Máscara Adulto - Cod. Daru 19.030.0280-2 - Máscara Infantil - Cod. Daru 19.030.0170-6 - Bocal para inalação oral - Cod. Daru 19.030.0160-3 - Micronebulizador (copinho) - Cod. Daru 19.031.0650-4 - Mangueira/extensão p/ Ar Comprimido Hospitalar – Conector Amarelo 3/4" - extensão de 1,60m - Mangueira/extensão p/ Ar Comprimido Hospitalar – Conector Amarelo 3/4" - extensão de 2,80m - Cod. Daru 19.031.0630-9 - Mangueira/extensão p/ Nebular Plus - extensão de 1,60m.

Nome Técnico	Nebulizador
Registro	10293210017
Processo	25351.743563/2013-78
Origem do Produto	• FABRICANTE: CONTROLES GRAFICOS DARU S.A - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 9 001375

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
CNPJ	58.268.152/0001-50	**Autorização**	1.03.048-5
Produto	INSTRUMENTAL CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE		

Modelo Produto Médico

AGULHA REVERDIN Nº.1 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.2 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.3 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.4 23CM; ALICATE AINSWORTH; ALICATE BERNARDINHO 30CM T/C; ALICATE BERNARDINHO 47CM T/C; ALICATE BERNARDÃO 55CM T/C; ALICATE BETHUNE 34CM; ALICATE CORTA PINO INTERCAMBEÁVEL 57,5CM; ALICATE CORTA FIO 14CM ATÉ 0,8MM T/C; ALICATE CORTE DISTAL 154; ALICATE CORTE DISTAL T/C; ALICATE P/ CORTE CINTA DE ESTERNO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO T/C; ALICATE CORTE FRONTAL T/C; ALICATE CORTE FRONTAL 16CM; ALICATE CORTE LATERAL P/ OSSO; ALICATE CORTE LATERAL 12CM; ALICATE DUPLA FORÇA 15CM; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM; ALICATE Nº.141; ALICATE DUPLA FORÇA 18CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 25CM T/C; ALICATE P/ CORTE DE ANEL; ALICATE REIL T/C; ALICATE RUSKIN; ALICATE SEGURA E CORTA 16CM T/C; ALICATE SEGURA E CORTA 20CM T/C; ALICATE STEIMAN 30CM T/C; ALICATE STEIMAN 45CM T/C; ALICATE STEIMAN 60CM T/C; ALICATE TURQUESA CORTADOR T/C; ALICATE UNIVERSAL P/ GIRAR FIO C/ CORTE; ALICATE UNIVERSAL ORTODONTIA; AMIGDALOTOMO SLUDER BALENGER 3 FACAS; CIZALHA BEYER P/OSSO; CIZALHA LISTON RETA; CIZALHA LISTON CURVA;CIZALHA LISTON RETA 14CM; CIZALHA LISTON CURVA 14CM; CIZALHA LISTON RETA 17CM; CIZALHA LISTON CURVA 17CM; CIZALHA LISTON RETA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 19CM; CIZALHA LISTON ANGULADA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON MINI RETA 15CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA LISTON-KEY 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON-KEY 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LUER GOIVA CURVA; CIZALHA LUER GOIVA RETA;CIZALHA LUER GOIVA CURVA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA CURVA 17CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 17CM; CIZALHA MINI LISTON ANGULADA 15CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.CURVA 18CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.RETA 18CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM T/C; CIZALHA CURVA 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM;CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C;CIZALHA SEMB 23CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 23CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA SEUTIN 21CM; CIZALHA SEUTIN 23CM; CIZALHA STILLE 18CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 20CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA STILLE 26CM DUPLA

001374

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 9 001375

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
CNPJ	58.268.152/0001-50	**Autorização**	1.03.048-5
Produto	INSTRUMENTAL CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE		

Modelo Produto Médico

AGULHA REVERDIN Nº.1 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.2 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.3 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.4 23CM; ALICATE AINSWORTH; ALICATE BERNARDINHO 30CM T/C; ALICATE BERNARDINHO 47CM T/C; ALICATE BERNARDÃO 55CM T/C; ALICATE BETHUNE 34CM; ALICATE CORTA PINO INTERCAMBEÁVEL 57,5CM; ALICATE CORTA FIO 14CM ATÉ 0,8MM T/C; ALICATE CORTE DISTAL 154; ALICATE CORTE DISTAL T/C; ALICATE P/ CORTE CINTA DE ESTERNO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO T/C; ALICATE CORTE FRONTAL T/C; ALICATE CORTE FRONTAL 16CM; ALICATE CORTE LATERAL P/ OSSO; ALICATE CORTE LATERAL 12CM; ALICATE DUPLA FORÇA 15CM; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM; ALICATE Nº.141; ALICATE DUPLA FORÇA 18CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 25CM T/C; ALICATE P/ CORTE DE ANEL; ALICATE REIL T/C; ALICATE RUSKIN; ALICATE SEGURA E CORTA 16CM T/C; ALICATE SEGURA E CORTA 20CM T/C; ALICATE STEIMAN 30CM T/C; ALICATE STEIMAN 45CM T/C; ALICATE STEIMAN 60CM T/C; ALICATE TURQUESA CORTADOR T/C; ALICATE UNIVERSAL P/ GIRAR FIO C/ CORTE; ALICATE UNIVERSAL ORTODONTIA; AMIGDALOTOMO SLUDER BALENGER 3 FACAS; CIZALHA BEYER P/OSSO; CIZALHA LISTON RETA; CIZALHA LISTON CURVA;CIZALHA LISTON RETA 14CM; CIZALHA LISTON CURVA 14CM; CIZALHA LISTON RETA 17CM; CIZALHA LISTON CURVA 17CM; CIZALHA LISTON RETA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 19CM; CIZALHA LISTON ANGULADA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON MINI RETA 15CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA LISTON-KEY 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON-KEY 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LUER GOIVA CURVA; CIZALHA LUER GOIVA RETA;CIZALHA LUER GOIVA CURVA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA CURVA 17CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 17CM; CIZALHA MINI LISTON ANGULADA 15CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.CURVA 18CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.RETA 18CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM T/C; CIZALHA CURVA 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM;CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C;CIZALHA SEMB 23CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 23CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA SEUTIN 21CM; CIZALHA SEUTIN 23CM; CIZALHA STILLE 18CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 20CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA STILLE 26CM DUPLA

ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 37CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 26CM; CIZALHA STILLE 37CM;CIZALHA STILLE LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY DUPLA ARTICULAÇÃO RETA 27CM; CIZALHA STILLE LISTON KEY DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA 27CM; CIZALHA STILLE LUER CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LUER RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LUER DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA 23CM; CIZALHA STILLE LUER DUPLA ARTICULAÇÃO RETA 23CM; CIZALHA STILLE-HORSLEY 23CM; CIZALHA STILLE MINI 20CM; CIZALHA VILBISS 21CM; CORTADOR DE FIOS 14CM; CORTADOR DE VILBISS; COSTOTOMO BRUNNER 28CM; COSTOTOMO DE COLLIN; COSTOTOMO DE COLLIN 19CM; COSTOTOMO COLLIN 20CM; COSTOTOMO GIERTZ STILLE 27CM; COSTOTOMO DE GLUCK 19CM; COSTOTOMO DE GLUCK 22CM; COSTOTOMO MODELO SIMPLES; COSTOTOMO SAUERBRUCH; COSTOTOMO SAUERBRUCH 23CM; COSTOTOMO SAUERBRUCH 26CM; FACA DE BLAIR P/ ENXERTO DE PELE 4"; FACA DE BLAIR P/ ENXERTO DE PELE 6"; MICRO TESOURA CURVA DIREITA ANGULO 60 GRAUS; MICRO TESOURA CURVA ESQUERDA ANGULO 60 GRAUS; MICRO TESOURA JACOBSON RETA 18CM; MICRO TESOURA JACOBSON CURVA 18CM; MICRO TESOURA JACOBSON RETA 16CM; MICRO TESOURA JACOBSON CURVA 16CM; MICRO TESOURA NOYES RETA 12CM; MICRO TESOURA NOYES CURVA 12CM; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 18CM PONTA CURVA; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 18CM PONTA RETA;MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 20CM PONTA CURVA; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 20CM PONTA RETA; MICRO TESOURA YASARGIL CURVA 18CM; MICRO TESOURA YASARGIL RETA 18CM; MICRO TESOURA YASARGIL RETA 16CM; MICRO TESOURA YASARGIL CURVA 16CM; PERFURADOR AINSWORTH ESPECIAL; PERFURADOR DE COSTELA; PERFURADOR HUDSON COMPLETO; PERFURADOR SMELLIE; PINÇA ASCH 23CM; PINÇA ALEXANDER; PINÇA BACK BITE 360° INFANTIL; PINÇA BACK BITE 360°; PINÇA BACK BITE RETA INFANTIL; PINÇA BACK BITE RETA; PINÇA BAKEY BECK 20CM PONTA 65X30MM; PINÇA BAKEY BECK 21CM PONTA 80X45MM; PINÇA BAILEY PITUITÁRIA25°; PINÇA BAILEY PITUITÁRIA RETA, PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 25CM;PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 25CM;PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 25CM;PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI- TOWNSEND 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-TOWNSEND 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI- TOWNSEND 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 25CM; PINÇA BIOPSIA TISCHLER 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA TISCHLER 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BABY-TISCHLER 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BABY-TISCHLER 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA KEVORKIAN 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA KEVORKIAN 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BURKE 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BURKE 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA MINI-TOWNSEND 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA MINI-TOWNSEND 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA EPPENDORF 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA EPPENDORF 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BAGGISH 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BAGGISH 20CM SEM TRAVA; PINÇA BEYER DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA; PINÇA BEYER SACA BOCADO; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO RETA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA P/CIMA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA/ DIREITA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA/ESQUERDA; PINÇA BOHLER RETA; PINÇA BOHLER CURVA; PINÇA BRAUM; PINÇA BRUENINGS Nº1; PINÇA BRUENINGS Nº2;PINÇA CLEVELAND; PINÇA COLCLOUGH 40º 3MM 15CM; PINÇA

COLCLOUGH 40° 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 18CM; PINÇA OLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 20CM; PINÇA COTTLE WALSHAN DIREITA; PINÇA COTTLE WALSHAN ESQUERDA; PINÇA COTTLE WALSHAN RETA; PINÇA CRANEOCLASTO DE BRAUN 42CM; PINÇA CLAMP 160MM; PINÇA CLAMP 220MM; PINÇA CHEVALIER JACKSON 40CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON 50CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 30CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 40CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 50CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON TIPO JACARÉ 40CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON TIPO JACARÉ 50CM; PINÇA CITELLI; PINÇA DUCK BILL GOIVA; PINÇA DUCK BILL 3MM; PINÇA DUCK BILL 8MM;PINÇA CITELLI CAVIDADE 14CM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 1,5MM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 2,5MM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 4,0MM;PINÇA CITELLI SACA-BOCADO 20CM; PINÇA CLOWARD HAPPER ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA CLOWARD HAPPER ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA CLOWARD HAPPER RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA CLOWARD HAPPER RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE COM CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE SEM CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF VAN-BUREN; PINÇA FAURE; PINÇA FAURE 21CM; PINÇA FAURE 24CM; PINÇA FERGUSSON; PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P/ CIMA, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P/ BAIXO, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA 40°, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA P/ CIMA, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA P/ BAIXO, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA 40°,PINÇA BIOPSIA GAYLOR 24CM; PINÇA BIOPSIA GELLHORN 24CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1,0MM RETA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA CIMA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM RETA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA ANGULADA DUPLA ARTICULAÇÃO, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA CURVA PARA ESQUERDA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA CURVA PARA DIREITA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA ANGULADA 45°, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA RETA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 7MM X 2MM, ABERTURA PARA CIMA, COMPRIMENTO 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA INDIRETA CONCHA RETANGULAR DE 5MM CURVA PARA BAIXO 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA ESQUERDA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA CIMA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM, CURAVA PARA BAIXO 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM, CURVA PARA DIREITA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA PARA ESQUERDA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA DIREITA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA PARA CIMA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR GIRATÓRIA 360° 5MM X 1MM DE 25CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 2,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 4,8MM. 10CM; PINÇA CORTANTE

ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA CONCHA OVAL LONGA 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2MM, DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO DELICADA 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 2,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 4,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA, EXTRA DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM COM ASPIRAÇÃO11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2MM, DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO, DELICADA 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 60°, CONCHA OVAL LONGA DE 6MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA TIPO SETA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA TIPO SETA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA TIPO COLHER 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA TIPO COLHER 11CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO POR PINO DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO POR PINO DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL, DE 2MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA ESQUERDA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA DIREITA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA CIMA DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA ESQUERDA, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA DIREITA, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, RETA, CORTE PARA CIMA DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CORTE PARA ESQUERDA DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CORTE PARA

DIREITA, DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CURVO, CORTE PARA CIMA, DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, RETA, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CORTE PARA ESQUERDA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CORTE PARA DIREITA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CURVO, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA GOIVA BACON; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 25°; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 45°; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 90°; PINÇA GOIVA BIARTICULADA STILLE RUSKIN 24CM 8MM; PINÇA GOIVA CURVA ART.SIMPLES 2MM 17CM; PINÇA GOIVA CURVA ART.SIMPLES 5MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA DUPLA ART.RUSKIN MINI 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA GEIGER 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA KLEINERT KUTZ 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA RUSKIN-MINI 15CMX02MM; PINÇA GOIVA DUPLA ART MINI RUSKIN 2MM RETA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART MINI RUSKIN 3MM RETA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 2MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 3MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 5MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.MINI RUSKIN 2MM CURVA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.RUSKIN 5MM RETA 24CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.RUSKIN 5MM CURVA 24CM; PINÇA GOIVA JANSEN MIDDLETON; PINÇA GOIVA LEKSELL CORTE 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL CORTE 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE; PINÇA GOIVA LEMPERT CURVA; PINÇA GOIVA LEMPERT RETA; PINÇA GOIVA LUER-FRIEDMANN; PINÇA GOIVA MAYFIELD CURVA 19CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA; PINÇA GRUENWALD BOCA RETA; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO 26CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA 26 CM; PINÇA GRUENWALD BOCA RETO 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA RETO 26CM; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM; PINÇA HAJEK-CLAUSS; PINÇA HARTMANN AURICULAR CORTANTE N°2; PINÇA HARTMANN AURICULAR CORTANTE N°3; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°1; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°2; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°3;PINÇA HARTMANN COM DENTE N°4; PINÇA HARTMANN HOFFMANN N°1; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 5MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 7MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 9MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 11MM; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°1; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°2; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°3; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°4; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°5; PINÇA HEISS CARDIO; PINÇA HOUSE-DIETER BOCA P/ BAIXO; PINÇA HOUSE-DIETER BOCA P/ CIMA; PINÇA JANSEN RETA; PINÇA JANSEN CURVA, PINÇA JURASZ P/ DIREITA 19CM; PINÇA JURASZ P/ ESQUERDA 19CM; PINÇA JURASZ P/ CIMA 19CM; PINÇA JURASZ P/ BAIXO 19CM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 6MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM; PINÇA KERRISON RETA 90

GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 2MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 3MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 1MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 5MM; PINÇA KERRISON BOCA 4X4MM; PINÇA KERRISON BOCA 5X5MM; PINÇA KERRISON BOCA 6X6MM;PINÇA KERRISON C/TRAVA T/C; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 8MM; PINÇA LAMBOTTE 21CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LAMBOTTE 26CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LAMBOTTE 31CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LANE COM CREMALHEIRA; PINÇA LANE SEM CREMALHEIRA; PINÇA LEKSELL EM ÂNGULO; PINÇA LEKSELL 23CM;

PINÇA LEKSELL 24CM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 8MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 3X5MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 1X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 3X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 4X10MM; PINÇA LUC CORTANTE NASAL; PINÇA LUER GOIVA CURVA 16CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 16CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 17CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 17CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 18CM SIMPLES;PINÇA LUER GOIVA RETA 18CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 20CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 20CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA LUER GOIVA CURVA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA MATHIEU 20CM; PINÇA MATHIEU 25CM; PINÇA MATHIEU 28CM; PINÇA MARTEL; PINÇA OLDBERG BOCA REDONDA; PINÇA OLIVECRONA 20CM; PINÇA P/ BIOPSIA WITTNER RETA 21CM; PINÇA P/ BIOPSIA WITTNER CURVA 21CM; PINÇA P/ BIOPSIA SCHULZ FLEXIVEL 3X510MM; PINÇA PROF°.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 1MM; PINÇA PROF°.MEDINA P/ BIOPSIA

24CM 2MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 3MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 4MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 5MM;PINÇA ROWE DIREITA; PINÇA ROWE ESQUERDA; PINÇA GOIVA RUSKIN RETA 23CM; PINÇA GOIVA RUSKIN CURVA 23CM; PINÇA RUSKIN DUPLA ARTICULAÇÃO RETA; PINÇA RUSKIN DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM 3MM; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM 5MM; PINÇA SACA-CALCIO P/CIMA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO P/DIREITA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO P/ESQUERDA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO RETA 20CM; PINÇA SCHUBERT P/ BIOPSIA 23,5CM ANGULADA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 21CM RETA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 23,5CM RETA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 29CM RETA; PINÇA SCHUBERT; PINÇA SCHUMACHER; PINÇA SEMB; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 18CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 18CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 18CM; PINÇA STILE-LISTON 23CM CURVA; PINÇA STILE-LISTON 23CM RETA; PINÇA STILLE-LISTON 27CM CURVA; PINÇA STILLE-LISTON 27CM RETA; PINÇA STILLE LUER 23CM ANGULADA; PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 27CM; PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 27CM; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°1; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°2; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°3; PINÇA STRUYCKEN ANGULADA; PINÇA STRUYCKEN INFANTIL ANGULADA; PINÇA STRUYCKEN INFANTIL RETA; PINÇA STRUYCKEN RETA; PINÇA TAKAHASHI BOCA RETA; PINÇA TAKAHASHI BOCA P/ CIMA; PINÇA TAKAHASHI DELICADA 12CM; PINÇA TAKAHASHI DELICADA 19CM; PINÇA THOMAS-GAYLOR; PINÇA VAN DOREN 24CM BIOPSIA; PINÇA WATSON-WILLIAN NASAL COM SERRILHA; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°6; PINÇA YEOMAN 28CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 28CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 35CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 35CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 20CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 20CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 25CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 25CM BOCA ARREDONDADA; PORTA AGULHA CRILE WOOD 15CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA GILLIES 16CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA OLSEN HEGAR 14CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA OLSEN HEGAR 16CM T/C; PORTA AGULHA P/ FIO DE AÇO BERRY 20CM; SACA-PROTESE C/3 PONTAS; SACA-PROTESE IMPLES; SERRA NÓ BRUENINGS C/ CREMALHEIRA; SERRA-NO EVES S/CREMALHEIRA 28CM; SERRA-NO KRAUSE; SERRA NÓ WILDE; TESOURA BALIU; TESOURA BARRAQUER; TESOURA BECKER-CAPLAN P/ SEPTO; TESOURA BELLUCCI MICRO RETA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/CIMA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/DIREITA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/ESQUERDA; TESOURA BOETTCHER 18CM; TESOURA BOYD 14CM CURVA; TESOURA BOYD 14CM CURVA T/C; TESOURA BOYD 18CM CURVA; TESOURA BOYD 18CM CURVA T/C; TESOURA BOYD 20CM CURVA; TESOURA BOYD 20CM CURVA T/C; TESOURA BRAUN-STADLER 14,5CM; TESOURA BRAUN-STADLER 16CM; TESOURA BRAUN-STADLER 20CM; TESOURA BRAUN-STADLER 22CM; TESOURA CALCIFRED CURVA SERRILHADA 23CM; TESOURA CALCIFRED T/C 23CM; TESOURA CALCIFRED; TESOURA CASTROVIEJO CURVA; TESOURA CASTROVIEJO DIREITA; TESOURA CASTROVIEJO ESQUERDA; TESOURA CASTROVIEJO P/ SINECHIA; TESOURA CASTROVIEJO 130°; TESOURA

CASTROVIEJO 25°;TESOURA CASTROVIEJO 45°; TESOURA CASTROVIEJO 60°; TESOURA CASTROVIEJO 90°; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 15CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 18CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 15CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 18CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 09CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 09CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO RETA T/C 15CM; TESOURA CASTROVIEJO T/C 130°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 25°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 45°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 60°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 90°; TESOURA CASTROVIEJO CURVA T/C 15CM; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ DIREITA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ ESQUERDA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ FRENTE; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/FINA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CN RETA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/FINA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA15CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA ROMBA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA 100MM;TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA RETA 100MM;TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA ANGULADA 45° 100MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA ANGULADA 90° 100MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ ESQUERDA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ DIREITA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA LISA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA CURTA LISA 9,0MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA LONGA LISA 11,0MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA SERRILHADA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ ESQUERDA LISA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ DIREITA LISA 9,5MM; TESOURA COHAN-VANNAS CURVA; TESOURA COHAN-VANNAS RETA;TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 11CM; TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 14CM; TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 18CM; TESOURA CONVERSE RETA 11CM; TESOURA CONVERSE RETA 14CM; TESOURA CONVERSE 18CM; TESOURA CORTA FIO ACO 13CM SERRILHADA; TESOURA COTTLE P/DORSO NASAL; TESOURA COTLE 11CM; TESOURA COTLE 14CM; TESOURA COTLE 15CM; TESOURA COTLE 16CM; TESOURA DANDY 17CM, TESOURA DANDY CURVA 17CM; TESOURA DANDY 19CM TESOURA DANDY 20CM; TESOURA DANDY TRIGEMINAL; TESOURA DEAN SERRILHADA; TESOURA DEAN SEM SERRILHA; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 25GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 40GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 45 GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 60GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM EM "S"; TESOURA DE RYTHiDO; TESOURA DIETRICH 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH COM GUIA 18CM 130 GRAUS; TESOURA

DIETRICH T/C 18CM 25GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 25GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 45GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 45GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 60GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 60GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 90GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 90GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 125GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 125GRAUS; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 25° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 25° 18CM T/C;TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 45° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 45° 18CM T/C;TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 60° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 60° 18CM T/C;TESOURA ENTERÓTOMO; TESOURA ESMARCH 17CM; TESOURA ESMARCH 20CM;TESOURA FAVALORO 18CM 130 GRAUS;TESOURA FAVAROLO 18CM; TESOURA P/ FIO DE ACO 11CM; TESOURA P/ FIO DE ACO 11CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 11CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 11CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 12CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 12CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 15CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 15CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 18CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 18CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 20CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 20CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 25CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 25CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 30CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 30CM T/C; TESOURA FOMON DORSAL ANGULAR; TESOURA FOMON DORSAL ANGULAR T/C; TESOURA FOMON ANGULADA 15CM; TESOURA FRAZIER 18CM;TESOURA FREEMAN; TESOURA FREEMAN CURVA 14CM; TESOURA FREEMAN CURVA 18CM; TESOURA FREEMAN CURVA 23CM; TESOURA FREEMAN RETA 14CM; TESOURA FREEMAN RETA 18CM; TESOURA FREEMAN RETA 23CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 15CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 20CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 23CM; TESOURA GOLDMAN FOX; TESOURA GOLDMAN FOX T/C; TESOURA GOLDMAN FOX RETA; TESOURA GOLDMAN FOX RETA T/C;TESOURA GOLDMAN FOX CURVA; TESOURA GOLDMAN FOX CURVA T/C; TESOURA HEYMAN DELICADA 10CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 13CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 16CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 19CM; TESOURA HEYMANN 10CM; TESOURA HEYMANN ANGULADA COM SERRILHA; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 8CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 8CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA CANHOTO; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA DELICADA; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA CANHOTO T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA CANHOTO; TESOURA IRIS 11,5CM RETA DELICADA; TESOURA IRIS 11,5CM RETA CANHOTO T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA DELICADA T/C; TESOURA IRIS C/FACETA CURVA FINA; TESOURA IRIS C/FACETA CURVA FINA T/C; TESOURA IRIS C/FACETA RETA FINA; TESOURA IRIS C/FACETA RETA FINA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA; TESOURA IRIS 11,5CM RETA T/C; TESOURA IRIS ANGULADA 11,5CM; TESOURA IRIS ANGULADA 14CM; TESOURA IRIS ANGULADA 16CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA CURVA 11CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA CURVA 14CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA RETA 11CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA RETA 14CM; TESOURA IRIS ROMBA CURVA 11,5CM; TESOURA IRIS ROMBA RETA 11,5CM; TESOURA JACOBSON CURVA 16CM;TESOURA JACOBSON RETA 16CM; TESOURA JACOBSON RETA 18CM; TESOURA JACOBSON 18CM CURVA; TESOURA JOSEPH 14CM RETA; TESOURA JOSEPH 14CM CURVA; TESOURA JOSEPH CURVA T/C 15CM; TESOURA JOSEPH RETA T/C 15CM; TESOURA KHAN CURVA COM SERRILHA 14CM; TESOURA KHAN RETA COM SERRILHA 14CM; TESOURA KEYE FREEMAN CURVA 14CM; TESOURA KEYE FREEMAN CURVA 18CM; TESOURA KILLIAN P/ SEPTO 20CM; TESOURA KILNER ; TESOURA KILNER 14CM; TESOURA DE LISTER 14CM; TESOURA DE LISTER 17CM; TESOURA DE LISTER 19CM;TESOURA KNIGHT; TESOURA LAGRANGE; TESOURA LAGRANGE T/C;TESOURA LEXER CURVA DELGADA 165MM T/C; TESOURA LEXER BABY 10CM CURVA; TESOURA LEXER BABY 10CM CURVA T/C; TESOURA LEXER BABY 10CM RETA; TESOURA LEXER BABY 10CM RETA T/C;TESOURA LITTAUER 13,5CM; TESOURA LOCKLIN 16CM; TESOURA MALIS 18CM CURVA;TESOURA MAYO 15CM RETA; TESOURA MAYO 15CM CURVA;TESOURA MAYO 17CM RETA; TESOURA MAYO 17CM CURVA; TESOURA MAYO 23CM RETA; TESOURA MAYO 23CM CURVA;TESOURA MAYO NOBLE 17CM CURVA;TESOURA MAYO NOBLE 17CM RETA; TESOURA MAYO NOBLE 17CM CURVA T/C; TESOURA MAYO NOBLE 17CM RETA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA COM

SERRILHA; TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA;TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA C/ SERRILHA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA;TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 19CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 19CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 22CM CURVA;TESOURA MAYO STILLE 22CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 22CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 22CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 30CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 30CM RETA;TESOURA MAYO STILLE 30CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 30CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M RETA T/C;TESOURA MC-INDOE; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA; TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA ;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM CURVA LONGA 23CM; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM RETA; T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM RETA;

TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM RETA;TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM RETA T/C;TESOURA NELSON 24CM CURVA;TESOURA NELSON 24CM RETA;TESOURA NOYES 12CM FINA/FINA RETA;TESOURA NOYES 12CM ROMBA/FINA RETA;TESOURA NOYES 12CM ROMBA/ROMBA RETA;TESOURA NOYES IRIS RETA 12CM ;TESOURA NOYES IRIS CURVA 12CM; TESOURA OLIVECRONA; TESOURA PARA OURO RETA 10CM; TESOURA PARA OURO CURVA 10CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 14CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 18CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 14CM T/C; TESOURA COROA E OURO CURVA 18CM T/C; TESOURA COROA E OURO CURVA T/C; TESOURA COROA E OURO RETA 14CM; TESOURA COROA E OURO RETA 18CM; TESOURA COROA E OURO RETA 14CM T/C;TESOURA COROA E OURO RETA 18CM T/C; TESOURA COROA E OURO RETA T/C; TESOURA P/ BANDAGEM GROSSA;TESOURA PARA CORDÃO UMBILICAL;TESOURA P/ENUCLEACAO 14CM; TESOURA P/ENUCLEACAO 16CM;TESOURA P/ESTRABISMO CURVA;TESOURA P/ESTRABISMO RETA;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 145MM T/C;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 180MM T/C;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 230MM T/C;TESOURA P/ RUGAS 14CM;TESOURA P/ RUGAS 20CM;TESOURA P/ RUGAS 24CM; TESOURA PARAMETRIAL 23CM CURVA;TESOURA PARAMETRIAL 26CM CURVA; TESOURA PARAMETRIAL 30CM CURVA;TESOURA PARAMETRIAL 35CM CURVA; TESOURA PARAMETRIAL 23CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 26CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 30CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 35CM CURVA T/C; TESOURA P/ TUBOS SERRILHADA 20 CM; TESOURA PELICANO 17CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 25° 19CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 40° 19CM TESOURA POTTS DE MARTEL 60° 19CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 25° 19CM T/C; TESOURA POTTS DE MARTEL 40° 19CM T/C; TESOURA POTTS DE MARTEL 60° 19CM T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 25°; TESOURA POTTS SMITH 19CM 25°T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 30°; TESOURA POTTS SMITH 19CM 30°T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 40°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 40°T/C; TESOURA POTTS SMITH 45°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 60°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 60°T/C;TESOURA POTTS SMITH 25° CURVA T/C; TESOURA POTTS SMITH 45° CURVA T/C;TESOURA POTTS SMITH 60° CURVA T/C;TESOURA POTTS-YASARGIL 18CM DIREITA;TESOURA POTTS-YASARGIL 18CM ESQUERDA; TESOURA POTTS-YASARGIL 20CM DIREITA;TESOURA POTTS-YASARGIL 20CM ESQUERDA; TESOURA REYNOLDS CURVA 12CM; TESOURA REYNOLDS CURVA 15CM; TESOURA REYNOLDS CURVA 18CM; TESOURA REYNOLDS RETA 12CM; TESOURA REYNOLDS RETA 15CM; TESOURA REYNOLDS RETA 18CM; TESOURA REES P/ RUGAS 20CM;TESOURA REES P/ RUGAS 24CM;TESOURA SATINSKY 18CM CURVA; TESOURA SATINSKY 20CM CURVA;TESOURA SCHMIEDEN-TAYLOR; TESOURA SERRILHADA 15CM; TESOURA SCHUMACHER; TESOURA SIMS RETA; TESOURA SIMS CURVA; TESOURA SIMS 8CM CURVA;TESOURA SMITH; TESOURA SMITH 23CM;TESOURA SNOLDEN SERRILHADA CURVA 15CM; TESOURA SNOLDEN SERRILHADA RETA 15CM;TESOURA SNOLDEN SERRILHADA CURVA 17CM; TESOURA SNOLDEN SERRILHADA RETA 17CM;TESOURA SPENCER 9CM; TESOURA SPENCER 12CM; TESOURA SPENCER 14CM; TESOURA SPENCER CURVA 11CM; TESOURA SPENCER CURVA 14CM; TESOURA SPENCER T/C 11CM; TESOURA SPENCER T/C 14CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 14CM;

TESOURA STEVENS CURVA; TESOURA STEVENS RETA;TESOURA STEVENS 11,5CM CURVA;TESOURA STEVENS 11,5CM RETA;TESOURA STRULLY RETA 18CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 18CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 18CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 18CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY RETA 20CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 20CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 20CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 20CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY RETA 22CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 22CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 22CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 22CM PONTA ROMBA;TESOURA THOREK 19CM;TESOURA TROUTMAN CASTROVIEJO DIREITA;TESOURA TROUTMAN CASTROVIEJO ESQUERDA; TESOURA UNIVERSAL P/ FIO T/C; TESOURA UNIVERSAL T/C 11CM; TESOURA UNIVERSAL; TESOURA VANNAS CURVA; TESOURA VANNAS RETA;TESOURA KLINKENBERGH-LOTH 23CM; TESOURA ZURICH RETA 13CM ;TESOURA WECKER 11CM; TESOURA WESTCOTT CURVA; TESOURA WESTCOTT RETA;

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	10304850053
Processo	25351.516402/2006-76
Origem do Produto	• FABRICANTE: ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

001388

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 12

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	SALDANHA RODRIGUES LTDA		
CNPJ	03.426.484/0001-23	**Autorização**	8.00.261-8
Produto	SERINGA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO SEM AGULHA SR DIVERSOS CALIBRES		

Modelo Produto Médico
SERINGA HIPODÉRMICA DE USO ÚNICO SEM AGULHA SR DIVERSOS CALIBRES - Modelos: SR; SR-SS; SR-CLEAN - VOLUMES DAS SERINGAS: 0,5ML - 1ML - 2ML - 3ML - 5ML - 10ML - 20ML - 50ML - 60ML TIPOS DE BICOS DAS SERINGAS: LUER SLIP e LUER LOCK : TODOS OS VOLUMES e AINDA PARA O BICO CATÉTER HÁ TAMBÉM OS VOLUMES 50ML E 60ML

Nome Técnico	Seringas Descartaveis
Registro	80026180002
Processo	25351.010043/0081
Origem do Produto	• FABRICANTE: SALDANHA RODRIGUES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

16

001390

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	02.881.877/0001-64	**Autorização**	8.00.340
Produto	ATADURA DE ALGODÃO POLAR FIX		

Modelo Produto Médico
Comprimento: 1,0; 1,50.; 1,80; 3,0 m Largura: 6; 8; 10; 12; 15; 20 cm

Nome Técnico	Ataduras
Registro	8003400044
Processo	25351.634401/2011-09
Origem do Produto	• FABRICANTE: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 19 001391

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	02.881.877/0001-64	**Autorização**	8.00.340
Produto	Artigo Ortopédico Moldável Polar Fix		

Modelo Produto Médico

APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 6cm x 2m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 6cm x 3m ; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 6cm x 4m ; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 8cm x 2m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 8cm x 3m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 8cm x 4m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 10cm x 3m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 10cm x 4m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 10cm x 4.5m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 10cm x 5m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 12cm x 3m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 12cm X 4.5m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 12cm x 5m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 15cm x 3m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 15cm x 4m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 15cm x 4.5m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 15cm x 5m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 20cm x 3m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 20cm x 4m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 20cm x 4.5m; APARELHO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX 20cm x 5m.

Nome Técnico	Ataduras
Registro	8003400035
Processo	25351.634481/2011-47
Origem do Produto	• FABRICANTE: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

00139

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 20,21 001393

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	02.881.877/0001-64	**Autorização**	8.00.340
Produto	ATADURA GESSADA POLAR FIX		

Modelo Produto Médico
10cm x 3m; 10cm x 4m; 10cm x 4,5m; 10cm x 5m; 12cm x 3m; 12cm x 4,5m; 12cm x 5m; 15cm x 3m; 15cm x 4m; 15cm x 4,5m; 15cm x 5m; 20cm x 3m; 20cm x 4m; 20cm x 4,5m; 20cm x 5m; 6cm x 2m; 6cmx 3m; 6cm x 4m; 8cm x 2m; 8cmx 3m; 8cm x 4m.

Nome Técnico	Ataduras
Registro	8003400048
Processo	25351.634460/2011-84
Origem do Produto	• FABRICANTE: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

24

001394

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	**Autorização**	8.00.702-1
Produto	Cânula Orofaríngea MD		

Modelo Produto Médico
Cânula orofaríngea MD modelo Guedell: (Comprimento 40/50/60/70/80/90/100/110 mm); Cânula orofaríngea MD modelo Bermann: (Comprimento 40/50/60/70/80/90/100/110 mm).

Nome Técnico	Canulas
Registro	80070210031
Processo	25351.002983/2012-45
Origem do Produto	• FABRICANTE: HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. - TAIWAN
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 35 001395

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	07.415.627/0001-52	**Autorização**	8.02.880-9
Produto	CATETER INTRAVENOSO SAFETY LA VITA		

Modelo Produto Médico
Cateter intravenoso safety La Vita - 14G-16G-17G-18G-20G-22G-24G-26G. Cateter intravenoso safety Clip La Vita - 14G-16G-17G-18G-20G-22G-24G-26G.

Nome Técnico	Cateteres
Registro	80288090030
Processo	25351.219949/2011-21
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDIPLUS (INDIA) LTD - ÍNDIA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 40 00139E

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	50.328.590/0001-54	**Autorização**	1.04.323-0
Produto	FLUXOMETRO ECO		

Modelo Produto Médico
FX310AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-15L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA MÉDIA
FX310AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA MÉDIA
FX320AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-15L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA MÉDIA
FX320AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA MÉDIA
FX330AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-15L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA MÉDIA
FX330AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA MÉDIA
FX340AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-15L/MIN PARA DIÓXIDO DE CARBONO BILHA MÉDIA
FX340AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA DIÓXIDO DE CARBONO BILHA MÉDIA
FX410AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-15L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA LONGA
FX410AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA LONGA
FX420AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-15L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA LONGA
FX420AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA LONGA
FX430AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-15L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA LONGA
FX430AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA LONGA
FX450AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-15L/MIN PARA DIÓXIDO DE CARBONO BILHA LONGA
FX450AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-15L/MIN PARA DIÓXIDO DE CARBONO BILHA LONGA
FX510AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-30L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA LONGA
FX510AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-30L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA LONGA
FX520AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-30L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA LONGA
FX520AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-30L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA LONGA

001397

FX530AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-30L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA LONGA
FX530AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-30L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA LONGA
FX540AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-30L/MIN PARA DIÓXIDO DE CARBONO BILHA LONGA
FX540AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-30L/MIN PARA DIÓXIDO DE CARBONO BILHA LONGA
FX610AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-3L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA MÉDIA
FX610AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-3L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA MÉDIA
FX620AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-3L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA MÉDIA
FX620AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-3L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA MÉDIA
FX630AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-3L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA MÉDIA
FX630AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-3L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA MÉDIA
FX640AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-3L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA LONGA
FX640AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-3L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA LONGA
FX650AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-3L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA LONGA
FX650AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-3L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA LONGA
FX660AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-3L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA LONGA
FX660AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-3L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA LONGA
FX710AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-5L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA MÉDIA
FX710AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-5L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA MÉDIA
FX720AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-5L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA MÉDIA
FX720AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-5L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA MÉDIA
FX730AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-5L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA MÉDIA
FX730AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-5L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA MÉDIA
FX740AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-5L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA LONGA
FX740AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-5L/MIN PARA OXIGÊNIO BILHA LONGA
FX750AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-5L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA LONGA
FX750AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-5L/MIN PARA AR COMPRIMIDO BILHA LONGA
FX760AL - FLUXOMETRO ECO CROMADO 0-5L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA LONGA
FX760AN - FLUXOMETRO ECO ANODIZADO 0-5L/MIN PARA OXIDO NITROSO BILHA LONGA

0013

Nome Técnico	Fluxometro
Registro	10432300032
Processo	25351.281468/2018-73
Origem do Produto	• FABRICANTE: UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

001399

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 45,46

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ	95.433.397/0001-11	**Autorização**	8.00.702-1
Produto	LARINGOSCÓPIOS MD		

Modelo Produto Médico
Laringoscópio Macintosh Convencional; Laringoscópio Macintosh Fibra Óptica; Laringoscópio Miller Convencional; Laringoscópio Miller Fibra Óptica; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Convencional; Laringoscópio McCoy Flexi-Tip Fibra Óptica; Laringoscópio Macintosh German Fibra Óptica.

Nome Técnico	Laringoscopio
Registro	80070210014
Processo	25351.742491/2009-91
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

001400

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 47

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	M. SÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
CNPJ	72.819.980/0001-60	**Autorização**	8.01.280-0
Produto	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA		

Modelo Produto Médico
04 x 15 , 06x15 , 08x15, 10x15, 12x15, 15x15, 20x15, 25x15, 30x15;
04x10, 06x10, 08x10, 10x10, 12x10, 15x10, 20x10, 25x10, 30x10;
04x20, 06x20, 08x20, 10x20, 12x20, 15x20, 20x20, 25x20, 30x20;
1,5x25, 04x25, 06x25, 08x25, 10x25, 12x25, 15x25, 20x25, 25x25, 30x25;
5,0x22,8 / 7,5x22,8 / 10,0x22,8 / 12,5x22,8 / 15,0x22,8 / 20,0x22,8

Nome Técnico	Imobilizador Ortopedico
Registro	80128000012
Processo	25351.488400/2013-93
Origem do Produto	• FABRICANTE: M. SÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 50

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
CNPJ	58.268.152/0001-50	**Autorização**	1.03.043-5
Produto	Família de Instrumental Cirúrgico Articulado não Cortante		

Modelo Produto Médico

ABRIDOR DE BOCA DENHARDT; ABRIDOR DE BOCA HEISTER 13CM CURVO; ABRIDOR DE BOCA HEISTER 13CM RETO; ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 11CM; ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 13CM; ABRIDOR DE BOCA JENNINGS 15CM; ABRIDOR DE BOCA MC.IVOR SEM SUCÇÃO 3 LÂMINAS; ABRIDOR DE BOCA MOLT 10CM INFANTIL; ABRIDOR DE BOCA MOLT 14CM ADULTO; ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 11CM; ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 13CM; ABRIDOR DE BOCA WHITEHEAD COM TRAVA 15CM; AFASTADOR A PITANGA Nº. 1; AFASTADOR A PITANGA Nº. 2; AFASTADOR A PITANGA Nº. 3; AFASTADOR ADSON 32CM; AFASTADOR ADSON AGUDO 20CM; AFASTADOR ADSON AGUDO 32CM; AFASTADOR ADSON BABY AGUDO 16CM; AFASTADOR ADSON BABY ARTICULADO 16CM ; AFASTADOR ADSON BABY ARTICULADO 17CM; AFASTADOR ADSON BABY ROMBO 16CM; AFASTADOR ADSON ROMBO 20CM; AFASTADOR ADSON ROMBO 32CM; AFASTADOR ALM 4X4 AGUDO; AFASTADOR ALM BAIONETA; AFASTADOR ANDERSON-ADSON CURVO 19CM; AFASTADOR ANKENEY ADULTO GRANDE; AFASTADOR ANKENEY ADULTO MÉDIO; AFASTADOR ANKENEY ADULTO PEQUENO; AFASTADOR ANKENEY INFANTIL; AFASTADOR APFELBAUM; AFASTADOR ATM; AFASTADOR BAUFOUR ABDOMINAL COM VÁLVULA CURVA 45X80; AFASTADOR BAUFOUR ABDOMINAL COM VÁLVULA RETA 70X100; AFASTADOR BAUFOUR BABY ABDOMINAL COM VÁLVULA CURVA 20X25; AFASTADOR BECKMAN 30CM COLUNA/PULMAO/TORAX; AFASTADOR BECKMAN EATON 32CM; AFASTADOR BECKMAN-ADSON 32CM AGUDO; AFASTADOR BECKMAN-ADSON 32CM ROMBO; AFASTADOR BECKMAN-ADSON 4X4 31CM; AFASTADOR BECKMANN 4 DENTES AGUDO; AFASTADOR BECKMANN 4 DENTES ROMBO; AFASTADOR BECKMANN 5 DENTES AGUDO; AFASTADOR BECKMANN 5 DENTES ROMBO; AFASTADOR BECKMANN 7 DENTES AGUDO; AFASTADOR BECKMANN 7 DENTES ROMBO; AFASTADOR BENSAUDE ADULTO 22X70MM; AFASTADOR BENSAUDE INFANTIL 16X70MM; AFASTADOR BLEFAROSTATO DE COOK 4CM; AFASTADOR BLEFAROSTATO DE COOK 5CM; AFASTADOR BLEFAROSTATO DE PARK 8CM; AFASTADOR BLEFAROSTATO GUYTON PARK; AFASTADOR BLEFAROSTATO LANCASTER; AFASTADOR BLEFAROSTATO MELLINGER; AFASTADOR BLEFAROSTATO MURDOCK; AFASTADOR BURFORD ESPATULAS MOVEIS; AFASTADOR CASPAR CERVICAL LONGITUDINAL; AFASTADOR CASPAR CERVICAL TRANSVERSAL; AFASTADOR CASPAR DE CORPO VERTEBRAL; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 45MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 50MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 55MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 60MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR 65MM; AFASTADOR CASPAR LOMBAR UNIVERSAL; AFASTADOR CASPAR; AFASTADOR CASTROVIEJO 8CM; AFASTADOR CERVICAL LONGITUDINAL COM LÂMINAS; AFASTADOR CERVICAL TRANSVERSAL COM LÂMINAS; AFASTADOR CLOWARD 23CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD 23CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD 25CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD 25CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD INTERVERTEBRAL; AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 23CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 23CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 25CM LÂMINAS COM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR CLOWARD LOMBAR 25CM LÂMINAS SEM DENTE 40,45,50,55 E 60MM; AFASTADOR

CLOWARD P/ VERTEBRA C/ CREMALHEIRA; AFASTADOR COLLIN 3 VALVULAS 22CM; AFASTADOR COLLIN 3 VALVULAS Nº1; AFASTADOR COLLIN 3 VALVULAS Nº2; AFASTADOR CONTOUR 4X3 DENTES ROMBOS CURVO 14CM; AFASTADOR CONTRATOR BAILEY BABY; AFASTADOR CONTRATOR BAILEY; AFASTADOR CUSHING LANDOLT 110MM/ 70MM/ 90MM; AFASTADOR DINKHUYSEN MITRAL; AFASTADOR DINKHUYSEN P/ MAMÁRIA E MITRAL; AFASTADOR DINKHUYSEN PARA MAMÁRIA; AFASTADOR DINKHUYSEN; AFASTADOR FINOCHIETTO 25X40 C/ 13CM ; AFASTADOR FINOCHIETTO 38X45 C/ 16CM; AFASTADOR FINOCHIETTO 40X65 C/ 18CM; AFASTADOR FINOCHIETTO BABY 18X22 C/ 8CM; AFASTADOR FINOCHIETTO BURFORD; AFASTADOR FINOCHIETTO CURVO; AFASTADOR FINOCHIETTO INFANTIL 12CM; AFASTADOR FINOCHIETTO MÉDIO ESPECIAL; AFASTADOR FINOCHIETTO NEONATAL; AFASTADOR FINOCHIETTO PEQUENO ESPECIAL; AFASTADOR GELPI 14CM; AFASTADOR GELPI 17CM; AFASTADOR GELPI 18CM; AFASTADOR GELPI 29CM; AFASTADOR GELPI COM STOP 14CM ; AFASTADOR GELPI COM STOP 17CM; AFASTADOR GELPI COM STOP 18CM; AFASTADOR GELPI INFANTIL 10CM; AFASTADOR GELPI INFANTIL 12CM; AFASTADOR GELPI INFANTIL COM STOP 10CM; AFASTADOR GELPI INFANTIL COM STOP 12CM; AFASTADOR GELPI STOP; AFASTADOR GOSSET BABY COM DUPLO BARRAMENTO 12CM; AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 12CM; AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 14CM; AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 16CM; AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 24CM; AFASTADOR GOSSET COM DUPLO BARRAMENTO 30CM; AFASTADOR HENLEY 16,5CM 3X4 DENTES; AFASTADOR HENNING 27CM; AFASTADOR HRYNTSCHAK LÂMINAS LATERAL 40X85MM E CENTRAL 35X100MM; AFASTADOR INGE 16CM PONTA 6MM; AFASTADOR INGE 24CM PONTA 12MM; AFASTADOR INGE 26CM; AFASTADOR JANSEN AGUDO 11CM; AFASTADOR JANSEN ROMBO 11CM; AFASTADOR LEYLA DUPLO C/ 02 BRACOS E 04 ESPÁTULAS; AFASTADOR LEYLA DUPLO COM APOIO DE MESA; AFASTADOR LEYLA SIMPLES C/ 2 ESPÁTULAS; AFASTADOR LEYLA SIMPLES COM APOIO DE MESA; AFASTADOR LOMBAR TRANSVERSAL COM LÂMINAS 50, 55 E 60MM; AFASTADOR LOMBAR; AFASTADOR MARKAN MEYERDING DIREITO; AFASTADOR MARKAN MEYERDING ESQUERDO; AFASTADOR MARKAN MEYERDING; AFASTADOR MEYERDING 19CM LÂMINA 44X25MM; AFASTADOR MEYERDING 19CM LÂMINA 54X25MM; AFASTADOR MEYERDING 19CM LÂMINA 60X19MM; AFASTADOR MEYERDING 19CM LÂMINA 60X25MM; AFASTADOR MEYERDING Nº1; AFASTADOR MEYERDING Nº2; AFASTADOR MEYERDING Nº3; AFASTADOR MEYERDING Nº4; AFASTADOR MILLIN C/ 5 LÂMINAS ABDOMINAL E VESICAL; AFASTADOR MILLIN-BACON 24CM P/ PROSTATA; AFASTADOR MINITORACTOMIA; AFASTADOR MISKIMON 22CM AGUDO; AFASTADOR MISKIMON 22CM ROMBO; AFASTADOR MISKIMON 26CM AGUDO; AFASTADOR MISKIMON 26CM ROMBO; AFASTADOR MISKIMON 28CM AGUDO; AFASTADOR MISKIMON 28CM ROMBO; AFASTADOR MISKIMON AGUDO 35X32MM 18CM; AFASTADOR MISKIMON ROMBO 18CM; AFASTADOR MOLLISON 4 X 4 DENTES AGUDO 15CM; AFASTADOR MOLLISON; AFASTADOR OLSEN; AFASTADOR O''SULLIVAN O''CONOR; AFASTADOR P/ ESTERNO 51X76MM; AFASTADOR P/ ESTERNO 76X76MM; AFASTADOR P/ MAMÁRIA E ESTERNO COMPLETO; AFASTADOR PARA TUNEL; AFASTADOR R PITANGA Nº. 1; AFASTADOR R PITANGA Nº. 2; AFASTADOR R PITANGA Nº. 3; AFASTADOR RIGBY 18CM AGUDO; AFASTADOR RIGBY 18CM ROMBO; AFASTADOR SCOVILLE COM ABERTURA 15CM C/ LÂMINAS 41X38MM E 67X44MM; AFASTADOR SCOVILLE HAVERFIELD COM ABERTURA 15CM LÂMINAS 64X25MM, 64X51MM, 67X32MM E 89X25MM; AFASTADOR SELETZ GELPI ANG. RETO; AFASTADOR SMITH-BUIE 15CM 23X75MM; AFASTADOR VALIN; AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 10,5CM; AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM; AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 13CM; AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 16,5CM; AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM; AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 20CM; AFASTADOR WEITLANER 5X6 DENTES 14CM; AFASTADOR WEITLANER 5X6 DENTES 17CM; AFASTADOR WEITLANER 5X6 DENTES 21CM; AFASTADOR WEITLANER 5X6 DENTES 24CM; AFASTADOR WEITLANER AGUDO 10,5CM; AFASTADOR WEITLANER AGUDO 13CM; AFASTADOR WEITLANER AGUDO 14CM; AFASTADOR WEITLANER AGUDO 16,5CM; AFASTADOR WEITLANER AGUDO 18CM; AFASTADOR WEITLANER AGUDO 20CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY AGUDO 10,5CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY AGUDO 13CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY AGUDO 14CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY AGUDO 16,5CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY AGUDO 18CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY AGUDO 20CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY ROMBO 10,5CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY ROMBO

13CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY ROMBO 14CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY ROMBO 16,5CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY ROMBO 18CM; AFASTADOR WEITLANER HENLEY ROMBO 20CM; AFASTADOR WILLIANS 100X20MM DIREITO; AFASTADOR WILLIANS 100X20MM ESQUERDO; AFASTADOR WILLIANS 110X20MM DIREITO; AFASTADOR WILLIANS 110X20MM ESQUERDO; AFASTADOR WILLIANS 50X20MM DIREITO; AFASTADOR WILLIANS 50X20MM ESQUERDO; AFASTADOR WILLIANS 50X20MM; AFASTADOR WILLIANS 60X20MM DIREITO; AFASTADOR WILLIANS 60X20MM ESQUERDO; AFASTADOR WILLIANS 70X20MM DIREITO; AFASTADOR WILLIANS 70X20MM ESQUERDO; AFASTADOR WILLIANS 70X20MM; AFASTADOR WILLIANS 80X20MM DIREITO; AFASTADOR WILLIANS 80X20MM ESQUERDO; AFASTADOR WILLIANS 90X20MM DIREITO; AFASTADOR WILLIANS 90X20MM ESQUERDO; AFASTADOR WOLFF 23CM; AFASTADOR WULLSTEIN AGUDO; AFASTADOR WULLSTEIN ROMBO; AFASTADOR WULLSTEIN; ALICATE ADERER TRIDENT N.200; ALICATE ANGLE N.139; ALICATE BICO CHATO; ALICATE BOCA SERRILHADA 17CM; ALICATE BOCA SERRILHADA 19CM; ALICATE BOCA SERRILHADA PONTA FINA 2MM 19CM; ALICATE CONFORMADOR; ALICATE DE PRESSAO AÇO INOX 18CM; ALICATE DE PRESSAO AÇO INOX 20CM; ALICATE DE PRESSAO AÇO INOX 25CM; ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 22CM; ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 25CM; ALICATE DE PRESSÃO BICO LONGO 30CM; ALICATE DE PRESSÃO MÃO DE NOIVA; ALICATE DOBRA EM V; ALICATE DOBRA EM Z; ALICATE DUPLA ARTICULAÇÃO 20CM; ALICATE DUPLA FORÇA BOCA SERRILHADA 17CM; ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 2MM; ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 3MM; ALICATE DUPLA FORÇA P/ PUXAR FIOS T/C 18CM C/ PONTA 5MM; ALICATE FORMADOR DE AMARRILHO; ALICATE GOSLEE N.121; ALICATE HAMMERHEAD; ALICATE HOLLOW CHOP; ALICATE HOW N.110; ALICATE HOW N.111; ALICATE JARABAK; ALICATE JONHSON N.114; ALICATE MC KELLOPS N.128; ALICATE MEIA CANA; ALICATE N.1001; ALICATE N.201 TRIDENT LONGO; ALICATE N.210 WEINGART T/C; ALICATE N.210 WEINGART; ALICATE N.346 REMOVEDOR DE BRACKETS CURVO; ALICATE N.346 REMOVEDOR DE BRACKETS RETO; ALICATE N.442 PONTA CURVA; ALICATE N.442 PONTA LONGA; ALICATE NANCE N.1; ALICATE OMEGA LOOP; ALICATE ORTODONTIA N.03 PEAK; ALICATE ORTODONTIA N.04 PEAK; ALICATE ORTODONTIA N.104; ALICATE ORTODONTIA N.107; ALICATE ORTODONTIA N.109 DE LA ROSA; ALICATE ORTODONTIA N.115 REYNOLD BICO DE PAPAGAIO; ALICATE ORTODONTIA N.118; ALICATE ORTODONTIA N.120; ALICATE ORTODONTIA N.137; ALICATE ORTODONTIA N.155; ALICATE ORTODONTIA N.156; ALICATE ORTODONTIA N.157; ALICATE ORTODONTIA N.345; ALICATE ORTODONTIA N.347 LONGO; ALICATE ORTODONTIA N.347; ALICATE ORTODONTIA N.350 TWEED; ALICATE ORTODONTIA N.351; ALICATE ORTODONTIA N.442 ANGLE; ALICATE ORTODONTIA N.94 ADAMS; ALICATE P/ ARCO LINGUAL; ALICATE P/ BANDA INFERIOR; ALICATE P/ BANDA SUPERIOR; ALICATE P/ BARRA PALATINA T/C; ALICATE P/ BARRA PALATINA; ALICATE PARA PUXAR FIO PONTA FINA 14CM; ALICATE PARA PUXAR FIOS 17CM; ALICATE PARA PUXAR FIOS BICO CHATO 17CM; ALICATE PARA REBITAR MATRIZ N.141; ALICATE PLANO PARALELO 18CM; ALICATE SACA RESINA COM PONTA REAJUSTÁVEL; ALICATE SACA RESINA; ALICATE SCHWARZ N.53; ALICATE UNIVERSAL N.325; ALICATE UNIVERSAL ORTOPEDIA; ALICATE YONG N.74; APROXIMADOR CONTRATOR BAILEY; APROXIMADOR CONTRATOR BAILEY-BABY; APROXIMADOR GERSTER; APROXIMADOR LEMMON; APROXIMADOR SELLORS 20CM P/ COSTELA; BLEFAROSTATO MELLINGER 5CM INFANTIL; BLEFAROSTATO MELLINGER 7CM ADULTO; BOTICÃO FÓRCEPS 22 PAPAGAIO; BOTICÃO FÓRCEPS 33 PAPAGAIO; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 1; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 101; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 103; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 10H; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 10S; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 121; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 15; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 150; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 151; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 16; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 17; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 18L CABO RETO; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 18L; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 18R CABO RETO; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 18R; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 203; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 210; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 210H; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 210S; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 213; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 22; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 222; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 23; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 24; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 27; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 286; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 32; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 32A; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 33; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 44; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 53L; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 53R; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 62; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 65; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 68;

BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 69; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 76; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 88L; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 88R; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 99A; BOTICÃO FÓRCEPS ADULTO 99C; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 1; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 101; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 106; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 150-S; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 151-S; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 16; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 16-S; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 17; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 18D; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 18L; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 18R; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 201; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 21; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 23-S; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 27; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 44; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 46; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 65; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 68; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL 69; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 01; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 02; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 03; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 04; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 05; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 06; BOTICAO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 150-S; BOTICAO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 18-D; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 21; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 27; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 44; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 46; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 65; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 68; BOTICÃO FÓRCEPS INFANTIL MODELO INGLÊS 69; BOTICAO FÓRCEPS NFANTIL MODELO INGLÊS 151-S; BOTICAO FÓRCEPS WITZEL INFERIOR; BOTICÃO FÓRCEPS WITZEL SUPERIOR; CLAMP DE LAHEY LONGA 25CM; CLAMP NEONATAL ANGULADO 13,5CM; CLAMP NEONATAL RETO 13,5CM; CLAMP VASCULAR COLVER; COMPASSO 100MM/ 220MM; COMPASSO DE WILLIS; DILATADOR LA-BORDE COM 3 RAMOS; DILATADOR SIMS COM 3 RAMOS; DILATADOR TROUSSEAUX COM 2 RAMOS; DILATADOR WYLIE COM 2 RAMOS UTERINO; ESMAGADOR DE CARTILAGEM; ESPECÍMETRO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE; ESPECÍMETRO IWANSON; ESPÉCULO ANAL DE PITANGA Nº. 1; ESPÉCULO ANAL DE PITANGA Nº. 2; ESPÉCULO ANAL DE PITANGA Nº. 3; ESPÉCULO BARR RETAL 13, 5CM C/ 2 PARES DE LAMINA; ESPÉCULO BENSAUDE ADULTO 22X70MM; ESPÉCULO BENSAUDE INFANTIL 16X70MM; ESPÉCULO BIVALVE 8,5CM RETAL; ESPÉCULO COLLIN 01 C/ASPIRACAO S/CAPA; ESPÉCULO COLLIN 02 C/ASPIRACAO S/CAPA; ESPÉCULO COLLIN 03 C/ASPIRACAO S/CAPA; ESPÉCULO COLLIN PARA VIRGEM; ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.1 PEQUENO; ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.2 MEDIO; ESPÉCULO COLLIN VAGINAL N.3 GRANDE; ESPÉCULO COLLIN VIRGEM C/ASPIRACAO S/CAPA; ESPÉCULO CUSCO "MODELO SUÍÇO" 1 75X32MM; ESPÉCULO CUSCO "MODELO SUÍÇO" 2 85X35MM; ESPÉCULO CUSCO "MODELO SUÍÇO" 3 100X35MM; ESPÉCULO CUSCO "MODELO SUÍÇO" P/ VIRGEM 75X17MM; ESPÉCULO CUSHING CERVICAL; ESPÉCULO GRAVES N° 1 75 X 20MM; ESPÉCULO GRAVES N°2 95 X 30MM; ESPÉCULO GRAVES N°3 115 X 35MM; ESPÉCULO GRAVES; ESPÉCULO HARDY HIPÓFISE; ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº 1 COM TRAVA; ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº 2 COM TRAVA; ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº 3 COM TRAVA; ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº.0; ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº.1; ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº.2; ESPÉCULO HARTMANN NASAL ADULTO Nº.3; ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº 1 COM TRAVA; ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº 2 COM TRAVA; ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº.0; ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº.1; ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº.2; ESPÉCULO HARTMANN NASAL INFANTIL Nº.3; ESPÉCULO HARTMANN-HALLE 15CM Nº1, Nº2 E Nº3; ESPÉCULO IVES-FRANSLER RETAL 14,5CM; ESPÉCULO KELLY RETAL; ESPÉCULO KILLIAN NASAL C/ FIBRA OPTICA Nº. 1 35MM; ESPÉCULO KILLIAN NASAL C/ FIBRA OPTICA Nº. 2 50MM; ESPÉCULO KILLIAN NASAL C/ FIBRA OPTICA Nº. 3 75MM; ESPÉCULO KILLIAN NASAL C/ FIBRA OPTICA Nº. 4 90MM; ESPÉCULO KILLIAN NASAL N.1 35MM; ESPÉCULO KILLIAN NASAL N.2 50MM; ESPÉCULO KILLIAN NASAL N.3 75MM; ESPÉCULO KILLIAN NASAL N.4 90MM; ESPÉCULO KIRSCHNER; ESPÉCULO MATHIEU RETAL TRIVALVE; ESPÉCULO PITANGA SANTOS RETAL; ESPÉCULO PRATT; ESPÉCULO RETAL DE PITANGA Nº. 1; ESPÉCULO RETAL DE PITANGA Nº. 2; ESPÉCULO RETAL DE PITANGA Nº. 3; ESPÉCULO RICORD RETAL 14CM; ESPÉCULO SIMS RETAL; ESTRIBO KIRSCHNER GRANDE; ESTRIBO KIRSCHNER MÉDIO; ESTRIBO KIRSCHNER PEQUENO; ESTRIBO KIRSCHNER; FASTADOR MEYERDING Nº2; FÓRCEPS HAYTON WILLIAMS; FÓRCEPS KIELAND; FÓRCEPS LEE; FÓRCEPS MARELLI; FÓRCEPS PIPER; FÓRCEPS SIMPSON 30CM; FÓRCEPS SIMPSON 35CM; FÓRCEPS SIMPSON BRAUN 31CM; FORCEPS SIMPSON BRAUN 33CM; FÓRCEPS SIMPSON BRAUN 35CM; FORCEPS SIMPSON BRAUN 36CM; MANIPULADOR UTERINO; MICRO

PORTA AGULHA BARRAQUER C/ TRAVA CURVO 12CM; MICRO PORTA AGULHA BARRAQUER C/ TRAVA RETO 12CM; MICRO PORTA AGULHA BARRAQUER S/ TRAVA CURVO 12CM; MICRO PORTA AGULHA BARRAQUER S/ TRAVA RETO 12CM; MICRO PORTA AGULHA YASARGIL CURVO BAIONETA 18CM; MICRO PORTA AGULHA YASARGIL CURVO BAIONETA 20CM; MICRO PORTA AGULHA YASARGIL RETO BAIONETA 18CM; MICRO PORTA AGULHA YASARGIL RETO BAIONETA 20CM; MICRO PORTA AGULHA YASARGYL CURVO BAIONETA 16CM; MICRO PORTA AGULHA YASARGYL RETO BAIONETA 16CM; PAQUÍMETRO TIPO RÉGUA; PELVIMETRO COLLIN 35CM COM ABERTURA 50CM; PELVÍMETRO MARTIN 35CM COM ABERTURA 50CM; PINÇA ABADIE 22CM; PINÇA ABADIE 27CM; PINÇA ABADIE/LANE 27CM; PINÇA ABADIE/LANE 30CM; PINÇA ADSON (PROTETORA DE DURA); PINÇA ADSON 18CM CURVA; PINÇA ADSON 18CM RETA; PINÇA ALLIS 15CM; PINÇA ALLIS 16CM; PINÇA ALLIS 18CM; PINÇA ALLIS 20CM; PINÇA ALLIS 22CM; PINÇA ALLIS 25CM; PINÇA ALLIS ADAIR 15CM - 9X10 DENTES; PINÇA ALLIS ADAIR 15CM 10X12 DENTES; PINÇA ALLIS ADAIR 20CM - 9X10 DENTES; PINÇA ALLIS BABY 12CM; PINÇA AORTA CRIANÇA 18CM; PINÇA AORTA CURVA 32CM; PINÇA APLICADOR TIPO SUGITA; PINÇA APLICADOR YASARGIL 18CM; PINÇA APLICADOR YASARGIL 21CM; PINÇA APLICADORA P/CLIPS DE RANEY; PINÇA APLICADORA P/RETIRAR AGRAFES; PINÇA APREENSÃO /AFASTADOR 25CM LARINGE ARTICULAÇÃO DUPLA GIRATÓRIA 360° PONTA 1,6MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM CURVA P/ CIMA PONTA 5MM/ 8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM CURVA P/ DIREITA GIRATÓRIA 360°; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM CURVA P/ ESQUERDA GIRATÓRIA 360°; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM CURVA P/ ESQUERDA PONTA 4MM/5MM/8MMM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM CURVA P/DIREITA PONTA 5MM/ 8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM DUPLA ARTICULAÇÃO GIRATÓRIA 360°; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM RETA FORTE COM CREMALHEIRA PONTA 8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM RETA GIRATÓRIA 360°; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO JACARÉ 25CM RETA PONTA 5MM/8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25 CM CURVA P/ DIREITA PONTA DE 5,0MMX 2,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM ARTICULAÇÃO DUPLA GIRATÓRIA 360° PONTA DE 5,0MMX 2,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM CURVA P/ CIMA GIRATÓRIA 360° PONTA DE 3,5MM1,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM CURVA P/ CIMA GIRATÓRIA 360° PONTA DE 5,0MM X2,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM CURVA P/ CIMA PONTA DE 3,5MM X1,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM CURVA P/ CIMA PONTA DE 5,0MM X2,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM CURVA P/ DIREITA PONTA DE 3,5MM X1,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM CURVA P/ ESQUERDA PONTA DE 3,5MM X1,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM CURVA P/ ESQUERDA PONTA DE 5,0MMX 2,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM RETA PONTA DE 3,5MM X 1,8MM; PINÇA APREENSÃO LARINGE TIPO TRIÂNGULO FENESTRADA 25CM RETA PONTA DE 5,0MM X 2,8MM; PINÇA APROXIMACAO P/SUTURA; PINÇA ASCH 23CM; PINÇA ATRAUMA CASTANEDA GRADUADA 15CM Nº. 01; PINÇA ATRAUMA CASTANEDA GRADUADA 15CM Nº. 02; PINÇA ATRAUMA CASTANEDA GRADUADA 15CM Nº. 03; PINÇA ATRAUMA CASTANEDA GRADUADA 15CM Nº. 04; PINÇA ATRAUMA GRADUADA 15CM N.1; PINÇA ATRAUMA GRADUADA 15CM N.2; PINÇA ATRAUMA GRADUADA 15CM N.3; PINÇA ATRAUMA GRADUADA 15CM N.4; PINÇA ATRAUMA WEBER 26CM CURVA P/ DIREITA; PINÇA ATRAUMA WEBER 26CM CURVA P/ ESQUERDA; PINÇA ATRAUMATICA SATINSKY 12CM; PINÇA ATRAUMATICA SATINSKY 16CM; PINÇA ATRAUMATICA SATINSKY 26CM; PINÇA AUTO-CENTRANTE 150MM; PINÇA AUTO-CENTRANTE 160MM; PINÇA AUTO-CENTRANTE 190MM; PINÇA AUTO-CENTRANTE 240MM; PINÇA AUTO-CENTRANTE 260MM; PINÇA AUTO-CENTRANTE 280MM; PINÇA BABCOCK 16CM T/C; PINÇA BABCOCK 16CM; PINÇA BABCOCK 18CM T/C; PINÇA BABCOCK 18CM; PINÇA BABCOCK 20CM T/C; PINÇA BABCOCK 20CM; PINÇA BABCOCK 22CM T/C; PINÇA BABCOCK 22CM; PINÇA BABCOCK 23CM T/C; PINÇA BABCOCK 23CM; PINÇA BABCOCK 24CM T/C; PINÇA BABCOCK 24CM; PINÇA BABCOCK 26CM T/C; PINÇA BABCOCK 26CM; PINÇA BABCOCK 30CM T/C; PINÇA BABCOCK 30CM; PINÇA BABCOCK 35CM T/C; PINÇA BABCOCK 35CM; PINÇA BABY MIXTER 19CM; PINÇA BABY-OVERHOLT 13,5CM; PINÇA BABY-OVERHOLT 18,5CM; PINÇA BACKHAUS 08CM; PINÇA BACKHAUS 09CM; PINÇA BACKHAUS 10CM; PINÇA BACKHAUS 11CM; PINÇA BACKHAUS 13CM;

PINÇA BACKHAUS 15CM; PINÇA BACKHAUS NAO PERFURANTE 10CM; PINÇA BACKHAUS NAO PERFURANTE 13CM; PINÇA BACKHAUS NAO PERFURANTE 8CM; PINÇA BACKHAUS NAO PERFURANTE 9CM; PINÇA BACKHAUS PEERS BERTRAM 10CM; PINÇA BACKHAUS PEERS BERTRAM 13CM; PINÇA BACKHAUS PEERS BERTRAM 15CM; PINÇA BAINBRIDGE 15CM CURVA; PINÇA BAINBRIDGE 15CM RETA; PINÇA BAINBRIDGE 18CM CURVA; PINÇA BAINBRIDGE 18CM RETA; PINÇA BAKEY BECK 20CM PONTA 65X30MM; PINÇA BAKEY BECK 21CM PONTA 80X45MM; PINÇA BALLANTINE 21CM; PINÇA BALLENGER; PINÇA BARRETT 16CM; PINÇA BARRETT 18CM; PINÇA BECK 17CM; PINÇA BECK 20CM; PINÇA BECK DE BAKEY 17CM CURVA; PINÇA BENGOLEA 22CM CURVA C/ DENTES; PINÇA BENGOLEA 22CM CURVA S/ DENTE; PINÇA BENGOLEA 22CM RETA C/ DENTES; PINÇA BENGOLEA 22CM RETA S/ DENTES; PINÇA BENGOLEA 24CM CURVA C/ DENTES; PINÇA BENGOLEA 24CM CURVA S/ DENTE; PINÇA BENGOLEA 24CM RETA C/ DENTES; PINÇA BENGOLEA 24CM RETA S/ DENTES; PINÇA BERNHARD; PINÇA BIRKETT 19CM CURVA; PINÇA BIRKETT 19CM RETA; PINÇA BIRKETT 20CM CURVA; PINÇA BIRKETT 20CM RETA; PINÇA BLOHMKE; PINÇA BLUMENTHAL 29CM; PINÇA BOZEMANN 26CM; PINÇA BOZEMANN CURVA; PINÇA BOZEMANN RETA; PINÇA BRAGA FARABEUF; PINÇA BREWER 17CM; PINÇA BRUNSCHWIG 22CM CURVA; PINÇA BRUNSCHWIG 22CM RETA; PINÇA BULLDOG ATRAUMA CURVA 10,5CM; PINÇA BULLDOG ATRAUMA CURVA 5,5CM; PINÇA BULLDOG ATRAUMA CURVA 6,5CM; PINÇA BULLDOG ATRAUMA CURVA 8,5CM; PINÇA BULLDOG ATRAUMA RETA 11CM; PINÇA BULLDOG ATRAUMA RETA 6CM; PINÇA BULLDOG ATRAUMA RETA 7CM; PINÇA BULLDOG ATRAUMA RETA 9CM; PINÇA BULLDOG CLAMP ANGULADA COM PONTA 12MM; PINÇA BULLDOG CLAMP ANGULADA COM PONTA 8MM; PINÇA CARANGUEJO; PINÇA CARREL (REINOLDS) 11CM CURVA; PINÇA CARREL (REINOLDS) 11CM RETA; PINÇA CASTANEDA 12,5CM RETA; PINÇA CASTANEDA 12CM ANGULADA 30 GRAUS; PINÇA CASTANEDA 12CM ANGULADA 45 GRAUS; PINÇA CASTANEDA 12CM ANGULADA 90 GRAUS; PINÇA CASTANEDA 13MM Nº 10 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA 13MM Nº 10 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA 13MM Nº 10 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA 13MM Nº 10; PINÇA CASTANEDA 23MM Nº 11 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA 23MM Nº 11 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA 23MM Nº 11 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA 23MM Nº 11; PINÇA CASTANEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA 25° 12,5CM Nº 2; PINÇA CASTANEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA 45° 12,5CM Nº 3; PINÇA CASTANEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA 60° 12,5CM Nº 4; PINÇA CASTANEDA 90° 12,5CM Nº 5 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA 90° 12,5CM Nº 5 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA 90° 12,5CM Nº 5 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA 90° 12,5CM Nº 5; PINÇA CASTANEDA BAIONETA Nº 12 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA BAIONETA Nº 12 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA BAIONETA Nº 12 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA BAIONETA Nº 12; PINÇA CASTANEDA BI-ARTICULADA Nº 13 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA BI-ARTICULADA Nº 13 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA BI-ARTICULADA Nº 13 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA BI-ARTICULADA Nº 13; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 14 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 14 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 14 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 14; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 15 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 15 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 15 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 15; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 16 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 16 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 16 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA CURVA COLHER Nº 16; PINÇA CASTANEDA CURVA FORTE Nº 18 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA CURVA FORTE Nº 18 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA CURVA FORTE Nº 18 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA CURVA FORTE Nº 18; PINÇA CASTANEDA CURVA Nº 17 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA CURVA Nº 17 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA CURVA Nº 17 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA CURVA Nº 17; PINÇA CASTANEDA RETA 12,5CM Nº 1 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA RETA 12,5CM Nº 1 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA RETA 12,5CM Nº 1 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA RETA 12,5CM Nº 1; PINÇA

CASTANEDA TIPO DERRA 10MM Nº 9 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 10MM Nº 9 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 10MM Nº 9 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 10MM Nº 9; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 11,5MM Nº 19 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 11,5MM Nº 19 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 11,5MM Nº 19 - CABO CURVO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 11,5MM Nº 19 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 12MM Nº 7 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 12MM Nº 7 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 12MM Nº 7 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 12MM Nº 7; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 14MM Nº 8 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 14MM Nº 8 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 14MM Nº 8 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 14MM Nº 8; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 17MM Nº 6 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 17MM Nº 6 - CABO ANGULADO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 17MM Nº 6 - CABO RETO; PINÇA CASTANEDA TIPO DERRA 17MM Nº 6; PINÇA CHAPUT 14CM 2X3 DENTES; PINÇA CHEATLE; PINÇA CHERON 24CM; PINÇA CHERON 30CM; PINÇA CLAMP DE LAHEY 24CM 2X2; PINÇA CLAMP JOHNS HOPKINS 24,5CM; PINÇA CLAMP MIXTER 13CM; PINÇA CLAMP MULTIPURPOSE 13CM 30 GRAUS; PINÇA CLAMP MULTIPURPOSE 13CM 50 GRAUS; PINÇA CLAMP P/VEIA CAVA DE BAKEY-BECK; PINÇA CLAMP PARA ANASTOMOSE 15CM 15MM; PINÇA CLAMP PARA ANASTOMOSE 15CM 18MM; PINÇA CLAMP PARA ANASTOMOSE 15CM 22MM; PINÇA CLAMP PATELAR; PINÇA CLAMP TIPO COLHER 13CM; PINÇA CLAMP VASCULAR 35MM CURVO; PINÇA CLAMP VASCULAR 35MM RETO; PINÇA CLEVELAND-GARDNER; PINÇA COLLER-CRILE 14CM ANGULADA; PINÇA COLLER-CRILE 14CM CURVA; PINÇA COLLER-CRILE 14CM RETA; PINÇA COLLER-CRILE 16CM ANGULADA; PINÇA COLLER-CRILE 16CM CURVA; PINÇA COLLER-CRILE 16CM RETA; PINÇA COLLIN 20CM PARA INSTRUMENTOS; PINÇA COLLIN 25CM PARA INSTRUMENTOS; PINÇA COLLIN 27CM P/ INSTRUMENTOS; PINÇA COLLIN ANEL 17CM; PINÇA COLLIN ANEL 19CM; PINÇA COLLIN ANEL 22CM; PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM; PINÇA COLLIN CORACAO 18CM; PINÇA COLLIN CORAÇÃO; PINÇA COLLIN EM T 17CM; PINÇA COLLIN EM T; PINÇA COLLIN LOSANGO 17CM; PINÇA COLLIN OVAL 16CM; PINÇA COLLIN OVAL 19CM; PINÇA COLLIN OVAL 22CM; PINÇA COLLIN OVAL; PINÇA COLLIN PARA CURATIVO 25CM; PINÇA COLLIN TIRA BALA 22CM; PINÇA COLVER 19CM CURVA; PINÇA COLVER 19CM RETA; PINÇA COOLEY 16CM; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PEDÍCULO CURTO; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 15 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 180 GRAUS CURTA; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 180 GRAUS LONGA; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 30 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA 45 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA CURVA; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA PEDÍCULO LONGO; PINÇA COOLEY CABO ANGULADO PONTA RETA; PINÇA COOLEY CABO CURVO PEDÍCULO CURTO; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 15 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 180 GRAUS CURTA; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 180 GRAUS LONGA; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA 45 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA CURVA; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA PEDÍCULO LONGO; PINÇA COOLEY CABO CURVO PONTA RETA; PINÇA COOLEY CABO RETO PEDÍCULO CURTO; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 15 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 180 GRAUS CURTA; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 180 GRAUS LONGA; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 30 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA 45 GRAUS; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA CURVA; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA PEDÍCULO LONGO; PINÇA COOLEY CABO RETO PONTA RETA; PINÇA COOLEY CURVO PONTA 30 GRAUS; PINÇA COSGROVE; PINÇA COTTLE WALSHAM DIREITA 23CM; PINÇA COTTLE WALSHAM ESQUERDA 23CM; PINÇA COTTLE WALSHAM RETA 23CM; PINÇA CRAFOORD 18CM; PINÇA CRAFOORD 24CM CURVA; PINÇA CRAFOORD 24CM RETA; PINÇA CRILE 14CM CURVA DELICADA; PINÇA CRILE 14CM CURVA; PINÇA CRILE 14CM RETA DELICADA; PINÇA CRILE 14CM RETA; PINÇA CRILE 16CM CURVA DELICADA; PINÇA CRILE 16CM CURVA; PINÇA CRILE 16CM RETA DELICADA; PINÇA CRILE 16CM RETA; PINÇA CRILE 18CM CURVA DELICADA; PINÇA CRILE 18CM CURVA; PINÇA CRILE 18CM RETA DELICADA; PINÇA CRILE 18CM RETA; PINÇA CRILE 20CM CURVA DELICADA; PINÇA CRILE 20CM CURVA; PINÇA CRILE 20CM RETA DELICADA; PINÇA CRILE 20CM RETA; PINÇA CRILE-RANKIN 16CM CURVA 1X2 DENTES; PINÇA CRILE-RANKIN 16CM CURVA; PINÇA CRILE-RANKIN 16CM RETA 1X2 DENTES; PINÇA CRILE-RANKIN 16CM RETA; PINÇA DANDY C/ DENTE; PINÇA DANDY; PINCA DARTIGUES 24CM; PINÇA DARTIGUES 26CM;

PINÇA DARTIGUES 27CM; PINÇA DARTIGUES; PINÇA DE APREENSÃO P/ VASECTOMIA PONTA CRUZADA; PINÇA DE APREENSÃO P/ VASECTOMIA PONTA ENCAIXE; PINÇA DE BAKEY 11CM CURVA; PINÇA DE BAKEY 12CM ANGULADA; PINÇA DE BAKEY 12CM CURVA "S" PONTA ATIVA 4,5CM; PINÇA DE BAKEY 12CM RETA PONTA ATIVA 4,5CM; PINÇA DE BAKEY 13CM ANGULADA 45°; PINÇA DE BAKEY 17CM ANGULADA NO CABO; PINÇA DE BAKEY 18CM ANGULADA 60°; PINÇA DE BAKEY 18CM ANGULADA 90° PONTA ATIVA 5CM; PINÇA DE BAKEY 18CM ANGULADA 90° PONTA ATIVA 6,5CM; PINÇA DE BAKEY 18CM EM FORMA "S"; PINÇA DE BAKEY 19CM; PINÇA DE BAKEY 20CM ANGULADA 45° PONTA ATIVA 5,5CM; PINÇA DE BAKEY 20CM EM FORMA "S"; PINÇA DE BAKEY 21CM ANGULADA 45° PONTA ATIVA 7CM; PINÇA DE BAKEY 21CM CURVA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 21CM RETA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 23CM ANGULADA 90° PONTA ATIVA 8CM; PINÇA DE BAKEY 23CM CURVA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 23CM RETA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 23CM; PINÇA DE BAKEY 25CM 60° P/ AORTA; PINÇA DE BAKEY 25CM ANGULADA 45° PONTA ATIVA 9CM; PINÇA DE BAKEY 26CM P/ ANEURISMA; PINÇA DE BAKEY 27CM CURVA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 27CM RETA P/COARTACAO; PINÇA DE BAKEY 27CM; PINÇA DE BAKEY 31CM CURVA; PINÇA DE BAKEY 31CM P/ ANEURISMA; PINÇA DE BAKEY 31CM RETA; PINÇA DE BAKEY 32CM 60° P/ AORTA; PINÇA DE BAKEY 33CM P/ ANEURISMA; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 20CM; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 21CM; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 25CM; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 27CM; PINÇA DE BAKEY 45 GRAUS 29CM; PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 18CM; PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 19CM; PINÇA DE BAKEY 90 GRAUS 23CM; PINÇA DE BAKEY ANGULADA AORTA 60° 32CM C/ CREMALHEIRA LONGA; PINÇA DE BAKEY ANGULADA NO CABO 23CM P/ COARTAÇÃO; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 10CM CURVA 90GRAUS; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 11CM CURVA "S"; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 12CM CURVA "S"; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 12CM CURVA; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 12CM RETA; PINÇA DE BAKEY ATRAUMA 13CM CURVA "S"; PINÇA DE BAKEY CLAMP DE AORTA 25CM; PINÇA DE BAKEY CLAMP DE AORTA 29CM; PINÇA DE BAKEY CLAMP DE AORTA 32CM; PINÇA DE BAKEY CURVA AORTA 29CM; PINÇA DE BAKEY VASCULAR PERIFÉRICA ANGULADA 20CM; PINÇA DE BAKEY VASCULAR PERIFÉRICA CURVA 18,5CM; PINÇA DE DISSEC.E LIGADURA LAHEY (SWEET) 19CM; PINÇA DE DISSEC.E LIGADURA LAHEY (SWEET) 23CM; PINÇA DE DISSECCAO E LIGADURA ZENKER 30CM; PINÇA DE INSERÇÃO PLATÔ TIBIAL; PINÇA DE REMOÇÃO PLATÔ TIBIAL; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 13MM Nº 10 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 13MM Nº 10 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 13MM Nº 10 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 13MM Nº 10; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 23MM Nº 11 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 23MM Nº 11 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 23MM Nº 11 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 23MM Nº 11; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 25° 12,5CM Nº 2 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 25° 12,5CM Nº 2; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 45° 12,5CM Nº 3 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 45° 12,5CM Nº 3; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 60° 12,5CM Nº 4 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 60° 12,5CM Nº 4; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 90° 12,5CM Nº 5 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 90° 12,5CM Nº 5 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 90° 12,5CM Nº 5 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA 90° 12,5CM Nº 5; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA BAIONETA Nº 12 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA BAIONETA Nº 12 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA BAIONETA Nº 12 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA BAIONETA Nº 12; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA BI-ARTICULADA Nº 13 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA BI-ARTICULADA Nº 13 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA BI-ARTICULADA Nº 13 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA BI-ARTICULADA Nº 13; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 14 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 14 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 14 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 14; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 15 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA

COLHER Nº 15 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 15 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 15; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 16 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 16 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 16 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA COLHER Nº 16; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA FORTE Nº 18 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA FORTE Nº 18 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA FORTE Nº 18 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA FORTE Nº 18; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA Nº 17 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA Nº 17 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA Nº 17 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA CURVA Nº 17; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA RETA 12,5CM Nº 1 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA RETA 12,5CM Nº 1 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA RETA 12,5CM Nº 1 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA RETA 12,5CM Nº 1; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 10MM Nº 9 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 10MM Nº 9 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 10MM Nº 9 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 10MM Nº 9; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 11,5MM Nº 19 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 11,5MM Nº 19 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 11,5MM Nº 19 - CABO CURVO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 11,5MM Nº 19 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 12MM Nº 7 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 12MM Nº 7 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 12MM Nº 7 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 12MM Nº 7; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 14MM Nº 8 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 14MM Nº 8 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 14MM Nº 8 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 14MM Nº 8; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 17MM Nº 6 - CABO ANGULADO FORTE; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 17MM Nº 6 - CABO ANGULADO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 17MM Nº 6 - CABO RETO; PINÇA DEBAKEY CASTANHEDA TIPO DERRA 17MM Nº 6; PINÇA DERRA ATRAUMA 16CM ARCO 1,5CM; PINÇA DERRA ATRAUMA 17CM ARCO 2,0CM; PINÇA DERRA ATRAUMA 18CM ARCO 2,5CM; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 17CM Nº. 1; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 17CM Nº. 2; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 17CM Nº. 3; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 18CM Nº. 1; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 18CM Nº. 2; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 18CM Nº. 3; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 19CM Nº. 1; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 19CM Nº. 2; PINÇA DERRA COOLEY GRADUADA 19CM Nº. 3 ; PINÇA DERRA FORTE; PINÇA DESJARDIN 23CM Nº. 1; PINÇA DESJARDIN 23CM Nº. 2; PINÇA DILATADORA AORTICA COOLEY 4 A 10MM INFANTIL; PINÇA DILATADORA AORTICA COOLEY 8 A 15MM ADULTO; PINÇA DILATADORA VALVULA MITRAL 8 A 42MM; PINÇA DINGMAN; PINÇA DIXON-LOVELACE 16CM 1X2 DENTES; PINÇA DIXON-LOVELACE 16CM SERRILHA; PINÇA DOYEN 25CM CURVA; PINÇA DOYEN 25CM INTESTINAL CURVA; PINÇA DOYEN 25CM INTESTINAL RETA; PINÇA DOYEN 25CM RETA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 13CM CURVA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 13CM RETA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 16CM CURVA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 16CM RETA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 18CM CURVA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 18CM RETA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 20 RETA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 20CM CURVA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 21CM CURVA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 21CM RETA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 23CM CURVA; PINÇA DOYEN ATRAUMA 23CM RETA; PINÇA DOYEN-BABY 17CM CURVA; PINÇA DOYEN-BABY 17CM RETA; PINÇA DOYEN-BABY 18CM CURVA; PINÇA DOYEN-BABY 18CM RETA; PINÇA DOYEN-BABY CURVA; PINÇA DOYEN-BABY RETA; PINÇA DUPLAY 25,5CM; PINÇA DUVAL 18CM T/C; PINÇA DUVAL 18CM; PINÇA DUVAL 20CM T/C; PINÇA DUVAL 20CM; PINÇA DUVAL 21CM T/C; PINÇA DUVAL 21CM; PINÇA DUVAL COLLIN 22 CM T/C; PINÇA DUVAL COLLIN Nº. 1 1,2MM 22CM; PINÇA DUVAL COLLIN Nº. 2 1,8 22CM; PINÇA DUVAL COLLIN; PINÇA ESPANHOLA 16CM; PINÇA ESPANHOLA 18CM; PINÇA ESPANHOLA 20CM; PINÇA ESPANHOLA 22CM; PINÇA ESPANHOLA 24CM; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 18CM C/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 18CM S/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 22CM C/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 22CM S/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 26CM C/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 26CM S/CREMALHEIRA;

001405

PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 28CM C/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE 28CM S/CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF ROTULA/OSSOS; PINÇA FARABEUF VAN BUREN 23CM; PINÇA FAURE 21CM CURVA ART.UTER; PINÇA FAURE 21CM RETA ART.UTER; PINÇA FAURE 22CM CURVA ART.UTER;. PINÇA FAURE 22CM RETA ART.UTER.; PINÇA FAURE; PINÇA FAUWEL P/LARINGE; PINÇA FINOCCHIETTO 24CM PARA VESICULA; PINÇA FOERSTER 16CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 16CM CURVA; PINÇA FOERSTER 16CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 16CM RETA; PINÇA FOERSTER 18CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 18CM CURVA; PINÇA FOERSTER 18CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 18CM RETA; PINÇA FOERSTER 20CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 20CM CURVA; PINÇA FOERSTER 20CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 20CM RETA; PINÇA FOERSTER 24CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 24CM CURVA; PINÇA FOERSTER 24CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 24CM RETA; PINÇA FOERSTER 35CM CURVA LISA; PINÇA FOERSTER 35CM CURVA; PINÇA FOERSTER 35CM RETA LISA; PINÇA FOERSTER 35CM RETA; PINÇA FOERSTER BALLENGER 18CM CURVA; PINÇA FOERSTER BALLENGER 18CM RETA; PINÇA FOERSTER BALLENGER 24CM CURVA; PINÇA FOERSTER BALLENGER 24CM RETA; PINÇA FRAENKEL; PINÇA FRYKHOLM 23CM; PINÇA GELLHORN; PINÇA GEMINI 13CM CURVA; PINÇA GEMINI 13CM RETA; PINÇA GEMINI 16CM CURVA; PINÇA GEMINI 16CM RETA; PINÇA GEMINI 18CM CURVA; PINÇA GEMINI 18CM RETA; PINÇA GEMINI 20CM CURVA; PINÇA GEMINI 20CM RETA; PINÇA GEMINI 22CM CURVA; PINÇA GEMINI 22CM RETA; PINÇA GEMINI 23CM CURVA; PINÇA GEMINI 23CM RETA; PINÇA GEMINI 25CM CURVA; PINÇA GEMINI 25CM RETA; PINÇA GEMINI 28CM CURVA; PINÇA GEMINI 28CM RETA; PINÇA GLOVER 11CM CURVA; PINÇA GLOVER 11CM RETA; PINÇA GLOVER 6CM CURVA; PINÇA GLOVER 6CM RETA; PINÇA GLOVER 7CM CURVA; PINÇA GLOVER 7CM RETA; PINÇA GLOVER 9CM CURVA; PINÇA GLOVER 9CM RETA; PINÇA GLOVER BULLDOG 10CM CURVA; PINÇA GLOVER BULLDOG 10CM RETA; PINÇA GLOVER BULLDOG 12CM CURVA; PINÇA GLOVER BULLDOG 12CM RETA; PINÇA GLOVER BULLDOG 7CM CURVA; PINÇA GLOVER BULLDOG 7CM RETA; PINÇA GLOVER BULLDOG 8CM CURVA; PINÇA GLOVER BULLDOG 8CM RETA; PINÇA GLOVER DE BAKEY 17CM CURVA BOCA 5CM; PINÇA GLOVER DE BAKEY 17CM CURVA; PINÇA GRAY 22CM PEDICULO; PINÇA GRAY 24CM PEDICULO; PINÇA GRAY 26CM PEDICULO; PINÇA GUYON 16CM; PINÇA GUYON 20CM; PINÇA GUYON 22CM; PINÇA GUYON 24CM; PINÇA GUYON 26CM; PINÇA HALSTEAD MOSQ. MICRO 10CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQ. MICRO 10CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQ. MICRO 14CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQ. MICRO 14CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQ.12CM C/DENTE CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQ.12CM C/DENTE RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQ.MICRO 12CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQ.MICRO 12CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 10CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 18CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 18CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 21CM CURVA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 21CM RETA; PINÇA HALSTEAD MOSQUITO PARA ELASTIC; PINÇA HALSTED MOSQUITO 14CM CURVA; PINÇA HALSTED MOSQUITO 14CM RETA; PINÇA HALSTED MOSQUITO 16CM CURVA; PINÇA HALSTED MOSQUITO 16CM RETA; PINÇA HARTMANN CLAMP INTESTINAL 20CM CURVA; PINÇA HARTMANN CLAMP INTESTINAL 20CM RETA; PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA CIMA; PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA ESQUERDA; PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM CURVA PARA/ DIREITA; PINÇA HARTMANN MICRO AURICULAR 8CM RETA; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO 09CM COM DENTE; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM C/DENTE 25CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM DENTE 20CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 09CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 14CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 15CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 16,5CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 20CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 25CM; PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 28CM; PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR 15CM; PINÇA HARTMANN PARA CURATIVO AURICULAR 19CM; PINÇA HEANEY 20CM CURVA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 20CM CURVA 2 DENTES; PINÇA HEANEY 20CM RETA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 20CM; PINÇA HEANEY 24CM CURVA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 24CM CURVA 2 DENTES; PINÇA HEANEY 24CM RETA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 26CM; PINÇA HEANEY 35CM CURVA 1 DENTE; PINÇA HEANEY 35CM CURVA 2 DENTES; PINÇA HEANEY 35CM RETA 1 DENTE; PINÇA HEANEY-BALLANTINE 21CM; PINÇA HEANEY-

GLASSMAN 20CM ANGULADA; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM CURVA FORTE; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM CURVA LEVE; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 20CM RETA; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM ANGULADA; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM CURVA FORTE; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM CURVA LEVE; PINÇA HEANEY-GLASSMAN 22CM RETA; PINÇA HEISS 20CM C/DENTE CURVA; PINÇA HEISS 20CM C/DENTE RETA; PINÇA HEISS 20CM CURVA; PINÇA HEISS 20CM RETA; PINÇA HEISS CURVA FORTE 21CM; PINÇA HEMOSTÁTICA ATRAUMÁTICA BLALOCK 15CM 14MM P/ CARDIO; PINÇA HEMOSTÁTICA ATRAUMÁTICA BLALOCK 20CM 18MM P/ CARDIO; PINÇA HEMOSTÁTICA ATRAUMÁTICA BLALOCK 20CM 23MM P/ CARDIO; PINÇA HEMOSTATICA PEAN CURVA 28CM; PINÇA HEMOSTATICA PEAN RETA 28CM; PINÇA HENNING; PINÇA INDIRETA LARINGE APREENSÃO TIPO jacaré 25CM curva p/ baixo ponta 18mm; PINÇA JACARE DELICADA P/TIMPANO; PINÇA JACOBS 24CM CURVA COLO-UTERINO; PINÇA JACOBS 24CM RETA COLO-UTERINO; PINÇA JAVID 18CM P/ CAROTIDA CURVA; PINÇA JAVID 18CM P/ CARÓTIDA RETA; PINÇA JAVID 19CM P/ CAROTIDA CURVA; PINÇA JAVID 19CM P/ CARÓTIDA RETA; PINÇA JOHNS-HOPKINS 20CM; PINÇA JOHNS-HOPKINS 23CM; PINÇA JOHNS-HOPKINS 25CM; PINÇA JONES (SPENCER-WELLS) 12,5CM CURVA; PINÇA JONES (SPENCER-WELLS) 12,5CM RETA; PINÇA JONES (SPENCER-WELLS) 15CM CURVA; PINÇA JONES (SPENCER-WELLS) 15CM RETA; PINÇA JONES 9CM; PINÇA KAPP BECK RETA/ANGULADA/CURVA; PINÇA KELLY 12CM CURVA; PINÇA KELLY 12CM RETA; PINÇA KELLY 14CM CURVA DELICADA; PINÇA KELLY 14CM CURVA; PINÇA KELLY 14CM RETA DELICADA; PINÇA KELLY 14CM RETA; PINÇA KELLY 16CM CURVA; PINÇA KELLY 16CM RETA; PINÇA KELLY 18CM CURVA; PINÇA KELLY 18CM RETA; PINÇA KELLY 20CM CURVA; PINÇA KELLY 20CM RETA; PINÇA KELLY 32CM CURVA; PINÇA KELLY 32CM RETA; PINÇA KELLY UTERINA; PINÇA KELLY-RANKIN 16CM CURVA; PINÇA KELLY-RANKIN 16CM RETA; PINÇA KERR MINI; PINÇA KOCHER 14CM CURVA; PINÇA KOCHER 14CM RETA; PINÇA KOCHER 16CM CURVA; PINÇA KOCHER 16CM RETA; PINÇA KOCHER 18CM CURVA; PINÇA KOCHER 18CM RETA; PINÇA KOCHER 20CM CURVA; PINÇA KOCHER 20CM RETA; PINÇA KOCHER 22CM CURVA; PINÇA KOCHER 22CM RETA; PINÇA KOCHER 24CM CURVA; PINÇA KOCHER 24CM RETA; PINÇA KOCHER 25CM CURVA; PINÇA KOCHER 25CM RETA; PINÇA KOCHER 26CM CURVA; PINÇA KOCHER 26CM RETA; PINÇA KOCHER 30CM CURVA; PINÇA KOCHER 30CM RETA; PINÇA KOCHER ATRAUMA 25CM CURVA; PINÇA KOCHER ATRAUMA 25CM RETA; PINÇA KOCHER ATRAUMA 28CM CURVA; PINÇA KOCHER ATRAUMA 28CM RETA; PINÇA KOCHER INTESTINAL 25CM CURVA; PINÇA KOCHER INTESTINAL 25CM RETA; PINÇA KOGAN 24CM PONTA 3MM; PINÇA KOGAN 24CM PONTA 4MM; PINÇA KOGAN 24CM PONTA 5MM; PINÇA KOGAN 26CM PONTA 3MM; PINÇA KOGAN 26CM PONTA 4MM; PINÇA KOGAN 26CM PONTA 5MM; PINÇA KOGAN 26CM; PINÇA LAHEY 16CM RETA 2X2 P/BOCIO; PINÇA LAHEY 16CM RETA 3X3 P/BOCIO; PINÇA LAHEY 18CM RETA 2X2 P/BOCIO; PINÇA LAHEY 19CM P/ DUCTO BILIAR; PINÇA LAHEY 23CM RETA 2X2 P/BOCIO; PINÇA LAHEY 24CM P/ DUCTO BILIAR; PINÇA LAHEY 24CM RETA 2X2 P/BOCIO; PINÇA LAHEY 24CM RETA 3X3 P/BOCIO; PINÇA LAMBERT-KAY 21CM CORPO EM "S"; PINÇA LANE P/CAMPO 20CM; PINÇA LANE PORTA-PARAFUSOS; PINÇA LANE PORTA-PLACAS; PINÇA LAWRENCE 27,5CM; PINÇA LELAND JONES ANGULADA 19CM; PINÇA LELAND JONES PARA VASOS PERIFÉRICA ANGULADA 15° 19CM; PINÇA LELAND JONES PARA VASOS PERIFÉRICA ANGULADA 30° 19CM; PINÇA LELAND JONES PARA VASOS PERIFÉRICA ANGULADA 60° 19CM; PINÇA LEMOLE STRONG; PINÇA LERICHE 15CM CURVA C/DENTE; PINÇA LERICHE 15CM CURVA; PINÇA LERICHE 15CM RETA C/DENTE; PINÇA LERICHE 15CM RETA; PINÇA LIGA CLIP GRANDE PONTA ANGULADA 19CM; PINÇA LIGA CLIP GRANDE PONTA ANGULADA 28CM; PINÇA LIGA CLIP GRANDE PONTA RETA 19CM; PINÇA LIGA CLIP GRANDE PONTA RETA 28CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO GRANDE PONTA ANGULADA 19CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO GRANDE PONTA ANGULADA 28CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO GRANDE PONTA RETA 19CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO GRANDE PONTA RETA 28CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO PONTA ANGULADA 15CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO PONTA ANGULADA 19CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO PONTA ANGULADA 28CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO PONTA RETA 15CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO PONTA RETA 19CM; PINÇA LIGA CLIP MÉDIO PONTA RETA 28CM; PINÇA LIGA CLIP PEQUENO PONTA ANGULADA 15CM; PINÇA LIGA CLIP PEQUENO PONTA ANGULADA 19CM; PINÇA LIGA CLIP PEQUENO PONTA RETA 15CM; PINÇA LIGA CLIP PEQUENO PONTA RETA 19CM; PINÇA LORNA 10CM P/CAMPO; PINÇA LORNA 13CM P/CAMPO; PINÇA LOVELACE 20CM; PINÇA LOWER 18CM; PINÇA LOWMANN 12CM; PINÇA LOWMANN 13CM; PINÇA LOWMANN 15CM; PINÇA LOWMANN 17CM; PINÇA LOWMANN 18,5CM; PINÇA LOWMANN 20CM; PINÇA LOWMANN 22CM; PINÇA LOWMANN

001406

HOGLUND; PINÇA LUC NASAL Nº1; PINÇA LUC NASAL Nº2; PINÇA LUC; PINÇA MACKENZIE 15CM CURVA P/CLIPS; PINÇA MACKENZIE 18CM CURVA P/CLIPS; PINÇA MAGILL 15CM; PINÇA MAGILL 16CM; PINÇA MAGILL 17CM; PINÇA MAGILL 18CM; PINÇA MAGILL 20CM; PINÇA MAGILL 25CM; PINÇA MAIER 26CM C/CREMALHEIRA; PINÇA MAINGOT 20CM 1X2 DENTES; PINÇA MAINGOT 25CM 1X2 DENTES; PINÇA MARTEL; PINÇA MARTIN 19CM; PINÇA MARTIN 21CM; PINÇA MATHIEU P/ CORPO ESTRANHO 20CM; PINÇA MATHIEU P/ CORPO ESTRANHO 25CM; PINÇA MATHIEU P/ CORPO ESTRANHO 28CM; PINÇA MAYO ROBSON 25CM CURVA; PINÇA MAYO ROBSON 25CM RETA; PINÇA MAYO-BLAKE 20CM; PINÇA MCGEE 0,6X0,6MM; PINÇA MCGEE 0,8X3,5MM; PINÇA MCKENZIE CURVA PARA CLIPS 18CM; PINÇA MÉDIA AORTA 23CM; PINÇA MENKEN 24CM C/CREMALHEIRA; PINÇA MENKEN 24CM S/CREMALHEIRA; PINÇA MENKEN 27CM C/ CREMALHEIRA; PINÇA MENKEN 27CM S/CREMALHEIRA; PINÇA MENKEN OU KOGAN; PINÇA MICHEL PARA COLOCAR/RETIRAR AGRAFES; PINÇA MIKUI ICZ 20CM 1X2 DENTES; PINÇA MINI FRIEDMAN ANGULADA; PINÇA MINI FRIEDMAN DELICADA RETA; PINÇA MINI FRIEDMAN RETA; PINÇA MINI GEMINI 18CM; PINÇA MINI GEMINI 22CM; PINÇA MINI GEMINI 25CM; PINÇA MINI GEMINI 28CM; PINÇA MIXTER 17CM DELICADA; PINÇA MIXTER 17CM; PINÇA MIXTER 18CM DELICADA; PINÇA MIXTER 18CM; PINÇA MIXTER 20CM DELICADA; PINÇA MIXTER 20CM; PINÇA MIXTER 22CM DELICADA; PINÇA MIXTER 22CM; PINÇA MIXTER 24CM DELICADA; PINÇA MIXTER 24CM; PINÇA MIXTER 30CM DELICADA; PINÇA MIXTER 30CM; PINÇA MIXTER 35CM; PINÇA MIXTER BABY 14CM; PINÇA MIXTER BABY 16CM; PINÇA MIXTER BABY CURVA 19CM; PINÇA MIXTER BABY CURVA FORTE 14CM; PINÇA MIXTER CURVA 23CM; PINÇA MIXTER CURVA DELICADA 23CM; PINÇA MIXTER CURVA EXTRA DELICADA 23CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 12CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 14CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 17CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 20CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 23CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 24CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 25CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 27CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 28CM; PINÇA MIXTER EXTRA DELICADA 30CM; PINÇA MIXTER O`SHAUGNESSY 19CM; PINÇA MIXTER SEM CREMALHEIRA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 10CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 10CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 12CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 12CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 13CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 13CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 16CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 16CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 18CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 18CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 21CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 21CM RETA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 23CM CURVA; PINÇA MOSQUITO ATRAUMA 23CM RETA; PINÇA MOSQUITO P/VASECTOMIA LISA CURVA 12CM; PINÇA MOYNIHAM 21CM; PINÇA MOYNIHAM 23CM; PINÇA MOYNIHAM 24CM; PINÇA MUSEAUX CURVA; PINÇA MUSEAUX RETA; PINÇA NEGUS 20CM; PINÇA OSSEA AUTO RETENTOR 16CM; PINÇA OSSEA LEWIN 18CM; PINÇA OSSEA STEINHAUSER CURVA 13CM; PINÇA OSSEA STEINHAUSER RETA 13CM; PINÇA OSSEA ULRICH 22CM; PINÇA OSSEA ULRICH 23CM; PINÇA OSSEA ULRICH 25CM; PINÇA OSSEA ULRICH 27CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 25CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 26CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 10MM 27CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 25CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 26CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 11MM 27CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 25CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 26CM; PINÇA OSSEA VERBRUGE 12MM 27CM; PINÇA OVERHOLT 18,5CM; PINÇA OVERHOLT-GEISSENDOERFER 21CM CURVA; PINÇA OVERHOLT-GEISSENDOERFER 27CM CURVA; PINÇA P/ EXTRAÇÃO DE PREGO; PINÇA P/ ORDENHA SECREÇÃO TUBO 25CM; PINÇA P/ TORACTOMIA CURVA P/ BAIXO; PINÇA P/ TORACTOMIA CURVA P/ CIMA; PINÇA P/ANASTOMOSE COOLEY PEDIATRICA 24X160MM; PINÇA P/COARTACAO DE DUTOS PEDIATRICA 52X67X170MM; PINÇA P/TRANSPLANTE DE FIGADO 27CM; PINÇA P/TRANSPLANTE DE FIGADO 30CM; PINÇA PALMER; PINÇA PARA AGARRE MILLIN 235MM; PINÇA PARA AGARRE MILLIN 245MM; PINÇA PARA ANASTOMOSE COOLEY 44X260MM; PINÇA PARA ANASTOMOSE COOLEY 50X265MM; PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 110X300MM; PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 130X315MM; PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 60X111X270MM; PINÇA PARA AORTA ANEURISMA DE BAKEY 93X240MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANG.15GRAUS 50X165MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 17CM 40MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 17CM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 23CM 55MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY ANGULADA 23CM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY RETA 17CM 40MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY RETA 17CM; PINÇA

PARA COARTACAO DE BAKEY RETA 23CM 55MM; PINÇA PARA COARTACAO DE BAKEY RETA 23CM; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 14CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 16CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 21CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 30CM SEMICURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM ANGULADA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM CURVA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM RETA; PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 35CM SEMICURVA; PINÇA PATELAR; PINÇA PAYR 20CM; PINÇA PAYR 29CM; PINÇA PAYR 35CM; PINÇA PEAN 14CM; PINÇA PEAN 16CM; PINÇA PEAN 20CM; PINÇA PEAN 28CM; PINÇA PEAN MURPHY 14CM; PINÇA PEAN MURPHY 16CM; PINÇA PEAN MURPHY 20CM; PINÇA PEET; PINÇA PELKMANN 24CM; PINÇA PENNINGTON RETA TRIANGULAR 15CM; PINÇA PENNINGTON RETA TRIANGULAR 19CM; PINÇA PENNINGTON RETA TRIANGULAR 20CM; PINÇA PHANEUF 21CM UTERINA CURVA; PINÇA PHANEUF 21CM UTERINA RETA; PINÇA PORTA CLIP DE YASARGIL; PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA 21CM; PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA 22CM; PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA P/BAIXO 21CM; PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA P/BAIXO 22CM; PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA P/CIMA 21CM; PINÇA POTTS ATRAUMA CURVA P/CIMA 22CM; PINÇA POTTS ATRAUMA ONDULADA 21CM; PINÇA POTTS ATRAUMA ONDULADA 22CM; PINÇA POTTS ATRAUMA RETA 21CM; PINÇA POTTS ATRAUMA RETA 22CM; PINÇA POTTS DE BAKEY 21CM CABO ANGULADO PONTA RETA; PINÇA POTTS DE BAKEY 21CM CABO RETO PONTA ANGULADA; PINÇA POTTS DE BAKEY 22CM CABO ANGULADO PONTA RETA; PINÇA POTTS DE BAKEY 22CM CABO RETO PONTA ANGULADA; PINÇA POTTS DE BAKEY 22CM CURVA GUYON; PINÇA POTTS DE BAKEY 22CM CURVA; PINÇA POTTS SATINSKY 22CM; PINÇA POZZI 17CM; PINÇA POZZI 18CM; PINÇA POZZI 24CM; PINÇA POZZI 25CM; PINÇA PRICE THOMAS 23CM; PINÇA PROVIDENCE-HOSPITAL 13CM CURVA; PINÇA PROVIDENCE-HOSPITAL 13CM RETA; PINÇA PROVIDENCE-HOSPITAL 14CM CURVA; PINÇA PROVIDENCE-HOSPITAL 14CM RETA; PINÇA RAMPLEY 18CM; PINÇA RAMPLEY 25CM; PINÇA RANDALL Nº.1; PINÇA RANDALL Nº.2; PINÇA RANDALL Nº.3; PINÇA RANDALL Nº.4; PINÇA RANDALL Nº.5; PINÇA RANDALL Nº.6; PINÇA REDUCAO 13CM; PINÇA REDUCAO 20CM; PINÇA REDUTORA 16CM; PINÇA REINOLD 16CM; PINÇA REINOLD 18CM; PINÇA REINOLD 20CM (TUBOS); PINÇA ROCHESTER CARMALT 16CM CURVA; PINÇA ROCHESTER CARMALT 16CM RETA; PINÇA ROCHESTER CARMALT 18CM CURVA; PINÇA ROCHESTER CARMALT 18CM RETA; PINÇA ROCHESTER CARMALT 20CM CURVA; PINCA ROCHESTER CARMALT 20CM RETA; PINCA ROCHESTER CARMALT 22CM CURVA; PINCA ROCHESTER CARMALT 22CM RETA; PINCA ROCHESTER CARMALT 24CM CURVA; PINCA ROCHESTER CARMALT 24CM RETA; PINÇA ROCHESTER LATERAL 16CM; PINÇA ROCHESTER LATERAL 20CM; PINÇA ROCHESTER PEAN 16CM CURVA; PINÇA ROCHESTER PEAN 16CM RETA; PINÇA ROCHESTER PEAN 18CM CURVA; PINÇA ROCHESTER PEAN 18CM RETA; PINÇA ROCHESTER PEAN 20CM CURVA; PINÇA ROCHESTER PEAN 20CM RETA; PINÇA ROCHESTER PEAN 22CM CURVA; PINÇA ROCHESTER PEAN 22CM RETA; PINÇA ROCHESTER PEAN 24CM CURVA; PINÇA ROCHESTER PEAN 24CM RETA; PINÇA ROCHESTER PEAN 26CM CURVA; PINÇA ROCHESTER PEAN 26CM RETA; PINÇA ROCHESTER PEAN 30CM CURVA; PINÇA ROCHESTER PEAN 30CM RETA; PINÇA ROGGE 25CM; PINÇA ROWE DIREITA 23CM; PINÇA ROWE ESQUERDA 23CM; PINÇA RUDERT NASAL; PINÇA SACA PROVISÓRIO 45°; PINÇA SACA PROVISÓRIO 90°; PINÇA SACA PROVISÓRIO; PINÇA SACA TROMBO 28CM; PINÇA SATINSKY 24,5CM PONTA 35MM; PINÇA SATINSKY 24,5CM PONTA 45MM; PINÇA SATINSKY 24,5CM PONTA 55MM; PINÇA SATINSKY 24,5CM PONTA 65MM; PINÇA SATINSKY 24,5CM PONTA 75MM; PINÇA SATINSKY ATRAUMATICA 20CM; PINÇA SATINSKY ATRAUMATICA 24CM; PINÇA SATINSKY BABY SERRA CRUZADA 12CM; PINÇA SATINSKY BABY SERRA CRUZADA 15CM; PINÇA SATINSKY DE BAKEY 16CM; PINÇA SATINSKY DE BAKEY 20CM; PINÇA SATINSKY DE BAKEY 24CM; PINÇA SATINSKY DE BAKEY 27CM; PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 18CM; PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 20CM; PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 22CM; PINÇA SATINSKY

001407

SERRA CRUZADA 24CM; PINÇA SATINSKY SERRA CRUZADA 26CM; PINÇA SCHIMIDT 18CM CURVA; PINÇA SCHIMIDT 18CM RETA; PINÇA SCHLESINGER 15,2CM PONTA 2X10MM; PINÇA SCHLESINGER 15,2CM PONTA 3X10MM; PINÇA SCHLESINGER 15,2CM PONTA 4X10MM; PINÇA SCHNIDT 18CM CURVA FORTE; PINÇA SCHNIDT 18CM CURVA; PINÇA SCHNIDT 18CM RETA; PINÇA SCHNIDT CURVA P/ DUCTO BILIAR; PINÇA SCHROEDER 24CM; PINÇA SCHROEDER RETA 2X2 25CM; PINÇA SCOOB-ALLIS 20CM; PINÇA SEMB 24CM; PINÇA SEMB CARDIO 23CM Nº1 E Nº2; PINÇA SEMB CURVA LEVE 24CM; PINÇA SKILLMAN 12CM CURVA; PINÇA SKILLMAN 12CM RETA; PINÇA SNELLEN 9CM DIREITA; PINÇA SNELLEN 9CM ESQUERDA; PINÇA SPENCER-WELLS 13CM CURVA; PINÇA SPENCER-WELLS 13CM RETA; PINÇA SPENCER-WELLS 17CM CURVA; PINÇA SPENCER-WELLS 17CM RETA; PINÇA STIEGLITZ 15CM 45 GRAUS; PINÇA STIEGLITZ 15CM 90 GRAUS; PINÇA STIEGLITZ 15CM RETA; PINÇA STIEGLITZ 20CM 45 GRAUS; PINÇA STIEGLITZ 20CM 90 GRAUS; PINÇA STIEGLITZ 20CM RETA; PINÇA STIEGLITZ 23CM 45 GRAUS; PINÇA STIEGLITZ 23CM 90 GRAUS; PINÇA STIEGLITZ 23CM RETA; PINÇA SUBRAMANIAN-MINIATURA "S" 15CM; PINÇA SUBRAMANIAN-MINIATURA DIREITA 16CM; PINÇA SUBRAMANIAN-MINIATURA ESQUERDA 16CM; PINÇA THOMS-ALLIS 20CM 6X7 DENTES; PINÇA TIPO LAÇO 23CM; PINÇA TUBO (REINOLD) 18CM; PINÇA TUMOR NICOLA; PINÇA TYDING 20CM 2X2 DENTES AMIGDALAS; PINÇA TYDING 20CM 3X3 DENTES AMIGDALAS; PINÇA VALVULA MITRAL 34CM; PINÇA WERTHEIM CULLEN 22CM; PINÇA WERTHEIM CULLEN CLAMP 22CM; PINÇA WERTHEIM ESTOMAGO 23CM; PINÇA WHITE 20CM; PINÇA WIKSTROEM 22CM; PINÇA WINTER 27CM Nº1 CURVA; PINÇA WINTER 27CM Nº1 RETA; PINÇA WINTER 27CM Nº2 CURVA; PINÇA WINTER 27CM Nº2 RETA; PINÇA WINTER 27CM Nº3 CURVA; PINÇA WINTER 27CM Nº3 RETA; PINÇA WOLFF 23CM; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 14CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 14CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 14CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 14CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 16CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 16CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 16CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 16CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 21CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 21CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 21CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 21CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 24CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 30CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 30CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 30CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 30CM SEMICURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 35CM ANGULADA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 35CM CURVA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 35CM RETA; PINÇA Z CLAMP PARAMETRIAL 35CM SEMICURVA; PINÇA ZENKER 29,5CM CURVA; PINÇA ZENKER 29,5CM RETA; PINÇA ZENKER 29,5CM SEMI CURVA; PORTA AGULHA ADSON 17CM T/C; PORTA AGULHA ADSON 17CM; PORTA AGULHA ADSON 24CM T/C; PORTA AGULHA ADSON 24CM; PORTA AGULHA ARRUGA 16CM CURVO T/C; PORTA AGULHA ARRUGA 16CM RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM C/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM C/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM C/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM C/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM S/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM S/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM S/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 12CM S/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM C/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM C/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM C/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM C/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM S/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM S/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM S/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 14CM S/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM C/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM C/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM C/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM C/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM S/ TRAVA CURVO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM S/ TRAVA CURVO; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM S/ TRAVA RETO T/C; PORTA AGULHA BARRAQUER 18CM S/ TRAVA RETO; PORTA AGULHA BAUMGARTENER 14CM T/C; PORTA AGULHA BAUMGARTENER 14CM; PORTA AGULHA BAUMGARTENER 20CM T/C; PORTA AGULHA BAUMGARTENER 20CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY 35CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 15CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 18CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 20CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 23CM;

PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 26CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 30CM; PORTA AGULHA CARDIO DE BAKEY T/C 35CM; PORTA AGULHA CARDIO HEGAR T/C 14CM DELICADO; PORTA AGULHA CARDIO HEGAR T/C 18CM DELICADO; PORTA AGULHA CARDIO HEGAR T/C 20CM DELICADO; PORTA AGULHA CARDIO HEGAR T/C 23CM DELICADO; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 14CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 18CM PONTA 1MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 18CM PONTA 2MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 18CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 20CM PONTA 1MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 20CM PONTA 2MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 20CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 23CM PONTA 1MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 23CM PONTA 2MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 23CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 25CM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 26CM PONTA 1MM; PORTA AGULHA CARDIO RYDER T/C 26CM PONTA 2MM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 12CM RETO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 14CM RETO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 15CM RETO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 18CM RETO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM CURVO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM CURVO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM CURVO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM CURVO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM RETO COM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM RETO COM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM RETO SEM TRAVA T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM RETO SEM TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO 21CM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO BIARTICULADO CABO REDONDO COM TRAVA 22CM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO BIARTICULADO CABO REDONDO SEM TRAVA 22CM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 14CM T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 14CM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 18CM C/ TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 18CM S/ TRAVA; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 18CM T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 18CM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 21CM T/C; PORTA AGULHA CASTROVIEJO CABO REDONDO 21CM; PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO MOLA INVERTIDA; PORTA AGULHA COLLIER 12,5CM; PORTA AGULHA CONVERSE 15CM; PORTA AGULHA CONVERSE 16CM; PORTA AGULHA CRILE MURRAY 15CM; PORTA AGULHA CRILE WOOD 15CM T/C; PORTA AGULHA CRILE WOOD 15CM; PORTA AGULHA CRILE WOOD 16CM T/C; PORTA AGULHA CRILE WOOD 16CM; PORTA AGULHA CRILE WOOD 18CM T/C; PORTA AGULHA CRILE WOOD 18CM; PORTA AGULHA DERF 12CM T/C; PORTA AGULHA DERF 12CM; PORTA AGULHA DERF 16CM T/C; PORTA AGULHA DERF 16CM; PORTA AGULHA ERMOLD 18CM; PORTA AGULHA ERMOLD 20CM; PORTA AGULHA FINOCHIETTO 22CM CURVO T/C; PORTA AGULHA GILETTE CASTROVIEJO FINO; PORTA AGULHA GILETTE CASTROVIEJO GROSSO; PORTA AGULHA GILLIES 16CM; PORTA AGULHA GILLIES T/C; PORTA AGULHA HALSEY 13CM; PORTA AGULHA HEANEY 20CM CURVO T/C; PORTA AGULHA HEANEY 20CM CURVO; PORTA AGULHA HEANEY 23CM CURVO T/C; PORTA AGULHA HEANEY 23CM CURVO; PORTA AGULHA HEANEY 24CM CURVO T/C;

001403

PORTA AGULHA HEANEY 24CM CURVO; PORTA AGULHA HEANEY 25CM CURVO T/C; PORTA AGULHA HEANEY 25CM CURVO; PORTA AGULHA HEANEY 26CM CURVO T/C; PORTA AGULHA HEANEY 26CM CURVO; PORTA AGULHA HEGAR-VASCULAR 14CM T/C; PORTA AGULHA HEGAR-VASCULAR 18CM T/C; PORTA AGULHA HEGAR-VASCULAR 20 CM T/C; PORTA AGULHA HEGAR-VASCULAR 23CM T/C; PORTA AGULHA HELLBERG T/C; PORTA AGULHA HODLICK 18CM; PORTA AGULHA KILNER 13CM T/C; PORTA AGULHA KILNER 13CM; PORTA AGULHA KILNER 15CM T/C; PORTA AGULHA KILNER 15CM; PORTA AGULHA KILNER 18CM T/C; PORTA AGULHA KILNER 18CM; PORTA AGULHA MASSON 26CM T/C; PORTA AGULHA MASSON 26CM; PORTA AGULHA MASSON 28CM T/C; PORTA AGULHA MASSON 28CM; PORTA AGULHA MATHIEU 11CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 11CM; PORTA AGULHA MATHIEU 14CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 14CM; PORTA AGULHA MATHIEU 15CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 15CM; PORTA AGULHA MATHIEU 16CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 16CM; PORTA AGULHA MATHIEU 17CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 17CM; PORTA AGULHA MATHIEU 18CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 18CM; PORTA AGULHA MATHIEU 20CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 20CM; PORTA AGULHA MATHIEU 25CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 25CM; PORTA AGULHA MATHIEU 30CM T/C; PORTA AGULHA MATHIEU 30CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 17CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 17CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 30CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 30CM; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 35CM T/C; PORTA AGULHA MAYO HEGAR 35CM; PORTA AGULHA MC PHERSON CURVO; PORTA AGULHA MC PHERSON RETO; PORTA AGULHA MICRO VASCULAR 18CM T/C; PORTA AGULHA MICRO VASCULAR 20CM T/C; PORTA AGULHA MICRO VASCULAR 23CM T/C; PORTA AGULHA MICRO VASCULAR DELICADO 18CM T/C; PORTA AGULHA MICRO VASCULAR DELICADO 20CM T/C; PORTA AGULHA MICRO VASCULAR DELICADO 23CM T/C; PORTA AGULHA MINI GILLIES 13CM; PORTA AGULHA NEIVERT 13CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR T/C 17CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR 14CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR 15CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR 16CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR 17CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR 18CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR 19CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR T/C 14CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR T/C 15CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR T/C 16CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR T/C 18CM; PORTA AGULHA OLSEN HEGAR T/C 19CM; PORTA AGULHA P/ CORONÁRIA 17CM T/C; PORTA AGULHA P/ CORONÁRIA 20CM T/C; PORTA AGULHA P/ FIO DE AÇO 25CM T/C; PORTA AGULHA P/ FIO DE AÇO 25CM; PORTA AGULHA PARA FIO DE ACO 16CM T/C; PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 16CM; PORTA AGULHA PARA FIO DE ACO 19CM T/C; PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 19CM; PORTA AGULHA PARA FIO DE ACO 20CM T/C; PORTA AGULHA PARA FIO DE ACO 20CM; PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO BERRY 20CM; PORTA AGULHA REHBEIN-BABY 11,5CM; PORTA AGULHA REHBEIN-BABY 14CM; PORTA AGULHA SAROT 17CM T/C; PORTA AGULHA SAROT 20CM T/C; PORTA AGULHA STERNAL PARA FIO DE AÇO 18CM; PORTA AGULHA STRATTE 23CM T/C; PORTA AGULHA VASCULAR 18CM CURVO; PORTA AGULHA VASCULAR 18CM RETO; PORTA AGULHA WANGENSTEEN 27CM T/C; PORTA AGULHA WANGENSTEEN 27CM; PORTA AGULHA WEBSTER WRIGHT 12,5CM; PORTA AGULHA WEBSTER; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM CURVO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM CURVO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM RETO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 16CM RETO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM CURVO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM CURVO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM RETO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 18CM RETO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM CURVO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM CURVO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM RETO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 20CM RETO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM CURVO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM CURVO S/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM RETO C/ TRAVA; PORTA AGULHA YASARGIL (JACOBSON) 22,5CM RETO S/ TRAVA; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE

ADULTO; PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL; SACA PRÓTESES COM 5 PONTAS 19CM; SEPARADOR DE PALATO TURVEY; SUPORTE MAYFIELD; VÁLVULA GINECOLÓGICA AUVARD COM PESO;

001409

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	10304850055
Processo	25351.471805/2006-89
Origem do Produto	• FABRICANTE: ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

51

001410

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
CNPJ	58.268.152/0001-50	**Autorização**	1.03.048-5
Produto	INSTRUMENTAL CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE		

Modelo Produto Médico

AGULHA REVERDIN Nº.1 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.2 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.3 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.4 23CM; ALICATE AINSWORTH; ALICATE BERNARDINHO 30CM T/C; ALICATE BERNARDINHO 47CM T/C; ALICATE BERNARDÃO 55CM T/C; ALICATE BETHUNE 34CM; ALICATE CORTA PINO INTERCAMBEÁVEL 57,5CM; ALICATE CORTA FIO 14CM ATÉ 0,8MM T/C; ALICATE CORTE DISTAL 154; ALICATE CORTE DISTAL T/C; ALICATE P/ CORTE CINTA DE ESTERNO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO T/C; ALICATE CORTE FRONTAL T/C; ALICATE CORTE FRONTAL 16CM; ALICATE CORTE LATERAL P/ OSSO; ALICATE CORTE LATERAL 12CM; ALICATE DUPLA FORÇA 15CM; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM; ALICATE Nº.141; ALICATE DUPLA FORÇA 18CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 25CM T/C; ALICATE P/ CORTE DE ANEL; ALICATE REIL T/C; ALICATE RUSKIN; ALICATE SEGURA E CORTA 16CM T/C; ALICATE SEGURA E CORTA 20CM T/C; ALICATE STEIMAN 30CM T/C; ALICATE STEIMAN 45CM T/C; ALICATE STEIMAN 60CM T/C; ALICATE TURQUESA CORTADOR T/C; ALICATE UNIVERSAL P/ GIRAR FIO C/ CORTE; ALICATE UNIVERSAL ORTODONTIA; AMIGDALOTOMO SLUDER BALENGER 3 FACAS; CIZALHA BEYER P/OSSO; CIZALHA LISTON RETA; CIZALHA LISTON CURVA;CIZALHA LISTON RETA 14CM; CIZALHA LISTON CURVA 14CM; CIZALHA LISTON RETA 17CM; CIZALHA LISTON CURVA 17CM; CIZALHA LISTON RETA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 19CM; CIZALHA LISTON ANGULADA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON MINI RETA 15CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA LISTON-KEY 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON-KEY 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LUER GOIVA CURVA; CIZALHA LUER GOIVA RETA;CIZALHA LUER GOIVA CURVA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA CURVA 17CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 17CM; CIZALHA MINI LISTON ANGULADA 15CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.CURVA 18CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.RETA 18CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM T/C; CIZALHA CURVA 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM;CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C;CIZALHA SEMB 23CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 23CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA SEUTIN 21CM; CIZALHA SEUTIN 23CM; CIZALHA STILLE 18CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 20CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA STILLE 26CM DUPLA

ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 37CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 26CM; CIZALHA STILLE 37CM;CIZALHA STILLE LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY DUPLA ARTICULAÇÃO RETA 27CM; CIZALHA STILLE LISTON KEY DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA 27CM; CIZALHA STILLE LUER CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LUER RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LUER DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA 23CM; CIZALHA STILLE LUER DUPLA ARTICULAÇÃO RETA 23CM; CIZALHA STILLE-HORSLEY 23CM; CIZALHA STILLE MINI 20CM; CIZALHA VILBISS 21CM; CORTADOR DE FIOS 14CM; CORTADOR DE VILBISS; COSTOTOMO BRUNNER 28CM; COSTOTOMO DE COLLIN; COSTOTOMO DE COLLIN 19CM; COSTOTOMO COLLIN 20CM; COSTOTOMO GIERTZ STILLE 27CM; COSTOTOMO DE GLUCK 19CM; COSTOTOMO DE GLUCK 22CM; COSTOTOMO MODELO SIMPLES; COSTOTOMO SAUERBRUCH; COSTOTOMO SAUERBRUCH 23CM; COSTOTOMO SAUERBRUCH 26CM; FACA DE BLAIR P/ ENXERTO DE PELE 4"; FACA DE BLAIR P/ ENXERTO DE PELE 6"; MICRO TESOURA CURVA DIREITA ANGULO 60 GRAUS; MICRO TESOURA CURVA ESQUERDA ANGULO 60 GRAUS; MICRO TESOURA JACOBSON RETA 18CM; MICRO TESOURA JACOBSON CURVA 18CM; MICRO TESOURA JACOBSON RETA 16CM; MICRO TESOURA JACOBSON CURVA 16CM; MICRO TESOURA NOYES RETA 12CM; MICRO TESOURA NOYES CURVA 12CM; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 18CM PONTA CURVA; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 18CM PONTA RETA;MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 20CM PONTA CURVA; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 20CM PONTA RETA; MICRO TESOURA YASARGIL CURVA 18CM; MICRO TESOURA YASARGIL RETA 18CM; MICRO TESOURA YASARGIL RETA 16CM; MICRO TESOURA YASARGIL CURVA 16CM; PERFURADOR AINSWORTH ESPECIAL; PERFURADOR DE COSTELA; PERFURADOR HUDSON COMPLETO; PERFURADOR SMELLIE; PINÇA ASCH 23CM; PINÇA ALEXANDER; PINÇA BACK BITE 360° INFANTIL; PINÇA BACK BITE 360°; PINÇA BACK BITE RETA INFANTIL; PINÇA BACK BITE RETA; PINÇA BAKEY BECK 20CM PONTA 65X30MM; PINÇA BAKEY BECK 21CM PONTA 80X45MM; PINÇA BAILEY PITUITÁRIA25°; PINÇA BAILEY PITUITÁRIA RETA, PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 25CM;PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 25CM;PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 25CM;PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI- TOWNSEND 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-TOWNSEND 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI- TOWNSEND 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 25CM; PINÇA BIOPSIA TISCHLER 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA TISCHLER 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BABY-TISCHLER 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BABY-TISCHLER 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA KEVORKIAN 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA KEVORKIAN 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BURKE 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BURKE 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA MINI-TOWNSEND 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA MINI-TOWNSEND 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA EPPENDORF 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA EPPENDORF 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BAGGISH 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BAGGISH 20CM SEM TRAVA; PINÇA BEYER DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA; PINÇA BEYER SACA BOCADO; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO RETA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA P/CIMA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA/ DIREITA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA/ESQUERDA; PINÇA BOHLER RETA; PINÇA BOHLER CURVA; PINÇA BRAUM; PINÇA BRUENINGS Nº1; PINÇA BRUENINGS Nº2;PINÇA CLEVELAND; PINÇA COLCLOUGH 40° 3MM 15CM; PINÇA

001411

COLCLOUGH 40° 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 18CM; PINÇA OLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 20CM; PINÇA COTTLE WALSHAN DIREITA; PINÇA COTTLE WALSHAN ESQUERDA; PINÇA COTTLE WALSHAN RETA; PINÇA CRANEOCLASTO DE BRAUN 42CM; PINÇA CLAMP 160MM; PINÇA CLAMP 220MM; PINÇA CHEVALIER JACKSON 40CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON 50CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 30CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 40CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 50CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON TIPO JACARÉ 40CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON TIPO JACARÉ 50CM; PINÇA CITELLI; PINÇA DUCK BILL GOIVA; PINÇA DUCK BILL 3MM; PINÇA DUCK BILL 8MM;PINÇA CITELLI CAVIDADE 14CM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 1,5MM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 2,5MM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 4,0MM;PINÇA CITELLI SACA-BOCADO 20CM; PINÇA CLOWARD HAPPER ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA CLOWARD HAPPER ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA CLOWARD HAPPER RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA CLOWARD HAPPER RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE COM CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE SEM CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF VAN-BUREN; PINÇA FAURE; PINÇA FAURE 21CM; PINÇA FAURE 24CM; PINÇA FERGUSSON; PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P/ CIMA, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P/ BAIXO, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA 40°, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA P/ CIMA, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA P/ BAIXO, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA 40°,PINÇA BIOPSIA GAYLOR 24CM; PINÇA BIOPSIA GELLHORN 24CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1,0MM RETA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA CIMA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM RETA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA ANGULADA DUPLA ARTICULAÇÃO, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA CURVA PARA ESQUERDA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA CURVA PARA DIREITA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA ANGULADA 45°, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA RETA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 7MM X 2MM, ABERTURA PARA CIMA, COMPRIMENTO 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA INDIRETA CONCHA RETANGULAR DE 5MM CURVA PARA BAIXO 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA ESQUERDA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA CIMA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM, CURAVA PARA BAIXO 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM, CURVA PARA DIREITA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA PARA ESQUERDA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA DIREITA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA PARA CIMA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR GIRATÓRIA 360° 5MM X 1MM DE 25CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 2,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 4,8MM. 10CM; PINÇA CORTANTE

ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA CONCHA OVAL LONGA 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2MM, DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO DELICADA 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 2,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 4,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA, EXTRA DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM COM ASPIRAÇÃO11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2MM, DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO, DELICADA 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 60°, CONCHA OVAL LONGA DE 6MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA TIPO SETA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA TIPO SETA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA TIPO COLHER 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA TIPO COLHER 11CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO POR PINO DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO POR PINO DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL, DE 2MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA ESQUERDA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA DIREITA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA CIMA DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA ESQUERDA, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA DIREITA, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, RETA, CORTE PARA CIMA DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CORTE PARA ESQUERDA DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CORTE PARA

DIREITA, DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CURVO, CORTE PARA CIMA, DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, RETA, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CORTE PARA ESQUERDA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CORTE PARA DIREITA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CURVO, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA GOIVA BACON; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 25°; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 45°; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 90°; PINÇA GOIVA BIARTICULADA STILLE RUSKIN 24CM 8MM; PINÇA GOIVA CURVA ART.SIMPLES 2MM 17CM; PINÇA GOIVA CURVA ART.SIMPLES 5MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA DUPLA ART.RUSKIN MINI 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA GEIGER 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA KLEINERT KUTZ 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA RUSKIN-MINI 15CMX02MM; PINÇA GOIVA DUPLA ART MINI RUSKIN 2MM RETA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART MINI RUSKIN 3MM RETA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 2MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 3MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 5MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.MINI RUSKIN 2MM CURVA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.RUSKIN 5MM RETA 24CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.RUSKIN 5MM CURVA 24CM; PINÇA GOIVA JANSEN MIDDLETON; PINÇA GOIVA LEKSELL CORTE 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL CORTE 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE; PINÇA GOIVA LEMPERT CURVA; PINÇA GOIVA LEMPERT RETA; PINÇA GOIVA LUER-FRIEDMANN; PINÇA GOIVA MAYFIELD CURVA 19CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA; PINÇA GRUENWALD BOCA RETA; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO 26CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA 26 CM; PINÇA GRUENWALD BOCA RETO 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA RETO 26CM; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM; PINÇA HAJEK-CLAUSS; PINÇA HARTMANN AURICULAR CORTANTE N°2; PINÇA HARTMANN AURICULAR CORTANTE N°3; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°1; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°2; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°3;PINÇA HARTMANN COM DENTE N°4; PINÇA HARTMANN HOFFMANN N°1; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 5MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 7MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 9MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 11MM; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°1; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°2; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°3; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°4; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°5; PINÇA HEISS CARDIO; PINÇA HOUSE-DIETER BOCA P/ BAIXO; PINÇA HOUSE-DIETER BOCA P/ CIMA; PINÇA JANSEN RETA; PINÇA JANSEN CURVA; PINÇA JURASZ P/ DIREITA 19CM; PINÇA JURASZ P/ ESQUERDA 19CM; PINÇA JURASZ P/ CIMA 19CM; PINÇA JURASZ P/ BAIXO 19CM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 6MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM; PINÇA KERRISON RETA 90

001412

GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 2MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 3MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 1MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 5MM; PINÇA KERRISON BOCA 4X4MM; PINÇA KERRISON BOCA 5X5MM; PINÇA KERRISON BOCA 6X6MM;PINÇA KERRISON C/TRAVA T/C; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 8MM; PINÇA LAMBOTTE 21CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LAMBOTTE 26CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LAMBOTTE 31CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LANE COM CREMALHEIRA; PINÇA LANE SEM CREMALHEIRA; PINÇA LEKSELL EM ÂNGULO; PINÇA LEKSELL 23CM;

PINÇA LEKSELL 24CM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 8MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 3X5MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 1X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 3X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 4X10MM; PINÇA LUC CORTANTE NASAL; PINÇA LUER GOIVA CURVA 16CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 16CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 17CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 17CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 18CM SIMPLES;PINÇA LUER GOIVA RETA 18CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 20CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 20CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA LUER GOIVA CURVA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA MATHIEU 20CM; PINÇA MATHIEU 25CM; PINÇA MATHIEU 28CM; PINÇA MARTEL; PINÇA OLDBERG BOCA REDONDA; PINÇA OLIVECRONA 20CM; PINÇA P/ BIOPSIA WITTNER RETA 21CM; PINÇA P/ BIOPSIA WITTNER CURVA 21CM; PINÇA P/ BIOPSIA SCHULZ FLEXIVEL 3X510MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 1MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA

001413

24CM 2MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 3MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 4MM; PINÇA PROFº.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 5MM;PINÇA ROWE DIREITA; PINÇA ROWE ESQUERDA; PINÇA GOIVA RUSKIN RETA 23CM; PINÇA GOIVA RUSKIN CURVA 23CM; PINÇA RUSKIN DUPLA ARTICULAÇÃO RETA; PINÇA RUSKIN DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM 3MM; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM 5MM; PINÇA SACA-CALCIO P/CIMA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO P/DIREITA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO P/ESQUERDA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO RETA 20CM; PINÇA SCHUBERT P/ BIOPSIA 23,5CM ANGULADA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 21CM RETA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 23,5CM RETA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 29CM RETA; PINÇA SCHUBERT; PINÇA SCHUMACHER; PINÇA SEMB; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 18CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 18CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 18CM; PINÇA STILE-LISTON 23CM CURVA; PINÇA STILE-LISTON 23CM RETA; PINÇA STILLE-LISTON 27CM CURVA; PINÇA STILLE-LISTON 27CM RETA; PINÇA STILLE LUER 23CM ANGULADA; PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 27CM; PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 27CM; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO Nº1; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO Nº2; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO Nº3; PINÇA STRUYCKEN ANGULADA; PINÇA STRUYCKEN INFANTIL ANGULADA; PINÇA STRUYCKEN INFANTIL RETA; PINÇA STRUYCKEN RETA; PINÇA TAKAHASHI BOCA RETA; PINÇA TAKAHASHI BOCA P/ CIMA; PINÇA TAKAHASHI DELICADA 12CM; PINÇA TAKAHASHI DELICADA 19CM; PINÇA THOMAS-GAYLOR; PINÇA VAN DOREN 24CM BIOPSIA; PINÇA WATSON-WILLIAN NASAL COM SERRILHA; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA Nº1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA Nº2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA Nº3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA Nº4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA Nº5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA Nº6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA Nº1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA Nº2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA Nº3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA Nº4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA Nº5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA Nº6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA Nº1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA Nº2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA Nº3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA Nº4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA Nº5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA Nº6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA Nº1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA Nº2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA Nº3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA Nº4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA Nº5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA Nº6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° Nº1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° Nº2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° Nº3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° Nº4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° Nº5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° Nº6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° Nº1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° Nº2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° Nº3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° Nº4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° Nº5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° Nº6; PINÇA YEOMAN 28CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 28CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 35CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 35CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 20CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 20CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 25CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 25CM BOCA ARREDONDADA; PORTA AGULHA CRILE WOOD 15CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA GILLIES 16CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA OLSEN HEGAR 14CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA OLSEN HEGAR 16CM T/C; PORTA AGULHA P/ FIO DE AÇO BERRY 20CM; SACA-PROTESE C/3 PONTAS; SACA-PROTESE IMPLES; SERRA NÓ BRUENINGS C/ CREMALHEIRA; SERRA-NO EVES S/CREMALHEIRA 28CM; SERRA-NO KRAUSE; SERRA NÓ WILDE; TESOURA BALIU; TESOURA BARRAQUER; TESOURA BECKER-CAPLAN P/ SEPTO; TESOURA BELLUCCI MICRO RETA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/CIMA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/DIREITA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/ESQUERDA; TESOURA BOETTCHER 18CM; TESOURA BOYD 14CM CURVA; TESOURA BOYD 14CM CURVA T/C; TESOURA BOYD 18CM CURVA; TESOURA BOYD 18CM CURVA T/C; TESOURA BOYD 20CM CURVA; TESOURA BOYD 20CM CURVA T/C; TESOURA BRAUN-STADLER 14,5CM; TESOURA BRAUN-STADLER 16CM; TESOURA BRAUN-STADLER 20CM; TESOURA BRAUN-STADLER 22CM; TESOURA CALCIFRED CURVA SERRILHADA 23CM; TESOURA CALCIFRED T/C 23CM; TESOURA CALCIFRED; TESOURA CASTROVIEJO CURVA; TESOURA CASTROVIEJO DIREITA; TESOURA CASTROVIEJO ESQUERDA; TESOURA CASTROVIEJO P/ SINECHIA; TESOURA CASTROVIEJO 130°; TESOURA

CASTROVIEJO 25°;TESOURA CASTROVIEJO 45°; TESOURA CASTROVIEJO 60°; TESOURA CASTROVIEJO 90°; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 15CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 18CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 15CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 18CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 09CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 09CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO RETA T/C 15CM; TESOURA CASTROVIEJO T/C 130°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 25°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 45°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 60°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 90°; TESOURA CASTROVIEJO CURVA T/C 15CM; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ DIREITA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ ESQUERDA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ FRENTE; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/FINA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CN RETA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/FINA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA15CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA ROMBA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA 100MM;TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA RETA 100MM;TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA ANGULADA 45° 100MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA ANGULADA 90° 100MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ ESQUERDA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ DIREITA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA LISA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA CURTA LISA 9,0MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA LONGA LISA 11,0MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA SERRILHADA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ ESQUERDA LISA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ DIREITA LISA 9,5MM; TESOURA COHAN-VANNAS CURVA; TESOURA COHAN-VANNAS RETA;TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 11CM; TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 14CM; TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 18CM; TESOURA CONVERSE RETA 11CM; TESOURA CONVERSE RETA 14CM; TESOURA CONVERSE 18CM; TESOURA CORTA FIO ACO 13CM SERRILHADA; TESOURA COTTLE P/DORSO NASAL; TESOURA COTLE 11CM; TESOURA COTLE 14CM; TESOURA COTLE 15CM; TESOURA COTLE 16CM; TESOURA DANDY 17CM, TESOURA DANDY CURVA 17CM; TESOURA DANDY 19CM TESOURA DANDY 20CM; TESOURA DANDY TRIGEMINAL; TESOURA DEAN SERRILHADA; TESOURA DEAN SEM SERRILHA; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 25GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 40GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 45 GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 60GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM EM "S"; TESOURA DE RYTHIDO; TESOURA DIETRICH 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH COM GUIA 18CM 130 GRAUS; TESOURA

001414

DIETRICH T/C 18CM 25GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 25GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 45GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 45GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 60GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 60GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 90GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 90GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 125GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 125GRAUS; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 25° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 25° 18CM T/C;TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 45° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 45° 18CM T/C;TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 60° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 60° 18CM T/C;TESOURA ENTERÓTOMO; TESOURA ESMARCH 17CM; TESOURA ESMARCH 20CM;TESOURA FAVALORO 18CM 130 GRAUS;TESOURA FAVAROLO 18CM; TESOURA P/ FIO DE ACO 11CM; TESOURA P/ FIO DE ACO 11CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 11CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 11CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 12CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 12CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 15CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 15CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 18CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 18CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 20CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 20CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 25CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 25CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 30CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 30CM T/C; TESOURA FOMON DORSAL ANGULAR; TESOURA FOMON DORSAL ANGULAR T/C; TESOURA FOMON ANGULADA 15CM; TESOURA FRAZIER 18CM;TESOURA FREEMAN; TESOURA FREEMAN CURVA 14CM; TESOURA FREEMAN CURVA 18CM; TESOURA FREEMAN CURVA 23CM; TESOURA FREEMAN RETA 14CM; TESOURA FREEMAN RETA 18CM; TESOURA FREEMAN RETA 23CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 15CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 20CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 23CM; TESOURA GOLDMAN FOX; TESOURA GOLDMAN FOX T/C; TESOURA GOLDMAN FOX RETA; TESOURA GOLDMAN FOX RETA T/C;TESOURA GOLDMAN FOX CURVA; TESOURA GOLDMAN FOX CURVA T/C; TESOURA HEYMAN DELICADA 10CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 13CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 16CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 19CM; TESOURA HEYMANN 10CM; TESOURA HEYMANN ANGULADA COM SERRILHA; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 8CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 8CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA CANHOTO; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA DELICADA; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA CANHOTO T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA CANHOTO; TESOURA IRIS 11,5CM RETA DELICADA; TESOURA IRIS 11,5CM RETA CANHOTO T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA DELICADA T/C; TESOURA IRIS C/FACETA CURVA FINA; TESOURA IRIS C/FACETA CURVA FINA T/C; TESOURA IRIS C/FACETA RETA FINA; TESOURA IRIS C/FACETA RETA FINA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA; TESOURA IRIS 11,5CM RETA T/C; TESOURA IRIS ANGULADA 11,5CM; TESOURA IRIS ANGULADA 14CM; TESOURA IRIS ANGULADA 16CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA CURVA 11CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA CURVA 14CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA RETA 11CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA RETA 14CM; TESOURA IRIS ROMBA CURVA 11,5CM; TESOURA IRIS ROMBA RETA 11,5CM; TESOURA JACOBSON CURVA 16CM;TESOURA JACOBSON RETA 16CM; TESOURA JACOBSON RETA 18CM; TESOURA JACOBSON 18CM CURVA; TESOURA JOSEPH 14CM RETA; TESOURA JOSEPH 14CM CURVA; TESOURA JOSEPH CURVA T/C 15CM; TESOURA JOSEPH RETA T/C 15CM; TESOURA KHAN CURVA COM SERRILHA 14CM; TESOURA KHAN RETA COM SERRILHA 14CM; TESOURA KEYE FREEMAN CURVA 14CM; TESOURA KEYE FREEMAN CURVA 18CM; TESOURA KILLIAN P/ SEPTO 20CM; TESOURA KILNER ; TESOURA KILNER 14CM; TESOURA DE LISTER 14CM; TESOURA DE LISTER 17CM; TESOURA DE LISTER 19CM;TESOURA KNIGHT; TESOURA LAGRANGE; TESOURA LAGRANGE T/C;TESOURA LEXER CURVA DELGADA 165MM T/C; TESOURA LEXER BABY 10CM CURVA; TESOURA LEXER BABY 10CM CURVA T/C; TESOURA LEXER BABY 10CM RETA; TESOURA LEXER BABY 10CM RETA T/C;TESOURA LITTAUER 13.5CM; TESOURA LOCKLIN 16CM; TESOURA MALIS 18CM CURVA;TESOURA MAYO 15CM RETA; TESOURA MAYO 15CM CURVA;TESOURA MAYO 17CM RETA; TESOURA MAYO 17CM CURVA; TESOURA MAYO 23CM RETA; TESOURA MAYO 23CM CURVA;TESOURA MAYO NOBLE 17CM CURVA;TESOURA MAYO NOBLE 17CM RETA; TESOURA MAYO NOBLE 17CM CURVA T/C; TESOURA MAYO NOBLE 17CM RETA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA COM

SERRILHA; TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA;TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA C/ SERRILHA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA;TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 19CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 19CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 22CM CURVA;TESOURA MAYO STILLE 22CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 22CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 22CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 30CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 30CM RETA;TESOURA MAYO STILLE 30CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 30CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M RETA T/C;TESOURA MC-INDOE; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA; TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA ;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM CURVA LONGA 23CM; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM RETA; T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM RETA;

001415

TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM RETA;TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM RETA T/C;TESOURA NELSON 24CM CURVA;TESOURA NELSON 24CM RETA;TESOURA NOYES 12CM FINA/FINA RETA;TESOURA NOYES 12CM ROMBA/FINA RETA;TESOURA NOYES 12CM ROMBA/ROMBA RETA;TESOURA NOYES IRIS RETA 12CM ;TESOURA NOYES IRIS CURVA 12CM; TESOURA OLIVECRONA; TESOURA PARA OURO RETA 10CM; TESOURA PARA OURO CURVA 10CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 14CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 18CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 14CM T/C; TESOURA COROA E OURO CURVA 18CM T/C; TESOURA COROA E OURO CURVA T/C; TESOURA COROA E OURO RETA 14CM; TESOURA COROA E OURO RETA 18CM; TESOURA COROA E OURO RETA 14CM T/C;TESOURA COROA E OURO RETA 18CM T/C; TESOURA COROA E OURO RETA T/C; TESOURA P/ BANDAGEM GROSSA;TESOURA PARA CORDÃO UMBILICAL;TESOURA P/ENUCLEACAO 14CM; TESOURA P/ENUCLEACAO 16CM;TESOURA P/ESTRABISMO CURVA;TESOURA P/ESTRABISMO RETA;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 145MM T/C;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 180MM T/C;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 230MM T/C;TESOURA P/ RUGAS 14CM;TESOURA P/ RUGAS 20CM;TESOURA P/ RUGAS 24CM; TESOURA PARAMETRIAL 23CM CURVA;TESOURA PARAMETRIAL 26CM CURVA; TESOURA PARAMETRIAL 30CM CURVA;TESOURA PARAMETRIAL 35CM CURVA; TESOURA PARAMETRIAL 23CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 26CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 30CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 35CM CURVA T/C; TESOURA P/ TUBOS SERRILHADA 20 CM; TESOURA PELICANO 17CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 25° 19CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 40° 19CM TESOURA POTTS DE MARTEL 60° 19CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 25° 19CM T/C; TESOURA POTTS DE MARTEL 40° 19CM T/C; TESOURA POTTS DE MARTEL 60° 19CM T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 25°; TESOURA POTTS SMITH 19CM 25°T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 30°; TESOURA POTTS SMITH 19CM 30°T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 40°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 40°T/C; TESOURA POTTS SMITH 45°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 60°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 60°T/C;TESOURA POTTS SMITH 25° CURVA T/C; TESOURA POTTS SMITH 45° CURVA T/C;TESOURA POTTS SMITH 60° CURVA T/C;TESOURA POTTS-YASARGIL 18CM DIREITA;TESOURA POTTS-YASARGIL 18CM ESQUERDA; TESOURA POTTS-YASARGIL 20CM DIREITA;TESOURA POTTS-YASARGIL 20CM ESQUERDA; TESOURA REYNOLDS CURVA 12CM; TESOURA REYNOLDS CURVA 15CM; TESOURA REYNOLDS CURVA 18CM; TESOURA REYNOLDS RETA 12CM; TESOURA REYNOLDS RETA 15CM; TESOURA REYNOLDS RETA 18CM; TESOURA REES P/ RUGAS 20CM;TESOURA REES P/ RUGAS 24CM;TESOURA SATINSKY 18CM CURVA; TESOURA SATINSKY 20CM CURVA;TESOURA SCHMIEDEN-TAYLOR; TESOURA SERRILHADA 15CM; TESOURA SCHUMACHER; TESOURA SIMS RETA; TESOURA SIMS CURVA; TESOURA SIMS 8CM CURVA;TESOURA SMITH; TESOURA SMITH 23CM;TESOURA SNOLDEN SERRILHADA CURVA 15CM; TESOURA SNOLDEN SERRILHADA RETA 15CM;TESOURA SNOLDEN SERRILHADA CURVA 17CM; TESOURA SNOLDEN SERRILHADA RETA 17CM;TESOURA SPENCER 9CM; TESOURA SPENCER 12CM; TESOURA SPENCER 14CM; TESOURA SPENCER CURVA 11CM; TESOURA SPENCER CURVA 14CM; TESOURA SPENCER T/C 11CM; TESOURA SPENCER T/C 14CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 14CM;

001416

TESOURA STEVENS CURVA; TESOURA STEVENS RETA;TESOURA STEVENS 11,5CM CURVA;TESOURA STEVENS 11,5CM RETA;TESOURA STRULLY RETA 18CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 18CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 18CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 18CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY RETA 20CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 20CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 20CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 20CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY RETA 22CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 22CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 22CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 22CM PONTA ROMBA;TESOURA THOREK 19CM;TESOURA TROUTMAN CASTROVIEJO DIREITA;TESOURA TROUTMAN CASTROVIEJO ESQUERDA; TESOURA UNIVERSAL P/ FIO T/C; TESOURA UNIVERSAL T/C 11CM; TESOURA UNIVERSAL; TESOURA VANNAS CURVA; TESOURA VANNAS RETA;TESOURA KLINKENBERGH-LOTH 23CM; TESOURA ZURICH RETA 13CM ;TESOURA WECKER 11CM; TESOURA WESTCOTT CURVA; TESOURA WESTCOTT RETA;

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	10304850053
Processo	25351.516402/2006-76
Origem do Produto	• FABRICANTE: ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 57

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	M. SÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
CNPJ	72.819.980/0001-60	**Autorização**	8.01.280-0
Produto	TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO		

Modelo Produto Médico
12x180, 16x180, 19x180, 26x180, 12x250, 16x250, 19x250, 26x250, 80x300, 80x530, 90x630, 90x860, 100x860, 100x1020, 100x1200, 12x1000, 16x1000, 19x1000, 26x1000, 100x20, 150x20, 200x20, 200x50.

Nome Técnico	Imobilizador Ortopedico
Registro	80128000010
Processo	25351.490775/2013-77
Origem do Produto	• FABRICANTE: M. SÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 58

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		
CNPJ	58.258.152/0001-50	**Autorização**	1.03.048-5
Produto	INSTRUMENTAL CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE		

Modelo Produto Médico

AGULHA REVERDIN Nº.1 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.2 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.3 23CM; AGULHA REVERDIN Nº.4 23CM; ALICATE AINSWORTH; ALICATE BERNARDINHO 30CM T/C; ALICATE BERNARDINHO 47CM T/C; ALICATE BERNARDÃO 55CM T/C; ALICATE BETHUNE 34CM; ALICATE CORTA PINO INTERCAMBEÁVEL 57,5CM; ALICATE CORTA FIO 14CM ATÉ 0,8MM T/C; ALICATE CORTE DISTAL 154; ALICATE CORTE DISTAL T/C; ALICATE P/ CORTE CINTA DE ESTERNO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO; ALICATE CORTE P/ AMARRILHO T/C; ALICATE CORTE FRONTAL T/C; ALICATE CORTE FRONTAL 16CM; ALICATE CORTE LATERAL P/ OSSO; ALICATE CORTE LATERAL 12CM; ALICATE DUPLA FORÇA 15CM; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM; ALICATE Nº.141; ALICATE DUPLA FORÇA 18CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA 23CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 21CM T/C; ALICATE DUPLA FORÇA CORTE LATERAL 25CM T/C; ALICATE P/ CORTE DE ANEL; ALICATE REIL T/C; ALICATE RUSKIN; ALICATE SEGURA E CORTA 16CM T/C; ALICATE SEGURA E CORTA 20CM T/C; ALICATE STEIMAN 30CM T/C; ALICATE STEIMAN 45CM T/C; ALICATE STEIMAN 60CM T/C; ALICATE TURQUESA CORTADOR T/C; ALICATE UNIVERSAL P/ GIRAR FIO C/ CORTE; ALICATE UNIVERSAL ORTODONTIA; AMIGDALOTOMO SLUDER BALENGER 3 FACAS; CIZALHA BEYER P/OSSO; CIZALHA LISTON RETA; CIZALHA LISTON CURVA;CIZALHA LISTON RETA 14CM; CIZALHA LISTON CURVA 14CM; CIZALHA LISTON RETA 17CM; CIZALHA LISTON CURVA 17CM; CIZALHA LISTON RETA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 19CM; CIZALHA LISTON ANGULADA 19CM; CIZALHA LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON MINI RETA 15CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA LISTON-KEY 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LISTON-KEY 27CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA LUER GOIVA CURVA; CIZALHA LUER GOIVA RETA;CIZALHA LUER GOIVA CURVA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 16CM; CIZALHA LUER GOIVA CURVA 17CM; CIZALHA LUER GOIVA RETA 17CM; CIZALHA MINI LISTON ANGULADA 15CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.CURVA 18CM; CIZALHA RUSKIN ROWLAND DUPLA ART.RETA 18CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 18,5CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA 23CM T/C; CIZALHA CURVA 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 18,5CM; CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM;CIZALHA RUSKIN LISTON RETA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C; CIZALHA RUSKIN LISTON CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO 23CM T/C;CIZALHA SEMB 23CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 23CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM RETA DUPLA ARTICULAÇÃO;CIZALHA SEMB 27CM CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA SEUTIN 21CM; CIZALHA SEUTIN 23CM; CIZALHA STILLE 18CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 20CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 23CM DUPLA ARTICULACAO; CIZALHA STILLE 26CM DUPLA

ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 37CM DUPLA ARTICULACAO;CIZALHA STILLE 26CM; CIZALHA STILLE 37CM;CIZALHA STILLE LISTON RETA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON CURVA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON RETA 27CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON CURVA 27CM DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LISTON KEY DUPLA ARTICULAÇÃO RETA 27CM; CIZALHA STILLE LISTON KEY DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA 27CM; CIZALHA STILLE LUER CURVA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LUER RETA DUPLA ARTICULAÇÃO; CIZALHA STILLE LUER DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA 23CM; CIZALHA STILLE LUER DUPLA ARTICULAÇÃO RETA 23CM; CIZALHA STILLE-HORSLEY 23CM; CIZALHA STILLE MINI 20CM; CIZALHA VILBISS 21CM; CORTADOR DE FIOS 14CM; CORTADOR DE VILBISS; COSTOTOMO BRUNNER 28CM; COSTOTOMO DE COLLIN; COSTOTOMO DE COLLIN 19CM; COSTOTOMO COLLIN 20CM; COSTOTOMO GIERTZ STILLE 27CM; COSTOTOMO DE GLUCK 19CM; COSTOTOMO DE GLUCK 22CM; COSTOTOMO MODELO SIMPLES; COSTOTOMO SAUERBRUCH; COSTOTOMO SAUERBRUCH 23CM; COSTOTOMO SAUERBRUCH 26CM; FACA DE BLAIR P/ ENXERTO DE PELE 4"; FACA DE BLAIR P/ ENXERTO DE PELE 6"; MICRO TESOURA CURVA DIREITA ANGULO 60 GRAUS; MICRO TESOURA CURVA ESQUERDA ANGULO 60 GRAUS; MICRO TESOURA JACOBSON RETA 18CM; MICRO TESOURA JACOBSON CURVA 18CM; MICRO TESOURA JACOBSON RETA 16CM; MICRO TESOURA JACOBSON CURVA 16CM; MICRO TESOURA NOYES RETA 12CM; MICRO TESOURA NOYES CURVA 12CM; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 18CM PONTA CURVA; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 18CM PONTA RETA;MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 20CM PONTA CURVA; MICRO TESOURA YASARGIL BAIONETA 20CM PONTA RETA; MICRO TESOURA YASARGIL CURVA 18CM; MICRO TESOURA YASARGIL RETA 18CM; MICRO TESOURA YASARGIL RETA 16CM; MICRO TESOURA YASARGIL CURVA 16CM; PERFURADOR AINSWORTH ESPECIAL; PERFURADOR DE COSTELA; PERFURADOR HUDSON COMPLETO; PERFURADOR SMELLIE; PINÇA ASCH 23CM; PINÇA ALEXANDER; PINÇA BACK BITE 360° INFANTIL; PINÇA BACK BITE 360°; PINÇA BACK BITE RETA INFANTIL; PINÇA BACK BITE RETA; PINÇA BAKEY BECK 20CM PONTA 65X30MM; PINÇA BAKEY BECK 21CM PONTA 80X45MM; PINÇA BAILEY PITUITÁRIA25°; PINÇA BAILEY PITUITÁRIA RETA, PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 25CM;PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA KEVORKIAN 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA BABY-TISCHLER 25CM;PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA TISCHLER ANGULADA 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-UP 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 25CM;PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-DOWN 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA OVAL 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI- TOWNSEND 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI-TOWNSEND 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA MINI- TOWNSEND 25CM; PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 25CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 20CM; PONTEIRA PINÇA BIOPSIA ROTATIVA EPPENDORF 25CM; PINÇA BIOPSIA TISCHLER 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA TISCHLER 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BABY-TISCHLER 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BABY-TISCHLER 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA KEVORKIAN 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA KEVORKIAN 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BURKE 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BURKE 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA MINI-TOWNSEND 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA MINI-TOWNSEND 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA EPPENDORF 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA EPPENDORF 20CM SEM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BAGGISH 20CM COM TRAVA; PINÇA BIOPSIA BAGGISH 20CM SEM TRAVA; PINÇA BEYER DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA; PINÇA BEYER SACA BOCADO; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO RETA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA P/CIMA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA/ DIREITA AURICULAR; PINÇA PARA BIOPSIA MICRO CURVA/ESQUERDA; PINÇA BOHLER RETA; PINÇA BOHLER CURVA; PINÇA BRAUM; PINÇA BRUENINGS Nº1; PINÇA BRUENINGS Nº2;PINÇA CLEVELAND; PINÇA COLCLOUGH 40° 3MM 15CM; PINÇA

COLCLOUGH 40° 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH 40° 5MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ BAIXO 5MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 3MM 20CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 15CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 18CM; PINÇA COLCLOUGH P/ CIMA 5MM 20CM; PINÇA COTTLE WALSHAN DIREITA; PINÇA COTTLE WALSHAN ESQUERDA; PINÇA COTTLE WALSHAN RETA; PINÇA CRANEOCLASTO DE BRAUN 42CM; PINÇA CLAMP 160MM; PINÇA CLAMP 220MM; PINÇA CHEVALIER JACKSON 40CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON 50CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 30CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 40CM; PINÇA CHEVALIER-JACKSON BIOPSIA P/ CIMA 50CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON TIPO JACARÉ 40CM; PINÇA CHEVALIER JACKSON TIPO JACARÉ 50CM; PINÇA CITELLI; PINÇA DUCK BILL GOIVA; PINÇA DUCK BILL 3MM; PINÇA DUCK BILL 8MM;PINÇA CITELLI CAVIDADE 14CM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 1,5MM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 2,5MM; PINÇA CITELLI SACABOCADO P/ BAIXO 4,0MM;PINÇA CITELLI SACA-BOCADO 20CM; PINÇA CLOWARD HAPPER ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA CLOWARD HAPPER ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA CLOWARD HAPPER RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA CLOWARD HAPPER RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE COM CREMALHEIRA; PINÇA FARABEUF LAMBOTTE SEM CREMALHEIRA, PINÇA FARABEUF VAN-BUREN; PINÇA FAURE; PINÇA FAURE 21CM; PINÇA FAURE 24CM; PINÇA FERGUSSON; PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P/ CIMA, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P/ BAIXO, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA 40°, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA P/ CIMA, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA P/ BAIXO, PINÇA FERRIS SMITH KERRISON 5MM BOCA 40°,PINÇA BIOPSIA GAYLOR 24CM; PINÇA BIOPSIA GELLHORN 24CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1,0MM RETA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 1MM CURVA PARA CIMA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM RETA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 2MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA ESQUERDA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA DE 4MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA ANGULADA DUPLA ARTICULAÇÃO, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA CURVA PARA ESQUERDA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA CURVA PARA DIREITA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA ANGULADA 45°, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA REDONDA RETA, GIRATÓRIA 360° 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 7MM X 2MM, ABERTURA PARA CIMA, COMPRIMENTO 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA INDIRETA CONCHA RETANGULAR DE 5MM CURVA PARA BAIXO 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA ESQUERDA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA DIREITA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 5MM X 2MM, CURVA PARA CIMA 250MM;PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM RETA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM, CURAVA PARA BAIXO 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM, CURVA PARA DIREITA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA RETANGULAR DE 4MM X 2MM CURVA PARA CIMA 250MM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA PARA ESQUERDA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA DIREITA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR 5MM X 1MM ABERTURA PARA CIMA 25CM; PINÇA P/ BIOPSIA CONCHA TRIANGULAR GIRATÓRIA 360° 5MM X 1MM DE 25CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 2,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL CURTA DE 4,8MM. 10CM; PINÇA CORTANTE

ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA CONCHA OVAL LONGA 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2MM, DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL RETA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO DELICADA 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 2,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL CURTA DE 4,8MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA, EXTRA DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM COM ASPIRAÇÃO 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM COM ASPIRAÇÃO11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2MM, DELICADA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 45°, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO, DELICADA 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 60°, CONCHA OVAL LONGA DE 6MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 4MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 4,2MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL ANGULADA 90°, CONCHA OVAL LONGA DE 5MM 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA DE 2,5MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA DE 3,6MM 10CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA TIPO SETA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA TIPO SETA 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA ESQUERDA, CONCHA OVAL LONGA TIPO COLHER 11CM; PINÇA CORTANTE ENDONASAL CURVA PARA DIREITA, CONCHA OVAL LONGA TIPO COLHER 11CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO POR PINO DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO POR PINO DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL, DE 2MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA ESQUERDA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA DIREITA, DE 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA CIMA DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA ESQUERDA, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, CORTE PARA DIREITA, DE 1,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETA, GIRATÓRIA 360° ACIONAMENTO LATERAL 2,5MM, RETRÓGRADA 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, RETA, CORTE PARA CIMA DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CORTE PARA ESQUERDA DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CORTE PARA

DIREITA, DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 4MM, CURVO, CORTE PARA CIMA, DE 2MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, RETA, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CORTE PARA ESQUERDA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CORTE PARA DIREITA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA CORTANTE RETRÓGRADA, Ø 5MM, CURVO, CORTE PARA CIMA, DE 2,5MM COM ASPIRAÇÃO 10CM; PINÇA GOIVA BACON; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 25°; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 45°; PINÇA GOIVA BLUMENTHAL 90°; PINÇA GOIVA BIARTICULADA STILLE RUSKIN 24CM 8MM; PINÇA GOIVA CURVA ART.SIMPLES 2MM 17CM; PINÇA GOIVA CURVA ART.SIMPLES 5MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA DUPLA ART.RUSKIN MINI 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA GEIGER 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA KLEINERT KUTZ 3MM 15CM; PINÇA GOIVA CURVA RUSKIN-MINI 15CMX02MM; PINÇA GOIVA DUPLA ART MINI RUSKIN 2MM RETA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART MINI RUSKIN 3MM RETA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 2MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 3MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.ECHLIN 5MM 23CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.MINI RUSKIN 2MM CURVA 15CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.RUSKIN 5MM RETA 24CM; PINÇA GOIVA DUPLA ART.RUSKIN 5MM CURVA 24CM; PINÇA GOIVA JANSEN MIDDLETON; PINÇA GOIVA LEKSELL CORTE 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL CORTE 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE; PINÇA GOIVA LEMPERT CURVA; PINÇA GOIVA LEMPERT RETA; PINÇA GOIVA LUER-FRIEDMANN; PINÇA GOIVA MAYFIELD CURVA 19CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA; PINÇA GRUENWALD BOCA RETA; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/BAIXO 26CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA P/CIMA 26 CM; PINÇA GRUENWALD BOCA RETO 18CM; PINÇA GRUENWALD BOCA RETO 26CM; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM; PINÇA HAJEK-CLAUSS; PINÇA HARTMANN AURICULAR CORTANTE N°2; PINÇA HARTMANN AURICULAR CORTANTE N°3; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°1; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°2; PINÇA HARTMANN COM DENTE N°3:PINÇA HARTMANN COM DENTE N°4; PINÇA HARTMANN HOFFMANN N°1; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 5MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 7MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 9MM; PINÇA HARTMANN NASAL COM SERRILHA CORTANTE 11MM; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°1; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°2; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°3; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°4; PINÇA HARTMANN SACABOCADO N°5; PINÇA HEISS CARDIO; PINÇA HOUSE-DIETER BOCA P/ BAIXO; PINÇA HOUSE-DIETER BOCA P/ CIMA; PINÇA JANSEN RETA; PINÇA JANSEN CURVA, PINÇA JURASZ P/ DIREITA 19CM; PINÇA JURASZ P/ ESQUERDA 19CM; PINÇA JURASZ P/ CIMA 19CM; PINÇA JURASZ P/ BAIXO 19CM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 6MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 40 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM; PINÇA KERRISON RETA 90

GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 2MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 3MM; PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 5MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 1MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 2MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 3MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 4MM;PINÇA KERRISON RETA 90 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 1MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 18CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 18CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 1MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 2MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 20CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 4MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 23CM 5MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 3MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ CIMA 25CM 5MM;PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 1MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 2MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 3MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 4MM; PINÇA KERRISON ANGULADA 130 GRAUS BOCA P/ BAIXO 25CM 5MM; PINÇA KERRISON BOCA 4X4MM; PINÇA KERRISON BOCA 5X5MM; PINÇA KERRISON BOCA 6X6MM;PINÇA KERRISON C/TRAVA T/C; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 8MM; PINÇA LAMBOTTE 21CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LAMBOTTE 26CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LAMBOTTE 31CM COM BOCA MÓVEL; PINÇA LANE COM CREMALHEIRA; PINÇA LANE SEM CREMALHEIRA; PINÇA LEKSELL EM ÂNGULO; PINÇA LEKSELL 23CM;

PINÇA LEKSELL 24CM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE CURVA 8MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 5MM; PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE RETA 8MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 15CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 3X5MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 1X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 3X10MM;PINÇA LOVE GRUENWALD 18CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 1X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 20CM RETA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ CIMA 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM BOCA P/ BAIXO 4X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 2X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 3X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 4X5MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 2X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 3X10MM; PINÇA LOVE GRUENWALD 22CM RETA 4X10MM; PINÇA LUC CORTANTE NASAL; PINÇA LUER GOIVA CURVA 16CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 16CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 17CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 17CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 18CM SIMPLES;PINÇA LUER GOIVA RETA 18CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA CURVA 20CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 20CM SIMPLES; PINÇA LUER GOIVA RETA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA LUER GOIVA CURVA 23CM DUPLA ARTICULAÇÃO; PINÇA MATHIEU 20CM; PINÇA MATHIEU 25CM; PINÇA MATHIEU 28CM; PINÇA MARTEL; PINÇA OLDBERG BOCA REDONDA; PINÇA OLIVECRONA 20CM; PINÇA P/ BIOPSIA WITTNER RETA 21CM; PINÇA P/ BIOPSIA WITTNER CURVA 21CM; PINÇA P/ BIOPSIA SCHULZ FLEXIVEL 3X510MM; PINÇA PROF°.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 1MM; PINÇA PROF°.MEDINA P/ BIOPSIA

24CM 2MM; PINÇA PROF°.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 3MM; PINÇA PROF°.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 4MM; PINÇA PROF°.MEDINA P/ BIOPSIA 24CM 5MM;PINÇA ROWE DIREITA; PINÇA ROWE ESQUERDA; PINÇA GOIVA RUSKIN RETA 23CM; PINÇA GOIVA RUSKIN CURVA 23CM; PINÇA RUSKIN DUPLA ARTICULAÇÃO RETA; PINÇA RUSKIN DUPLA ARTICULAÇÃO CURVA; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM 3MM; PINÇA GOIVA JANSEN 18CM 5MM; PINÇA SACA-CALCIO P/CIMA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO P/DIREITA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO P/ESQUERDA 20CM; PINÇA SACA-CALCIO RETA 20CM; PINÇA SCHUBERT P/ BIOPSIA 23,5CM ANGULADA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 21CM RETA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 23,5CM RETA; PINÇA SCHUBERT P/BIOPSIA 29CM RETA; PINÇA SCHUBERT; PINÇA SCHUMACHER; PINÇA SEMB; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING P/BAIXO PONTA 3MM 18CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING P/CIMA PONTA 3MM 18CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 13CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 15CM; PINÇA SPURLING RETA PONTA 3MM 18CM; PINÇA STILE-LISTON 23CM CURVA; PINÇA STILE-LISTON 23CM RETA; PINÇA STILLE-LISTON 27CM CURVA; PINÇA STILLE-LISTON 27CM RETA; PINÇA STILLE LUER 23CM ANGULADA; PINÇA GOIVA STILLE LUER RETA 27CM; PINÇA GOIVA STILLE LUER CURVA 27CM; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°1; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°2; PINÇA STRUEMPEL SACABOCADO N°3; PINÇA STRUYCKEN ANGULADA; PINÇA STRUYCKEN INFANTIL ANGULADA; PINÇA STRUYCKEN INFANTIL RETA; PINÇA STRUYCKEN RETA; PINÇA TAKAHASHI BOCA RETA; PINÇA TAKAHASHI BOCA P/ CIMA; PINÇA TAKAHASHI DELICADA 12CM; PINÇA TAKAHASHI DELICADA 19CM; PINÇA THOMAS-GAYLOR; PINÇA VAN DOREN 24CM BIOPSIA; PINÇA WATSON-WILLIAN NASAL COM SERRILHA; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 45° P/ CIMA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY 90° P/ CIMA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA DELICADA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY RETA N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ ESQUERDA 45° N°6; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°1; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°2; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°3; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°4; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°5; PINÇA WEIL-BLAKESLEY P/ DIREITA 45° N°6; PINÇA YEOMAN 28CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 28CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 35CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 35CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 20CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 20CM BOCA ARREDONDADA; PINÇA YEOMAN 25CM BOCA CHATA; PINÇA YEOMAN 25CM BOCA ARREDONDADA; PORTA AGULHA CRILE WOOD 15CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA GILLIES 16CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA OLSEN HEGAR 14CM T/C; PORTA AGULHA TESOURA OLSEN HEGAR 16CM T/C; PORTA AGULHA P/ FIO DE AÇO BERRY 20CM; SACA-PROTESE C/3 PONTAS; SACA-PROTESE IMPLES; SERRA NÓ BRUENINGS C/ CREMALHEIRA; SERRA-NO EVES S/CREMALHEIRA 28CM; SERRA-NO KRAUSE; SERRA NÓ WILDE; TESOURA BALIU; TESOURA BARRAQUER; TESOURA BECKER-CAPLAN P/ SEPTO; TESOURA BELLUCCI MICRO RETA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/CIMA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/DIREITA; TESOURA BELLUCCI MICRO CURVA/ESQUERDA; TESOURA BOETTCHER 18CM; TESOURA BOYD 14CM CURVA; TESOURA BOYD 14CM CURVA T/C; TESOURA BOYD 18CM CURVA; TESOURA BOYD 18CM CURVA T/C; TESOURA BOYD 20CM CURVA; TESOURA BOYD 20CM CURVA T/C; TESOURA BRAUN-STADLER 14,5CM; TESOURA BRAUN-STADLER 16CM; TESOURA BRAUN-STADLER 20CM; TESOURA BRAUN-STADLER 22CM; TESOURA CALCIFRED CURVA SERRILHADA 23CM; TESOURA CALCIFRED T/C 23CM; TESOURA CALCIFRED; TESOURA CASTROVIEJO CURVA; TESOURA CASTROVIEJO DIREITA; TESOURA CASTROVIEJO ESQUERDA; TESOURA CASTROVIEJO P/ SINECHIA; TESOURA CASTROVIEJO 130°; TESOURA

CASTROVIEJO 25°;TESOURA CASTROVIEJO 45°; TESOURA CASTROVIEJO 60°; TESOURA CASTROVIEJO 90°; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 15CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA CURVA 18CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 15CM; TESOURA CASTROVIEJO COM SERRILHA RETA 18CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 09CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA CURVA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 09CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 11CM; TESOURA CASTROVIEJO P/ MICRO CIRURGIA RETA 14CM; TESOURA CASTROVIEJO RETA T/C 15CM; TESOURA CASTROVIEJO T/C 130°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 25°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 45°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 60°; TESOURA CASTROVIEJO T/C 90°; TESOURA CASTROVIEJO CURVA T/C 15CM; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ DIREITA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ ESQUERDA; TESOURA CASTROVIEJO ANGULADA P/ FRENTE; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/FINA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM RETA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CN RETA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/FINA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 8CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA15CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM RETA ROMBA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA FINA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 15CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM RETA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM RETA ROMBA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/FINA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/FINA T/C; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA FINA/ROMBA T/C;TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA ROMBA/ROMBA; TESOURA CIRURGICA 17CM CURVA ROMBA/ROMBA T/C; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA 100MM;TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA RETA 100MM;TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA ANGULADA 45° 100MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL PONTIAGUDA ANGULADA 90° 100MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ ESQUERDA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ DIREITA SERRILHADA 130MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA LISA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA CURTA LISA 9,0MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA LONGA LISA 11,0MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA RETA SERRILHADA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ ESQUERDA LISA 9,5MM; TESOURA CIRURGICA ENDONASAL ROMBA CURVA P/ DIREITA LISA 9,5MM; TESOURA COHAN-VANNAS CURVA; TESOURA COHAN-VANNAS RETA;TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 11CM; TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 14CM; TESOURA CONVERSE PONTA ANGULADA 18CM; TESOURA CONVERSE RETA 11CM; TESOURA CONVERSE RETA 14CM; TESOURA CONVERSE 18CM; TESOURA CORTA FIO ACO 13CM SERRILHADA; TESOURA COTTLE P/DORSO NASAL; TESOURA COTLE 11CM; TESOURA COTLE 14CM; TESOURA COTLE 15CM; TESOURA COTLE 16CM; TESOURA DANDY 17CM, TESOURA DANDY CURVA 17CM; TESOURA DANDY 19CM TESOURA DANDY 20CM; TESOURA DANDY TRIGEMINAL; TESOURA DEAN SERRILHADA; TESOURA DEAN SEM SERRILHA; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 25GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 40GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 45 GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM 60GRAUS; TESOURA DE BAKEY T/C 19CM EM "S"; TESOURA DE RYTHIDO; TESOURA DIETRICH 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 130 GRAUS; TESOURA DIETRICH COM GUIA 18CM 130 GRAUS; TESOURA

DIETRICH T/C 18CM 25GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 25GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 45GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 45GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 60GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 60GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 90GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 90GRAUS; TESOURA DIETRICH T/C 18CM 125GRAUS; TESOURA DIETRICH 18CM 125GRAUS; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 25° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 25° 18CM T/C;TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 45° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 45° 18CM T/C;TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 60° 18CM; TESOURA DIETHRICH-HEGEMANN 60° 18CM T/C;TESOURA ENTERÓTOMO; TESOURA ESMARCH 17CM; TESOURA ESMARCH 20CM;TESOURA FAVALORO 18CM 130 GRAUS;TESOURA FAVAROLO 18CM; TESOURA P/ FIO DE ACO 11CM; TESOURA P/ FIO DE ACO 11CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 11CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 11CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 12CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 12CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 15CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 15CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 18CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 18CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 20CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 20CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 25CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 25CM T/C; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 30CM; TESOURA FOMOM PONTA CURVA 30CM T/C; TESOURA FOMON DORSAL ANGULAR; TESOURA FOMON DORSAL ANGULAR T/C; TESOURA FOMON ANGULADA 15CM; TESOURA FRAZIER 18CM;TESOURA FREEMAN; TESOURA FREEMAN CURVA 14CM; TESOURA FREEMAN CURVA 18CM; TESOURA FREEMAN CURVA 23CM; TESOURA FREEMAN RETA 14CM; TESOURA FREEMAN RETA 18CM; TESOURA FREEMAN RETA 23CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 15CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 20CM; TESOURA GINECOLOGICA WERTHEIM CURVA 23CM; TESOURA GOLDMAN FOX; TESOURA GOLDMAN FOX T/C; TESOURA GOLDMAN FOX RETA; TESOURA GOLDMAN FOX RETA T/C;TESOURA GOLDMAN FOX CURVA; TESOURA GOLDMAN FOX CURVA T/C; TESOURA HEYMAN DELICADA 10CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 13CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 16CM; TESOURA HEYMAN DELICADA 19CM; TESOURA HEYMANN 10CM; TESOURA HEYMANN ANGULADA COM SERRILHA; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 8CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 8CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 8CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM; TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM T/C; TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA CANHOTO; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA DELICADA; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA CANHOTO T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA CANHOTO; TESOURA IRIS 11,5CM RETA DELICADA; TESOURA IRIS 11,5CM RETA CANHOTO T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA DELICADA T/C; TESOURA IRIS C/FACETA CURVA FINA; TESOURA IRIS C/FACETA CURVA FINA T/C; TESOURA IRIS C/FACETA RETA FINA; TESOURA IRIS C/FACETA RETA FINA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA; TESOURA IRIS 11,5CM CURVA T/C; TESOURA IRIS 11,5CM RETA; TESOURA IRIS 11,5CM RETA T/C; TESOURA IRIS ANGULADA 11,5CM; TESOURA IRIS ANGULADA 14CM; TESOURA IRIS ANGULADA 16CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA CURVA 11CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA CURVA 14CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA RETA 11CM; TESOURA IRIS C/ FACETA SERRILHADA RETA 14CM; TESOURA IRIS ROMBA CURVA 11,5CM; TESOURA IRIS ROMBA RETA 11,5CM; TESOURA JACOBSON CURVA 16CM;TESOURA JACOBSON RETA 16CM; TESOURA JACOBSON RETA 18CM; TESOURA JACOBSON 18CM CURVA; TESOURA JOSEPH 14CM RETA; TESOURA JOSEPH 14CM CURVA; TESOURA JOSEPH CURVA T/C 15CM; TESOURA JOSEPH RETA T/C 15CM; TESOURA KHAN CURVA COM SERRILHA 14CM; TESOURA KHAN RETA COM SERRILHA 14CM; TESOURA KEYE FREEMAN CURVA 14CM; TESOURA KEYE FREEMAN CURVA 18CM; TESOURA KILLIAN P/ SEPTO 20CM; TESOURA KILNER ; TESOURA KILNER 14CM; TESOURA DE LISTER 14CM; TESOURA DE LISTER 17CM; TESOURA DE LISTER 19CM;TESOURA KNIGHT; TESOURA LAGRANGE; TESOURA LAGRANGE T/C;TESOURA LEXER CURVA DELGADA 165MM T/C; TESOURA LEXER BABY 10CM CURVA; TESOURA LEXER BABY 10CM CURVA T/C; TESOURA LEXER BABY 10CM RETA; TESOURA LEXER BABY 10CM RETA T/C;TESOURA LITTAUER 13,5CM; TESOURA LOCKLIN 16CM; TESOURA MALIS 18CM CURVA;TESOURA MAYO 15CM RETA; TESOURA MAYO 15CM CURVA;TESOURA MAYO 17CM RETA; TESOURA MAYO 17CM CURVA; TESOURA MAYO 23CM RETA; TESOURA MAYO 23CM CURVA;TESOURA MAYO NOBLE 17CM CURVA;TESOURA MAYO NOBLE 17CM RETA; TESOURA MAYO NOBLE 17CM CURVA T/C; TESOURA MAYO NOBLE 17CM RETA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA COM

SERRILHA; TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA;TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA C/ SERRILHA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 15CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA;TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 19CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 19CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 22CM CURVA;TESOURA MAYO STILLE 22CM RETA; TESOURA MAYO STILLE 22CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 22CM RETA T/C;TESOURA MAYO STILLE 30CM CURVA; TESOURA MAYO STILLE 30CM RETA;TESOURA MAYO STILLE 30CM CURVA T/C; TESOURA MAYO STILLE 30CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 20CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 23CM RETA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M CURVA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M CURVA T/C;TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M RETA; TESOURA MAYO-HARRINGTON 26M RETA T/C;TESOURA MC-INDOE; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 12CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 15CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 15CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 18CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 18CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA; TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 20CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 23CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 23CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 25CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 25CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 28CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 28CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA ;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 30CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 30CM RETA DELICADA T/C;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA DELICADA; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA DELICADA;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM 35CM CURVA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM 35CM RETA DELICADA T/C; TESOURA METZENBAUM CURVA LONGA 23CM; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM RETA; T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM RETA;

TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 18CM RETA T/C;TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 20CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 23CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 25CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM RETA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 28CM RETA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM CURVA; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM RETA;TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM CURVA T/C; TESOURA METZENBAUM-NELSON 30CM RETA T/C;TESOURA NELSON 24CM CURVA;TESOURA NELSON 24CM RETA;TESOURA NOYES 12CM FINA/FINA RETA;TESOURA NOYES 12CM ROMBA/FINA RETA;TESOURA NOYES 12CM ROMBA/ROMBA RETA;TESOURA NOYES IRIS RETA 12CM ;TESOURA NOYES IRIS CURVA 12CM; TESOURA OLIVECRONA; TESOURA PARA OURO RETA 10CM; TESOURA PARA OURO CURVA 10CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 14CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 18CM; TESOURA COROA E OURO CURVA 14CM T/C; TESOURA COROA E OURO CURVA 18CM T/C; TESOURA COROA E OURO CURVA T/C; TESOURA COROA E OURO RETA 14CM; TESOURA COROA E OURO RETA 18CM; TESOURA COROA E OURO RETA 14CM T/C;TESOURA COROA E OURO RETA 18CM T/C; TESOURA COROA E OURO RETA T/C; TESOURA P/ BANDAGEM GROSSA;TESOURA PARA CORDÃO UMBILICAL;TESOURA P/ENUCLEACAO 14CM; TESOURA P/ENUCLEACAO 16CM;TESOURA P/ESTRABISMO CURVA;TESOURA P/ESTRABISMO RETA;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 145MM T/C;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 180MM T/C;TESOURA P/LIGADURA CURVA CORTE ONDULADO 230MM T/C;TESOURA P/ RUGAS 14CM;TESOURA P/ RUGAS 20CM;TESOURA P/ RUGAS 24CM; TESOURA PARAMETRIAL 23CM CURVA;TESOURA PARAMETRIAL 26CM CURVA; TESOURA PARAMETRIAL 30CM CURVA;TESOURA PARAMETRIAL 35CM CURVA; TESOURA PARAMETRIAL 23CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 26CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 30CM CURVA T/C;TESOURA PARAMETRIAL 35CM CURVA T/C; TESOURA P/ TUBOS SERRILHADA 20 CM; TESOURA PELICANO 17CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 25° 19CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 40° 19CM TESOURA POTTS DE MARTEL 60° 19CM; TESOURA POTTS DE MARTEL 25° 19CM T/C; TESOURA POTTS DE MARTEL 40° 19CM T/C; TESOURA POTTS DE MARTEL 60° 19CM T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 25°; TESOURA POTTS SMITH 19CM 25°T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 30°; TESOURA POTTS SMITH 19CM 30°T/C;TESOURA POTTS SMITH 19CM 40°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 40°T/C; TESOURA POTTS SMITH 45°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 60°;TESOURA POTTS SMITH 19CM 60°T/C;TESOURA POTTS SMITH 25° CURVA T/C; TESOURA POTTS SMITH 45° CURVA T/C;TESOURA POTTS SMITH 60° CURVA T/C;TESOURA POTTS-YASARGIL 18CM DIREITA;TESOURA POTTS-YASARGIL 18CM ESQUERDA; TESOURA POTTS-YASARGIL 20CM DIREITA;TESOURA POTTS-YASARGIL 20CM ESQUERDA; TESOURA REYNOLDS CURVA 12CM; TESOURA REYNOLDS CURVA 15CM; TESOURA REYNOLDS CURVA 18CM; TESOURA REYNOLDS RETA 12CM; TESOURA REYNOLDS RETA 15CM; TESOURA REYNOLDS RETA 18CM; TESOURA REES P/ RUGAS 20CM;TESOURA REES P/ RUGAS 24CM;TESOURA SATINSKY 18CM CURVA; TESOURA SATINSKY 20CM CURVA;TESOURA SCHMIEDEN-TAYLOR; TESOURA SERRILHADA 15CM; TESOURA SCHUMACHER; TESOURA SIMS RETA; TESOURA SIMS CURVA; TESOURA SIMS 8CM CURVA;TESOURA SMITH; TESOURA SMITH 23CM;TESOURA SNOLDEN SERRILHADA CURVA 15CM; TESOURA SNOLDEN SERRILHADA RETA 15CM;TESOURA SNOLDEN SERRILHADA CURVA 17CM; TESOURA SNOLDEN SERRILHADA RETA 17CM;TESOURA SPENCER 9CM; TESOURA SPENCER 12CM; TESOURA SPENCER 14CM; TESOURA SPENCER CURVA 11CM; TESOURA SPENCER CURVA 14CM; TESOURA SPENCER T/C 11CM; TESOURA SPENCER T/C 14CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA CURVA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA FINA RETA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA CURVA 14CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 09CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 11CM; TESOURA STEVENS PONTA ROMBA RETA 14CM;

TESOURA STEVENS CURVA; TESOURA STEVENS RETA;TESOURA STEVENS 11,5CM CURVA;TESOURA STEVENS 11,5CM RETA;TESOURA STRULLY RETA 18CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 18CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 18CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 18CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY RETA 20CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 20CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 20CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 20CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY RETA 22CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY RETA 22CM PONTA ROMBA;TESOURA STRULLY CURVA 22CM PONTA FINA;TESOURA STRULLY CURVA 22CM PONTA ROMBA;TESOURA THOREK 19CM;TESOURA TROUTMAN CASTROVIEJO DIREITA;TESOURA TROUTMAN CASTROVIEJO ESQUERDA; TESOURA UNIVERSAL P/ FIO T/C; TESOURA UNIVERSAL T/C 11CM; TESOURA UNIVERSAL; TESOURA VANNAS CURVA; TESOURA VANNAS RETA;TESOURA KLINKENBERGH-LOTH 23CM; TESOURA ZURICH RETA 13CM ;TESOURA WECKER 11CM; TESOURA WESTCOTT CURVA; TESOURA WESTCOTT RETA;

Nome Técnico	Instrumentos cirúrgicos
Registro	10304850053
Processo	25351.516402/2006-76
Origem do Produto	• FABRICANTE: ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

001425

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 59

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	ALAMAR TECNO CIENTÍFICA LTDA		
CNPJ	48.044.358/0001-42	**Autorização**	8.00.491-2
Produto	CONFIRME TESTE COMPACT		

Apresentação/Modelo
CONFIRME TESTE Compact contém material e reagente necessário para 01 teste; para 25 teste; para 50 teste.

Nome Técnico	AUTOTESTE PARA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG)
Registro	80049120085
Processo	25351.530222/2009-19
Origem do Produto	• FABRICANTE: ALAMAR TECNO CIENTÍFICA LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

001426

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 79

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
CNPJ	03.155.958/0001-40	**Autorização**	8.01.278-4
Produto	COLPOSCÓPIO BINOCULAR		

Modelo Produto Médico
PE - 7000 F
PE - 7000 V
PE - 7000 Z

Nome Técnico	Colposcopio
Registro	80127840014
Processo	25351.598341/2012-90
Origem do Produto	• FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

86

☐	25351.018370/2019-62	Sabonete Liquido Sensações Erva Doce Cosmetize	ISENTO DE REGISTRO	PUBLICADO NOTIFICADO	18/12/2023

Empresa Detentora

CNPJ	Razão Social	Autorização
00.355.235/0001-04	BARDANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME	2.02.156-1
UF	**Município**	**Código do Município**
PR	BALSA NOVA	410230

Caracterização

Nº do Processo	25351.018370/2019-62
Grupo do Produto	SABONETE FACIAL E/OU CORPORAL SEM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 1
Nome do Produto	Sabonete Liquido Sensações Erva Doce Cosmetize
Forma Física do Produto	LIQUIDO VISCOSO

Local de Fabricação

Nacional

CNPJ	Fabricante	Nº da Autorização
00.355.235/0001-04	BARDANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME	2.02.156-1
UF	**Município de Fabricação**	**Código do Município**
PR	BALSA NOVA	410230

Apresentação

Destinação do Produto	Período de Validade do Produto
COMERCIAL	3 ANOS

Restrição de Uso/Venda	Cuidados de Conservação
NÃO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO	NÃO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO
Embalagem Primária	**Embalagem Secundária**
FRASCO DE PLÁSTICO	PRODUTO SOMENTE CONTÉM EMBALAGEM PRIMÁRIA

001423

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 87

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA		
CNPJ	09.458.251/0001-99	**Autorização**	8.15.147-4
Produto	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL - LUPLAST		

Modelo Produto Médico
Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Nome Técnico	Luvas Descartaveis
Registro	81514749005
Processo	25351.356415/2017-46
Origem do Produto	• FABRICANTE: LUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

ANVISA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa

Atualizado em 27/11/2018

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. [redacted]ora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. [redacted]relho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).

    23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos

24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)

    24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

ANVISA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama

http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos-que-nao-sao-regulados-pela-anvisa

ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.

    56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios

34. Suporte para artigos de laboratório
35. Temporizador
36. Titulador
37. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
   1. 1 Condicionadores de ar
   1. 2 Purificador de ar
   1. 3 Esterilizador de ar
   1. 4 Umidificador de ar
2. Balde
3. Bandeja, exceto para esterilização
4. Barreira para separação de ambientes
   4.1 Biombo
5. Bomba a vácuo
6. Caldeira
7. Central de ar comprimido
8. Central de gases medicinais
9. Central de vácuo
10. [redacted]pressor de ar
11. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
12. Cortador de isopor para confecção de moldes
13. Dispositivo para abertura de produtos médicos
14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
    14. 1 Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
15. Equipamentos para Lavanderia
16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17. Escova para limpeza de produtos em geral
18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano

19. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde

20. Fogão para preparação de alimentos

21. Gel para absorção de resíduos orgânicos

22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)

23. Gerador de vapor

24. Incinerador de resíduos hospitalares

25. Indicador físico, químico ou biológico

26. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
    1 Mocho Odontológico ou cirúrgico.
    26. 2 Cadeiras de espera
    26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
    26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
    26. 5 Mesa de cabeceira Mesa para
    26. 6 Necrópsia

27. Negatoscópio

28. Papel higiênico

29. Pia hospitalar

30. Protetor auricular de ruídos

31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.

32. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos

33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral

34. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)

35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável

36. Secador de ar medicinal

37. Seladora de embalagens de produtos médicos

38. Sistema de comunicação hospitalar

39. Sistema de sinalização hospitalar
40. Dispensório Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro

   4.1 Relógio para treinamento

5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico

   8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

   8.2 Halteres

   8.3 Estações de Musculação

   8.4 Remadores

   8.5 Aparelho para abdominais

   8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

ANVISA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

001435

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental

   3.1 Condicionadores de ar

   3.2 Purificador de ar

   3.3 Esterilizador de ar

   3.4 Umidificador de ar

4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde

http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos-que-nao-sao-regulados-pela-anvisa

24. Purificador de água

25. Sauna

26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnostico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Item: 56

Maringá Hospitalar

001437

Cosméticos - Produtos Notificados / Cosméticos - Produtos Notificados

Detalhes do Produto

Assunto	2700 - Notificação de Produto Grau 1 Nacional
Produto	CLARA LUX SABONETE LÍQUIDO NEUTRO
Empresa	02.764.228/0001-83 - BIOLUX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA
Processo	25351.336399/2005-28
Área	Cosméticos
Situação	Notificação Aceita
Data de Notificação	20/10/2005

Apresentação	Tonalidade	Código / Descrição EAN
GALÃO + CAIXA DE PAPELÃO		7898414650118 / clara-lux sabonete líquido neutro 1 litro
FRASCO DE PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELÃO		7898414650125 / clara-lux sabonete líquido neutro 5 litros
REFIL DE POLIETILENO + CAIXA DE PAPELÃO		7898414650132 / clara-lux sabonete líquido neutro sachê

Petições

Expediente	Data	Transação	Assunto	Situação
0405[illegible]/05-1	25/01/2006	453322000	2703 - Notificação de Atualização de Produto Grau 1 Nacional	Concluída análise - deferido
0125[illegible]/09-8	20/10/2009	20972742009	2705 - Notificação de Modificação de Fórmula de produto Grau 1	Concluída análise - deferido

Voltar

87 Clarmed 001438

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	LUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA		
CNPJ	09.458.251/0001-99	**Autorização**	8.15.147-4
Produto	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL - LUPLAST		

Modelo Produto Médico

Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Nome Técnico	Luvas Descartaveis
Registro	81514749002
Processo	25351.356379/2017-59
Origem do Produto	• FABRICANTE: LUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE LUVAS DESCARTAVEIS LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

001439

15, 61, 73, 90, 91, 92

Produtos para a Saúde

Enquadramento Sanitário de Produtos para Saúde

Para fins do registro previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) produtos para saúde (correlatos) sujeitos a registro, os quais devem ser registrados na Anvisa na forma da Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001;

(b) produtos para saúde dispensados de registro, referidos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto nº 79.094/77, os quais devem ser cadastrados na Anvisa na forma do Art. 3º da referida Resolução; e

(c) produtos não considerados produtos para saúde, os quais não necessitam de qualquer autorização da Anvisa para sua fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo.

O cadastro de produtos para a saúde, conforme previsto no § 1º do Art. 25 da Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976, foi atualizado através da Resolução ANVISA RDC nº 24 de 23 de março de 2009. Complementarmente, a Instrução Normativa ANVISA IN nº 00 traz a lista de exceções dos produtos classes de risco I e II que ainda permanecem no regime de registro. Os produtos cadastrados são os enquadrados como dispensados de registro conforme art. 25 da Lei nº 6360/76, existem ainda os produtos que não são considerados produtos para saúde, que embora relacionados com atividades voltadas para saúde, não necessitam de registro ou cadastro junto a Anvisa para serem comercializados no país.

A seguir seguem as listas dos produtos para saúde classe I e II que devem ser registrados na Anvisa e os produtos não considerados produtos para saúde:

(a) IN nº 7, de 17 de junho de 2009 – produtos para saúde classe I e II que devem ser registrados (PDF)

(b) Produtos não considerados produtos para saúde (PDF)

No caso de dúvidas quanto ao enquadramento de produto não contido nas relações acima, a consulta à Anvisa deve ser protocolada contendo as informações sobre o produto indicadas nos itens 1.1 a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anexo III.C do regulamento técnico aprovado pela Resolução - RDC nº 185/01

Copyright © 2000 - Anvisa

001440

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	ALERE S/A		
CNPJ	50.248.780/0001-61	**Autorização**	1.00.717-7
Produto	Teste hCG de Gravidez		

Apresentação/Modelo

1 teste

10 testes

100 testes

15 testes

20 testes

25 testes

3 testes

30 testes

40 testes

5 testes

50 testes

Nome Técnico	AUTOTESTE PARA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG)
Registro	10071770818
Processo	25351.003587/2015-11
Origem do Produto	• FABRICANTE: ABON BIOPHARM CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

SOMA PR
HOSPITALAR

001441

REGISTRO ANVISA

CNPJ nº 00.656.468/0001-39 - Rua Anita Ribas, 410 | Bacacheri | CEP: 82520-610 | Curitiba | PR
(41) 3028-2375 contato.pr@somahospitalar.com.br www.somahospitalar.com.br

11,13

001442

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.		
CNPJ	21.551.379/0001-06	**Autorização**	1.00.334-3
Produto	BD Emerald Saf-T Seringa com dispositivo de segurança e sem Agulha		

Modelo Produto Médico

3 mL; 5 mL; 10 mL

Nome Técnico	Seringas Descartaveis
Registro	10033430573
Processo	25351.262278/2010-86
Origem do Produto	• FABRICANTE: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

12

001443

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.		
CNPJ	21.551.379/0001-06	**Autorização**	1.00.334-3
Produto	BD PLASTIPAK SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA		

Modelo Produto Médico

Bico Luer Slip: 1ml; 3ml; 5ml; 10ml; 20ml. Bico Luer Lock: 3ml; 5ml; 10ml; 20ml.

Nome Técnico	Seringas Descartaveis
Registro	10033430030
Processo	25000.007606/9451
Origem do Produto	• FABRICANTE: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	AMÉRICA MEDICAL LTDA		
CNPJ	01.310.212/0001-38	**Autorização**	8.00.374-9
Produto	GAZE HIDRÓFILA CIRCULAR Nataly- NÃO ESTÉRIL		

Modelo Produto Médico

1061100003 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 91 cm 9 fios/cm² Premium

1061100005 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 91 mm 9 fios/cm² Soft

1061300005 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 91 mm 13 fios/cm² Soft

1062100003 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 91 cm 11 fios/cm² Premium

1062100008 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 91 mm 11 fios/cm² Soft

1063100002 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 91 cm 13 fios/cm² Premium

1063100006 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 40 m 9 fios/cm² Soft

1063100007- Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 40 m 9 fios/cm² Soft

1063100008- Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 40 m 13 fios/cm² Soft

1063100009 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 50 m 9 fios/cm² Soft

1063100009 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 80 m 11 fios/cm² Premium

1063100010 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 50 m 11 fios/cm² Soft

1063100011 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 50 m 13 fios/cm² Premium

1063100012- Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 60 m 9 fios/cm² Premium

1063100013 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 60 m 11 fios/cm² Premium

1063100014- Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 60 m 13 fios/cm² Premium

1063100015 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 70 cm 9 fios/cm² Premium

1063100016 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 70 m 11 fios/cm² Premium

1063100017- Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 70 cm 13 fios/cm² Premium

1063100018 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 80 m 9 fios/cm² Premium

1063100020 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 80 m 13 fios/cm² Premium

1063100021- Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 90 m 9 fios/cm² Premium

1063100022 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 90 m 9 fios/cm² Premium

1063100023 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 cm x 90 m 13 fios/cm² Premium

1063100024 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 55 cm 9 fios/cm² Soft

1063100025 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 55 cm 11 fios/cm² Soft

1063100026 - Gaze Hidrófila Circular Nataly Não Estéril 91 m x 55 cm 13 fios/cm² Soft

001445

Nome Técnico	Gazes e Ataduras
Registro	80037490004
Processo	25351.495161/2008-86
Origem do Produto	• FABRICANTE: AMÉRICA MEDICAL LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	04.967.408/0001-98	**Autorização**	8.01.175-8
Produto	MEPILEX AG		

Modelo Produto Médico

Mepilex Ag 10x10 cm – código 287100; Mepilex Ag 10x20 cm – código 287200; Mepilex Ag 15x15 cm – código 287300; Mepilex Ag 20x20 cm – código 287400; Mepilex Ag 20x50 cm – código 287500; Mepilex Heel Ag 15x22 cm – código 388390

Nome Técnico	Curativo
Registro	80117580298
Processo	25351.376901/2014-56
Origem do Produto	• FABRICANTE: MOLNLYCKE HEALTH CARE AB - SUÉCIA
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	15/12/2024

Voltar

82, 83, 84

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

001447

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	USA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME		
CNPJ	24.450.310/0001-76	**Autorização**	8.14.478-1
Produto	ATADURA DE CREPOM SOFT USA MEDICAL		

Modelo Produto Médico

A Atadura de Crepom soft USA MEDICAL é confeccionada em tecido de alta qualidade, com densidades de 13 fios por cm². É fornecida nas seguintes dimensões: 4,0 cm x 1,80 m; 6,0 cm x 1,8 m; 8,0 cm x 1,80 m; 10,0 cm x 1,80 m; 12,0 cm x 1,80 m; 15,0 cm x 1,80 m, 20,0 cm x 1,80 m; 25,0 cm x 1,80 m; 30,0 cm x 1,80 cm;

Nome Técnico	Ataduras
Registro	81447810037
Processo	25351.413756/2018-01
Origem do Produto	• FABRICANTE: USA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Voltar

90,95

001448

3M do Brasil
Via Anhanguera, km 110
13181-900 – Sumaré – SP
Fone (19) 3838.7543

3M

À quem possa interessar

REF: Necessidade de Regularização de Produto.

A **3M do Brasil Ltda.**, com sede à Via Anhanguera, km 110, no Município de Sumaré, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob nº 45.985.371/0001-08, por sua Farmacêutica Responsável abaixo assinada, vem informar:

Encontra-se disponível no site da ANVISA uma lista de "**Produtos Não Regulados pela ANVISA**", enquadram-se nesta lista os seguintes produtos da 3M:

CATEGORIA 2 - Produtos para apoio de atividade laboratorial geral.

- ***linha 53- Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)***:

INCUBADORAS

HB004481006	INCUBADORA LEITORA ATTEST 490H
HB004327225	INCUBADORA LEITORA ATTEST 490
HB004346902	INCUBADORA LEITORA ATTEST 390
H0002207290	INCUBADORA ATTEST 290
HB004212799	INCUBADORA 116 P/ ATTEST 1262
HB004379911	INCUBADORA 118 MINI P/ ATTEST 1262
HB004152573	INCUBADORA CLEAN TRACE

- ***linha 55- Indicador físico, químico ou biológico***

INDICADORES QUÍMICOS FITAS

HB004481014	1228 VH2O2 RL 19MMX55M
HB004216873	1355 EMB.DESC. 18MMX55M RL
HB004171714	1222 LFT RL 19MMX30M
HB004444012	1224 ETO 18MMX55M

INDICADOR QUÍMICO

HB004480990	1248 IND VH2O2 - CX C/4SC C/250

INDICADORES QUÍMICOS BOWIE&DICK

HB004157333	00135 PACOTE B&D PLUS
HB004282644	00135LFBR PACOTE B&D PLUS
HB004045959	1233 PACOTE B&D CX C/30
HB004282651	1233LFBR PACOTE B&D CX C/ 30
H0001986969	0130/1227 FOLHA B&D CX C/50
H0002188292	PACOTE B&D 1300 CX C/ 20
HB004347173	1302 PACOTE B&D

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 412117091815194605 91-1; Data: 17/09/2018 15:27:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH65561 2-HRUR
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

001443

3M do Brasil
Via Anhanguera, km 110
13181-900 – Sumaré – SP
Fone (19) 3838.7543

3M

Segue anexa a lista de Produtos Não Regulados pela ANVISA para consulta.

Atenciosamente.

Sumaré, 10 de julho de 2017

Káren A. S. Cumpri
Farmacêutica Co-Responsável
CRF – SP 24243

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 412117091815194605913; Data: 17/09/2018 15:27:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHM65010-ZTNT;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

001459

24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embalezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfetoras de produtos médicos.

56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor de ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
   1. 1 Condicionadores de ar

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 412117091815194605915; Data: 17/09/2018 15:27:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AHM85808-K9CQ
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

001451

4. Cronômetro

4.1 Relógio para treinamento

5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico

8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

8.2 Halteres

8.3 Estações de Musculação

8.4 Remadores

8.5 Aparelho para abdominais

8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)

9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicate para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental

3.1 Condicionadores de ar

3.2 Purificador de ar

3.3 Esterilizador de ar

3.4 Umidificador de ar

4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Chupeta
8. Escova odontológica
9. Escova para cabelos
10. Esponja para limpeza de pele
11. Fio dental
12. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13. Lente para ampliar escalas
14. Limpador de língua
15. Mamadeira e bico
16. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17. Massageador de gengiva
18. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
19. Mordedor para lactentes
20. Óculos para presbiopia
21. Passador de fio dental
22. Produto para estimulação sexual
23. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
24. Purificador de água
25. Sauna
26. Secador e escova de cabelos

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens
6. Impressora
7. Monitor de vídeo
8. Óleo lubrificante

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 412117081815194605917; Data: 17/09/2018 15:27:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFM85606-MJB
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

001452

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/09/2018 15:04:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1077293

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **17/09/2019 15:27:19 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41211709181519460591-1 a 41211709181519460591-8
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b631e2d7b255158b214870eae75d7c0db7b65fdb698894dc969f4a602ac78ec02c79ec57a8e72a87d8a69d2
c6b8a2a8d4fcec6b1134a80579ff44ea886124a952

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil